

靖西市人民医院新院一批设备采购项目标项 6、标项 7(重)
(BSZC2025-G1-250024-GXBS)

标项 2:标项名称: 标项 7 全自动清洗消毒器、医用干燥柜、
医用真空干燥柜、硬式内镜清洗工作站、牙科手机清洗机、
绝缘检测仪、医用除锈仪、煮沸消毒器质疑事项答复

质疑供应商: 江苏同昌医疗科技有限公司

法定代表人: 朱玉民

地址: 江苏省泰州市高港区许庄街道新港大道 666 号 2201 室、
2201-1 室

邮编: 225324

联系人/授权代表: 田静波

联系电话: 18154523712

贵公司关于《靖西市人民医院新院一批设备采购项目标项 6、标项 7(重) (BSZC2025-G1-250024-GXBS) 标项 2: 标项名称: 标项 7 全自动清洗消毒器、医用干燥柜、医用真空干燥柜、硬式内镜清洗工作站、牙科手机清洗机、绝缘检测仪、医用除锈仪、煮沸消毒器》的质疑函, 我公司于 2025 年 3 月 26 日下午通过顺丰快递收悉。针对贵公司提出的质疑事项, 我公司给予高度重视, 并进行认真核实, 现对质疑事项作答复如下:

质疑事项 1: 设备名称为医用真空干燥柜的参数中

“1.2.4: 门锁装置, 电动锁, 自动检测门关位, 安全方便, 避免手动操作引起的误操作。” , 此参数白象公司存在虚假

响应。

质疑事项 1 答复：经调查核实，根据白象公司产品彩页资料明确其投标产品具备电动锁和机械锁双重结构（详见附件），满足招标文件要求。贵公司质疑事项缺乏事实依据，质疑无效。

质疑事项 2：设备名称为医用真空干燥柜的参数中“1.4.2 程序系统：内置至少 12 套程序，用户可根据需求自行调节参数；温度可调范围：室温~65℃；控制压力：0~101kPa；操作权限：三级权限，防止误操作；智能模式：设备利用高精度传感器技术，智能判断腔内物品的干燥情况。物品干燥后，程序自动结束，实现一键干燥。程序运行全过程无时间限制，可对物品进行长时间干燥，对物品无任何损伤。”，此参数白象公司存在虚假响应。

质疑事项 2 答复：经调查核实，根据白象公司产品说明已明确其投标产品具备上述功能（详见附件），满足招标文件要求。贵公司提供的产品证明材料为 VD-120(S)，非白象公司投标产品 VD-120JS，质疑事项缺乏事实依据，质疑无效。

质疑事项 3：设备名称为医用真空干燥柜的参数中“1.4.3：安全装置：设备带有防过载、短路保护装置，PLC 实时限温保护，超温保护真空泵热过载保护，门电机过载保护。紧急开门装置：设备发生故障，无法开门时，可长按紧急开门按钮，直到前门打开为止。”，此参数白象公司存在虚假响应。

质疑事项 3 答复：经调查核实，根据白象公司产品说明

已明确其投标产品具备上述功能（详见附件），满足招标文件要求。贵公司质疑事项缺乏事实依据，质疑无效。

质疑事项 4: 设备名称为医用真空干燥柜的参数中“1.5.1:外形尺寸:≤530(宽)×1655(高)×880(深)mm”，此参数白象公司存在虚假响应。

质疑事项 4 答复: 经调查核实，根据白象公司产品外形尺寸为 540(宽)×1550(高)×800(深)mm（详见附件），不满足招标文件要求，为非标注符号的普通参数发生负偏离。贵公司质疑成立。

质疑事项 5: 设备名称为医用真空干燥柜的参数中“1.2.1.★密封门材质要求:门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形;门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。此参数白象公司存在虚假响应。

质疑事项 5 答复: 经调查核实，根据白象公司产品说明已明确其投标产品具备上述功能（详见附件），满足招标文件要求。贵公司质疑事项缺乏事实依据，质疑无效。

质疑事项 6: 设备名称为医用真空干燥柜的参数中“1.1.2.★材质要求:舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制,有效提高干燥性能。此参数白象公司存在虚假响应。

质疑事项 6 答复: 经调查核实，根据白象公司产品说明已明确其投标产品具备上述功能（详见附件），满足招标文件要求。贵公司质疑事项缺乏事实依据，质疑无效。

质疑事项 7: 设备名称为医用真空干燥柜的参数中”

1.2.1. ★密封门材质要求: 门框采用不锈钢板焊接成型, 强度高, 不变形; 门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构, 可做通道式隔断安装, 此参数白象公司存在虚假响应。

质疑事项 7 答复: 经调查核实, 根据白象公司产品说明已明确其投标产品具备上述功能 (详见附件), 满足招标文件要求。贵公司质疑事项缺乏事实依据, 质疑无效。

质疑事项 8: 设备名称为医用真空干燥柜的参数中
“1.4.1. 控制器要求: 具有一个以太网接口或一个 RS485/RS422 接口等接口满足采购人需求。采用彩色触摸屏作为人机操作界面, 可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数, 触摸式操作, 操作方便、简单; 触摸屏自带 USB 接口, 可接入储存 U 盘, 可记录运行数据和报警信息, 白象公司存在虚假应标。

质疑事项 8 答复: 经调查核实, 根据白象公司产品说明已明确其投标产品具备上述功能 (详见附件), 满足招标文件要求。贵公司质疑事项缺乏事实依据, 质疑无效。

综上所述, 贵公司质疑事项 1、2、3、5、6、7、8 均不成立, 质疑事项 4 成立。本质疑答复结果, 我公司将报送采购人及财政监督部门审核后按程序开展下一步工作。

如贵公司对本质疑答复不满意, 可以根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号) 的规定, 在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。感谢贵公司对我公

司工作的关心和支持！

广西百色公共资源交易有限公司



2025 年 04 月 09 日

附件：

附件 1




附件 2






附件 3

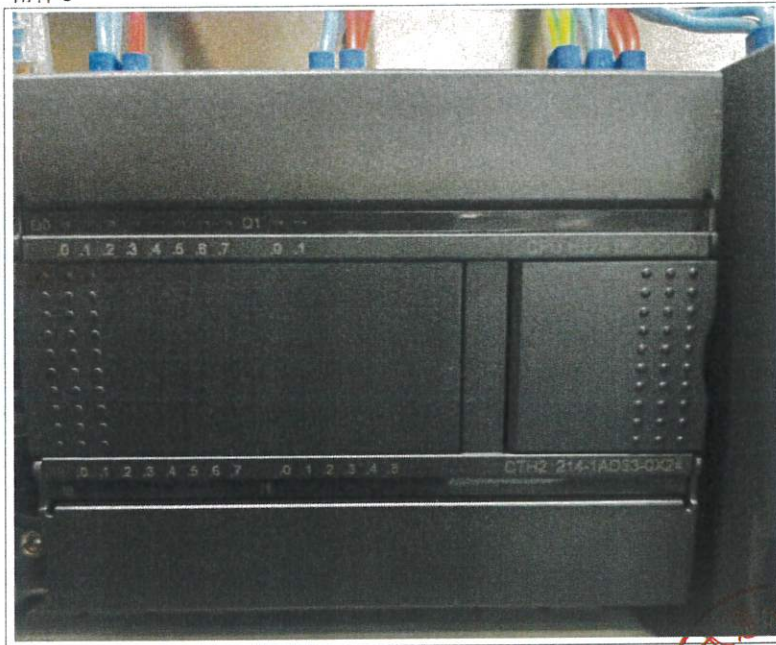

附件 4

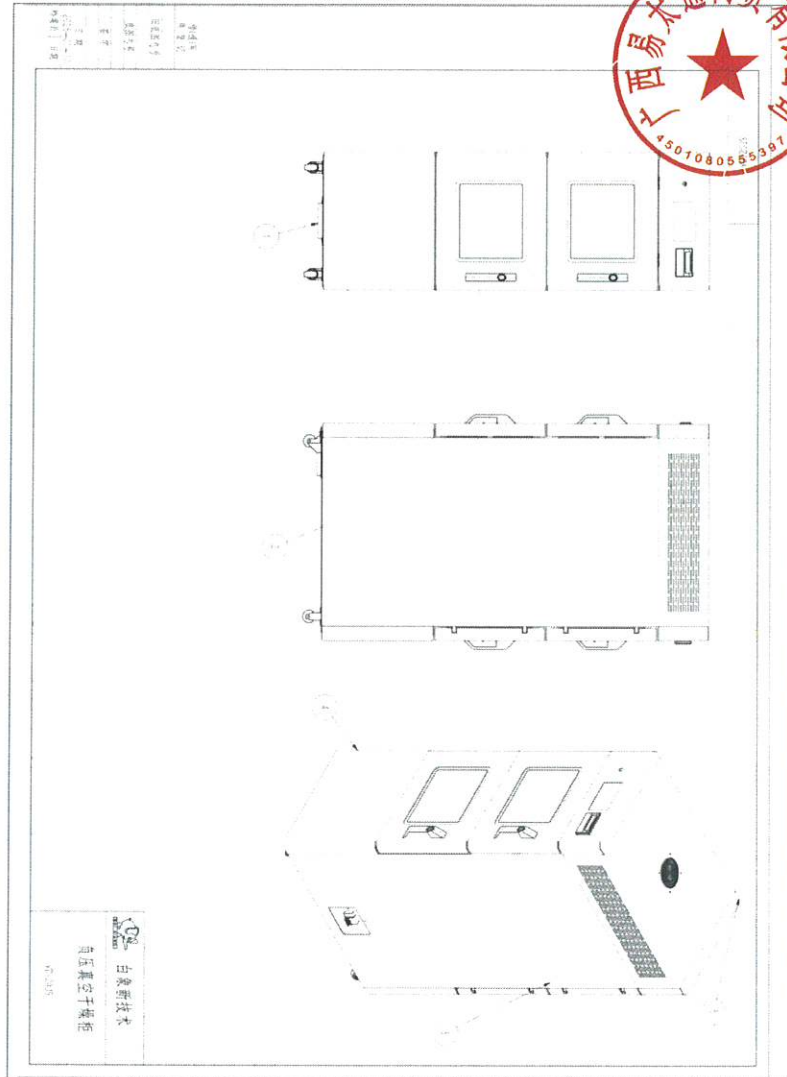

★材质要求：舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。

★密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。

★控制系统

容积：120L

序号	项目	参数
1.	适用范围	可对不耐热器械、管腔器械进行低温干燥。
2.	有效容积	≥120L
3.	外形尺寸 (W*H*D) mm	≥540*1550*800
4.	单个腔体尺寸 (W*H*D) mm	≥320*280*700
5.	篮筐尺寸	280*700*40
6.	额定电压	AC220V/50Hz
7.	门要求	双舱 双侧开门
8.	设备重量	≤195KG
9.	额定功率	≤3KVA
10.	舱体结构及材质	矩形结构内胆，采用优质铝合金防锈板焊接成型具有优质的热传导性，阳极氧化处理，表面光洁提高热辐射效率，有利于腔体内温度控制，提高干燥性能
11.	★门材质要求	门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。
12.	器械托盘数量	≥4个
13.	干燥程序	内置至少12套程序，用户可根据需求自行调节参数； 温度可调范围：室温~65℃； 控制压力：0~101kPa； 操作权限：三级权限，防止误操作； 智能模式：设备利用高精度传感器技术，智能判断腔内物品的干燥情况。物品干燥后，程序自动结束，实现一键干燥。程序运行全过程无时间限制，可对物品进行长时间干燥，对物品无任何损伤。
14.	温控范围	室温~65℃
15.	干燥时间	脉动次数1~99次可调。脉动时间1~99分钟可调
16.	门构造	采用大尺寸钢化玻璃；密封门内置LED光源，可清晰观察舱内物品干燥状态。
17.	温度控制系统	优质温度传感器，能够精确检测干燥时内胆温度并保证其工作稳定性。
18.	加热方式	采柜体采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀。
19.	过滤器要求	采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。
20.	安全装置：	设备带有防过载、短路保护装置，PLC实时限温保护，超温保护，真空泵热过载保护，门电机过载保护。 紧急开门装置：设备发生故障，无法开门时，可长按紧急开门按钮，

		直到前门打开为止。
21.	真空泵	采用知名品牌，真空度 $\geq -90\text{kPa}$ ，可有效保证设备对干燥过程中真空度的要求。
22.	★人机界面	采用 800*600 分辨率的 ≥ 7 寸 LCD 显示屏作为人机交互界面，具有一个以太网接口或一个 RS485/RS422 接口等接口满足采购人需求。 采用 800*600 分辨率的 ≥ 7 寸 LCD 彩色触摸屏显示屏作为人机交互界面，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数，触摸式操作，操作方便、简单；触摸屏自带 USB 接口，可接入储存 U 盘，可记录运行数据和报警信息。
23.	★云服务	通过云服务功能可以对设备和工作状态提供更好的跟踪和追溯，可将数据共享
24.	★智能操作系统	采用智能控制系统，智能化管理，可实现对机器运营实时记录、储存并通过有线、无线通信方式将设备运营数据传输到追溯系统中。
25.	★视频播放	可视频播放各种感控知识、操作视频，提高专业能力，提供相关证明文件。
26.	★在线服务	供最新的行业相关新闻，发布最新产品信息，更新最新行业知识，提供操作者指导和维护保养知识，时刻为用户提供更为便捷的在线服务。
27.	★身份验证	能利用人体生理特征“指纹识别”进行身份验证，实现感控规范的“真追溯”。
28.	★短信通知	机器可以通过短信通知功能，将机器故障、设备保养提示、工作报表、开机、关机信息通知相关人员，提供相关证明文件。
29.	★多种联网方式	可通过 3G、WIFI 等有线、无线方式进行远程实时监控，满足医院需求提高维修的及时性。
30.	★可追溯性	可与配套的追溯系统对接，实现对干燥物品的追溯。
31.	★其他要求	为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。