

# 质疑函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：江西威盛医疗器械有限公司

地址：江西省宜春市樟树市中药城电子商务创业基地196室

联系人：毛家辉

联系电话：15278557764

授权代表：陈家勋

联系电话：15278557764

地址：南宁市良庆区五象航洋广场3号楼1601

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：昭平县人民医院2024年8月医疗设备采购

质疑项目的编号：HZZC2024-G1-210232-KWZB

采购人名称：昭平县人民医院

采购文件获取日期：2024年8月8号

## 三、质疑事项具体内容

### 质疑事项1：

申请人的资格要求：2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，各分标货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

根据市场调研，工信部联企业（2011）300号文件（关于印发中小企业划型标准规定的通知）要求，（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

超高清电子胃肠镜系统市面上主流生产厂家上海澳华内镜股份有限公司，股票代码688212；深圳开立生物医疗科技股份有限公司，股票代码300633 均不满足以上条件。

附网站查询年度财报查询截图，营业额均超过2000万元

单位：人民币万元

| 项目                     | 本报告期       | 上年同期       | 增减变动幅度 (%) |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 营业总收入                  | 67,608.07  | 44,525.90  | 52.29      |
| 营业利润                   | 5,430.89   | 1,136.56   | 377.84     |
| 利润总额                   | 5,387.96   | 1,698.47   | 217.22     |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 5,796.57   | 2,171.53   | 166.93     |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 4,449.78   | 969.21     | 359.11     |
| 基本每股收益 (元)             | 0.43       | 0.16       | 168.75     |
| 加权平均净资产收益率             | 4.38%      | 1.73%      | 增 2.65个百分点 |
|                        | 本报告期末      | 本报告期初      | 增减变动幅度 (%) |
| 总资产                    | 159,535.19 | 146,030.69 | 9.25       |
| 归属于母公司的所有者权益           | 138,010.29 | 126,799.65 | 8.84       |
| 股本                     | 13,403.30  | 13,334.00  | 0.52       |
| 归属于母公司所有者的每            | 10.30      | 9.54       | 8.39       |

## 质疑事项2:

●2.10可兼容同品牌普通胃肠镜、放大镜胃镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、电子胆道镜、双焦点胃镜等共享平台，更好的兼容。

02项目（四）进口产品说明，本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理

根据上海澳华内镜股份有限公司官方网站-产品中心-内镜系统解决方案-AQ-200Elite有详细介绍，国产无其他同类产品满足，该参数偏向上海澳华，为独家排他性参数，后附截图

更强大的兼容性

CBI分光染色

1080P高画质

创新技术亮点

便携智能操作

操控得心应手

配套产品

## 更强大的兼容性·多科室匹配

全新AQ-200 Elite拥有强大的兼容性，可适用于消化科、鼻咽喉科、呼吸科等多个临床科室提供更灵活和全面的内镜诊疗方案

更强大的兼容性

CBI分光染色

1080P高画质

创新技术亮点

便携智能操作

操控得心应手


配套产品




UHD 系列十二指肠镜




VRL-300 系列鼻咽喉电子内镜




VBC-300 系列支气管电子内镜

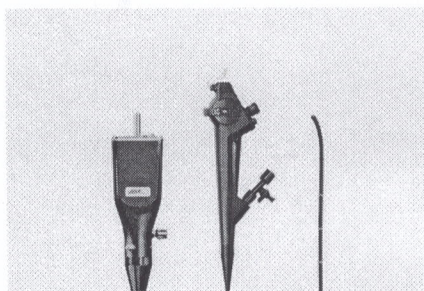

VPB 系列胆道电子内镜

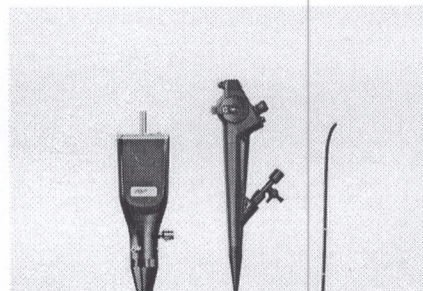

VUB 系列膀胱电子内镜

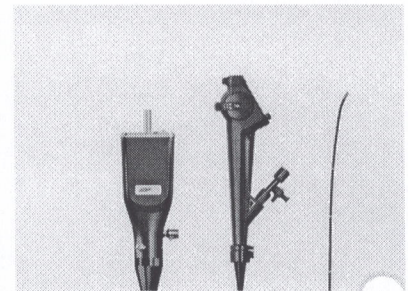

VRP 输尿管肾盂电子内镜

## 质疑事项4:

4.1 视场角: 放大 $\geq 95^\circ$ 、普通观察 $\geq 145^\circ$ 。

根据市场调研, 除进口产品外, 上海澳华放大100倍, 深圳开立放大85倍, 市面上其他同类国产产品无法满足, 该参数偏向上海澳华, 为独家排他性参数。




## 100倍放大


UHD系列内镜搭载AQ-300图像处理器, 输出4K超高分辨率图像, 分辨率大大提高, 图像在高倍放大后依旧清晰, 放大倍率不小于100倍。



白光模式



CBI染色



CBI放大染色



### 全线标配前向副送水

UHD系列全结肠镜均配备前向副送水功能, 帮助在诊断和治疗过程中实时保持黏膜清晰, 快速发现出血点。



### 170°视场角

UHD系列结肠镜拥有170°超大视场角, 提供了更广的视野, 进一步扩大检查范围, 减少盲区。



### 大钳道

结肠镜拥有3.7mm的大钳道口, 可以使用通用活检钳、细胞刷等各标准器械, 适配绝大多数手术需求。



### 结肠镜适应性推进技术

插入管具有软硬度可调功能, 通过旋转软硬度调节环改变插入管的软硬度, 以满足不同患者的病理需求和医生的操作习惯;

同步传导功能将手柄处的推拉力 and 旋转力传递到结肠镜的先端部, 更好地进镜到盲肠;

而在内镜操作时, 随动弯曲功能更可自适应扭转镜身向空腔行进, 提高病人舒适度。



### 头端3光窗照明系统

通过精密的结构与光学设计, 澳华创新性地镜头头端设计了3光窗照明系统, 提供角度更大、更均匀的照明效果。与大视场角相结合, 可得到更好的图像效果。

## 主要参数

|          | 型号           | 工作长度   | 主软管外径 | 景深                           | 钳道内径  | 视场角                   | 弯角                       | 放大倍率         | 钳道及副送水方向 |
|----------|--------------|--------|-------|------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 电子上消化道内镜 | *UHD-GT300Z  | 1050mm | 9.6mm | 放大观察:1.5-3mm<br>普通观察:3-100mm | 2.8mm | 放大观察:95°<br>普通观察:145° | 上210°下90°<br>左100°右100°  | $\geq 100$ 倍 |          |
| 电子下消化道内镜 | *UHD-CL300ZL | 1300mm | 12mm  | 放大观察:2-3.5mm<br>普通观察:3-100mm | 3.7mm | 放大观察:90°<br>普通观察:170° | 上180°下180°<br>左160°右160° | $\geq 100$ 倍 |          |
|          | *UHD-CL300ZL | 1650mm | 12mm  | 放大观察:2-3.5mm<br>普通观察:3-100mm | 3.7mm | 放大观察:90°<br>普通观察:170° | 上180°下180°<br>左160°右160° | $\geq 100$ 倍 |          |

(\*:前向副送水)

400-921-0114

上海澳华内镜股份有限公司

上海市闵行区光中路133弄66号

澳华内镜大厦(邮编 201108)

www.aohua.com

沪械广审(文)第250611-45025号

禁忌内容或注意事项详见说明书

## 质疑事项5:


- 4.8具备 $\geq 95$ 倍光学放大功能。

根据市场调研,除进口产品外,上海澳华放大100倍,深圳开立放大85倍,市面上其他同类国产产品无法满足,该参数偏向上海澳华,为独家排他性参数




## 100倍放大


UHD系列内镜搭载AQ-300图像处理器,输出4K超高清分辨率图像,分辨率大大提高,图像在高倍放大后依旧清晰,放大倍率不小于100倍。



白光模式



CBI染色



CBI放大染色



### 全线标配前向副送水

UHD系列全线胃肠镜均配备前向副送水功能,帮助在诊断和治疗过程中实时保持黏膜清晰,快速发现出血点。




### 170°视场角

UHD系列肠镜拥有170°超大视场角,提供了更广的视野,进一步扩大检查范围,减少盲区。



### 大钳道

结肠镜拥有3.7mm的大钳道口,可以使用通用活检钳、细胞刷等各标准器械,适配绝大多数手术需求。



### 结肠镜适应性推进技术

插入管具有软硬度可调功能,通过旋转软硬度调节环改变插入管的软硬度,以满足不同患者的病理需求和医生的操作习惯;



同步传导功能能将手柄处的推拉力 and 旋转力传递到结肠镜的先端部,更好地进镜到盲肠;



而在内镜操作时,随动弯曲功能更可自适应扭转镜身向空腔行进,提高病人舒适度。



### 头端3光窗照明系统

通过精密的结构与光学设计,澳华创新性地内镜头端设计了3光窗照明系统,提供角度更大、更均匀的照明效果。与大视场角相结合,可得到更好的图像效果。

## 主要参数

| 型号                        | 工作长度   | 主软镜外径 | 景深                           | 钳道内径  | 视场角                   | 弯角                       | 放大倍率         | 钳道及副送水方向 |
|---------------------------|--------|-------|------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 电子上消化道内窥镜<br>*UHD-GT300Z  | 1050mm | 9.6mm | 放大观察:1.5-3mm<br>普通观察:3-100mm | 2.8mm | 放大观察:95°<br>普通观察:145° | 上210°下90°<br>左100°右100°  | $\geq 100$ 倍 |          |
| 电子下消化道内窥镜<br>*UHD-CL300ZI | 1300mm | 12mm  | 放大观察:2-3.5mm<br>普通观察:3-100mm | 3.7mm | 放大观察:90°<br>普通观察:170° | 上180°下180°<br>左160°右160° | $\geq 100$ 倍 |          |
| 电子下消化道内窥镜<br>*UHD-CL300ZL | 1650mm | 12mm  | 放大观察:2-3.5mm<br>普通观察:3-100mm | 3.7mm | 放大观察:90°<br>普通观察:170° | 上180°下180°<br>左160°右160° | $\geq 100$ 倍 |          |

(\*:前向副送水)

☎ 400-921-0114

上海澳华内镜股份有限公司

上海市闵行区光中路133弄66号  
澳华内镜大厦(邮编 201108)

www.aohua.com

沪械广审(文)第250611-45025号  
禁忌内容或注意事项详见说明书



## 质疑事项6:

- 10.1与内镜系统同一品牌，更好的兼容。

根据市场调研（数据来源于厂家官网），市面上其他同类国产品牌产品无法满足，该参数偏向上海澳华，为独家排他性参数。

AOHUA | 30 SINCE 1994  
澳华内镜

[首页](#)

[关于澳华](#)

[新闻中心](#)

[产品中心](#)

[创新平台](#)

[招贤纳士](#)

[联系我们](#)


[CBI大赛](#)

[China-中文](#)




## 周边产品


### 周边设备

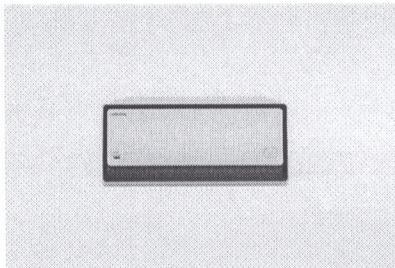

澳小宝 智能辅助诊断系统

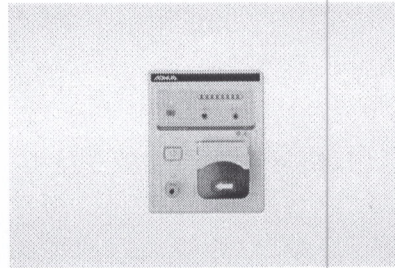

AFP-1 内镜送水泵

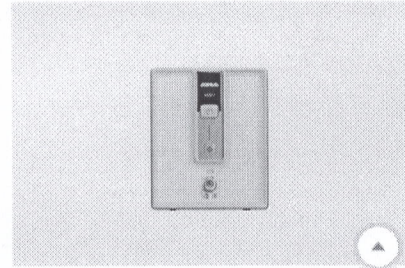

ACD-1 二氧化碳送气装置

法律依据:

1、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

(五)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商。

3、《中华人民共和国政府采购法》第三十六条在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：以上技术参数是对其他潜在供应商的限制性条款，具有明确的品牌及产品倾向性，建议就以上招标参数予以更正或删除，以符合《中华人民共和国招标投标法》第五条之规定。

望贵医院予以及时更正招标参数或给予书面答复，我司将依法保留向上级相关部门继续反馈的权力。

签字(签章): 陈嘉勋

日期: 2024.8.12

公章:





# 授权委托书

致：广西科文招标有限公司

我 毛家辉 (姓名) 系 江西威盛医疗器械有限公司 (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托 陈家勋 (姓名) 以我公司名义参加 昭平县人民医院2024年8月医疗设备采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约、提交质疑等具体事务和签署相关文件。



我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人

(电子签章)：\_\_\_\_\_

法定代表人签字 (或者电子签名)： 陈家勋

2024 年 8 月 12 日



# 法定代表人身份证复印件

姓名 毛宏辉  
性别 男 民族 汉  
出生 2002 年 9 月 11 日  
住址 江西省南昌市进贤县李渡镇坡西村委会下坊村120号  
公民身份号码 36012420020911037X



中华人民共和国居民身份证

签发机关 进贤县公安局  
有效期限 2021.10.18-2031.10.18

