

广西壮族自治区政府采购合同

项目名称: 兴业县居家和社区基本养老服务提升行动项目

项目编号: YLZC2025-C3-240078-GXHC

分标名称: 兴业县居家和社区基本养老服务提升行动项目一家庭

养老床位建设

分标号: 分标1

甲方: (采购人) 兴业县民政局

乙方: (供应商) 广西福满嘉养老服务有限公司

签订时间: 2025年9月27日



分 标：_____分标 1_____ 合同编号：

采购计划号：YLZC2025-C3-70521-001

采 购 人（甲方）：兴业县民政局

供 应 商（乙方）：广西福满嘉养老服务有限公司

项目名称：兴业县居家和社区基本养老服务提升行动项目

项目编号：YLZC2025-C3-240078-GXHC

签订地点：_____兴业县民政局_____ 签订时间：2025 年 9 月 27 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、项目一览表

序号	服务名称	数 量	单位	合同金额（元）	备注
1	兴业县居家和社区基本养老服务提升行动项目一家庭养老床位建设	1	项	1015800.00	兴业县家庭养老床位建设任务不少于 240 张。
人民币合计金额（大写）：壹佰零壹万伍仟捌佰元整（¥1015800.00）					

1、分标 1 合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。

2、本项目要求乙方在服务期限内至少对 240 户符合标准的对象提供相应建设，每户建设标准参照附件（兴业县家庭养老床位基本项目清单）。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3. 入户人员要注意工作方式、方法和态度，不能与老人、家属、街道及社区工作人员发生矛盾。入户人员不得在入户开展家庭养老床位建设过程中向老人及家属推销任何保健品、集资等违法违规的内容，否则采购人有权取消中标供应商资格，并追究法律责任。

4. 确保在执行过程中老人、家属及工作人员的人身安全，执行过程中发生任何安全问题，由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

第四条 交付和验收

1、服务期限：2025年12月31日前完成不少于240户安装工作，且家庭养老床位建设的维护和质保自本合同签订之日起至验收合格后12月止。

2、服务地点：甲方指定地点（兴业县内）。

3、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

4、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

7、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

8、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个

工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责项目有关人员的培训。

第六条 付款方式

签订合同后，开展业务支付合同总额的 30%作为预付款；项目实施成果经甲方验收合格且审定实际发生量后支付剩余金额。（备注：如最终结算总价高于本合同约定合计金额的，按本合同约定合计金额支付。）

第七条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 5%。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1. 服务需求；

2. 成交通知书；

3. 响应函；

4. 商务要求偏离表；

5. 响应报价表；

6. 服务需求偏离表；

7. 其他合同文件。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将

合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

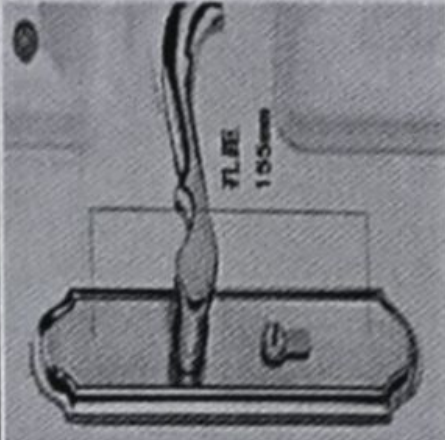
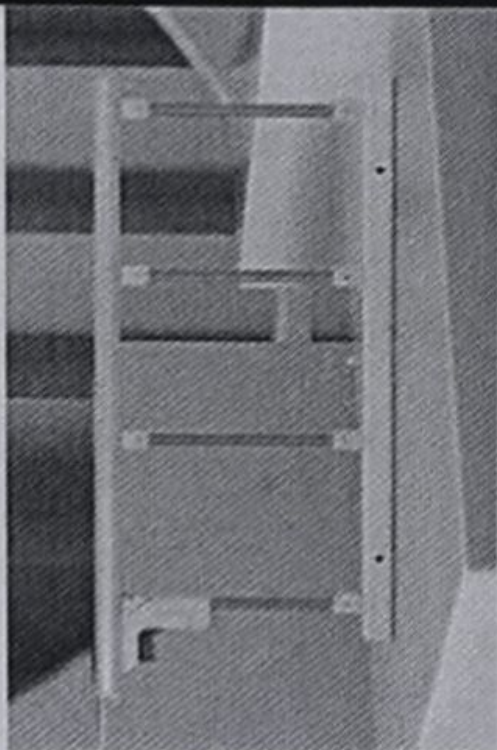
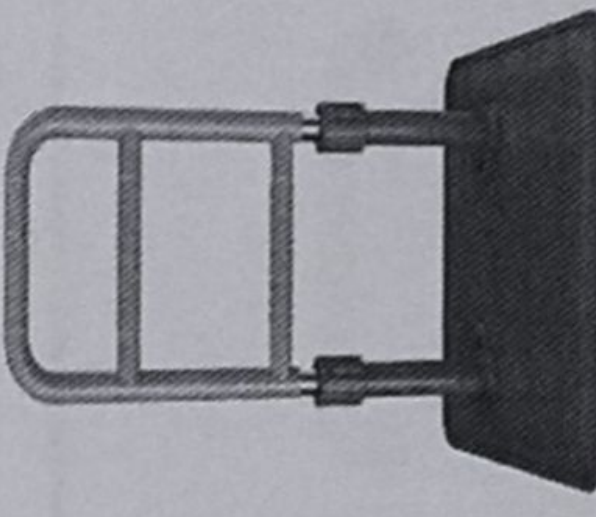
甲方(章): 兴业县民政局  2015年9月21日	乙方(章): 广西福满嘉养老服务有限公司  2015年9月29日
单位地址: 兴业县石南镇建设路76A号	单位地址: 玉林市兴业县石南镇兴业大道南侧雄翔·富安居第4号楼4-03号房
法定代表人:	法定代表人: 梁柱
委托代理人: 张娟	委托代理人:
电话: 0775-3763809	电话: 0775-2223112
开户银行:	开户银行: 广西北部湾银行玉东支行
账号:	账号: 805327264900001
邮政编码: 537800	邮政编码: 537800

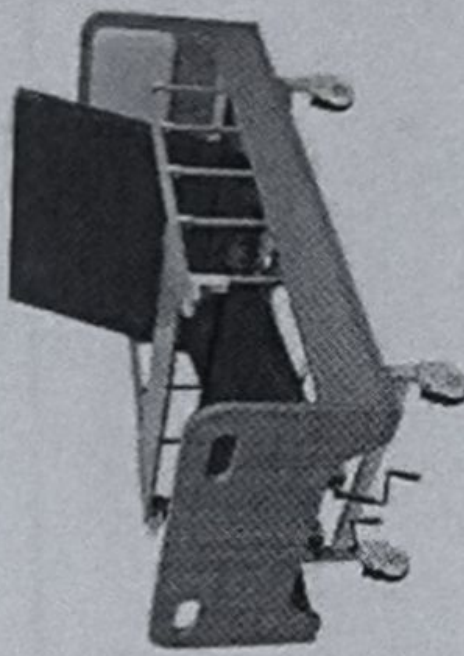
附件:

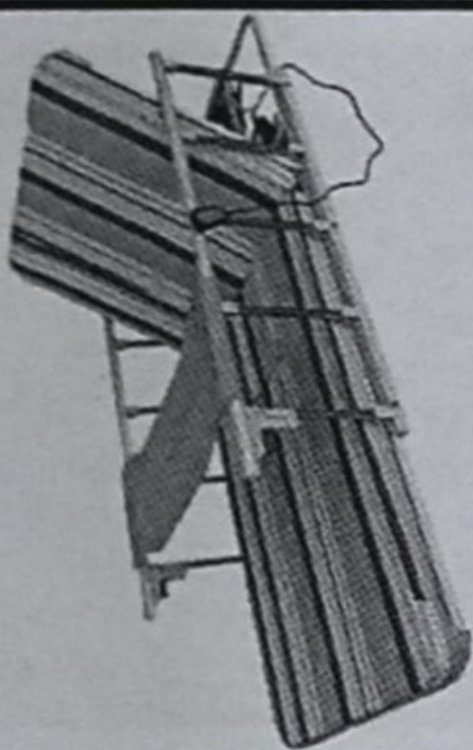
兴业县家庭养老床位基本项目清单

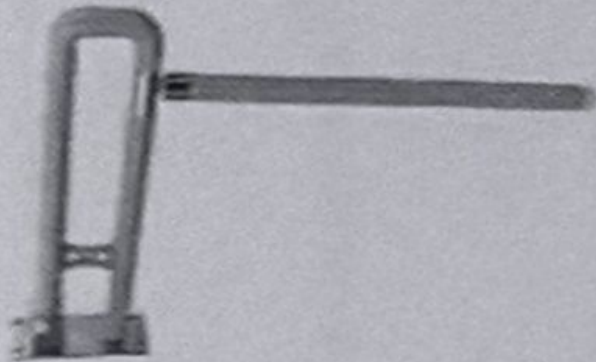
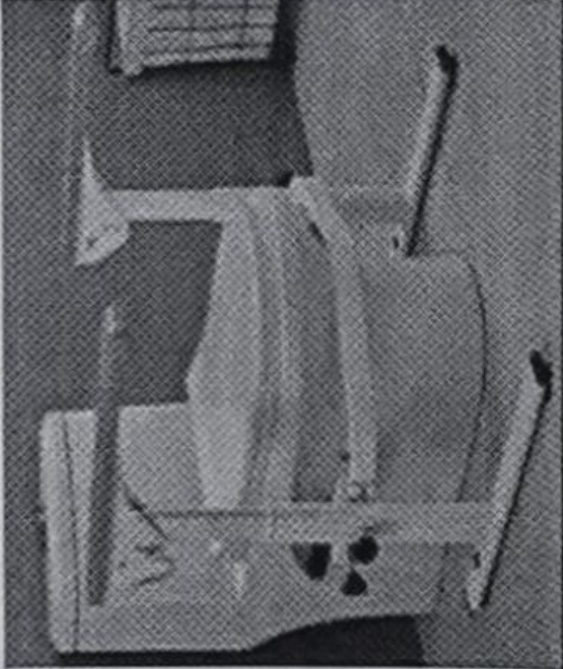
一、适老化改造

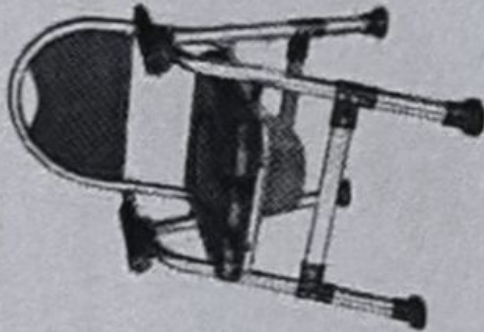
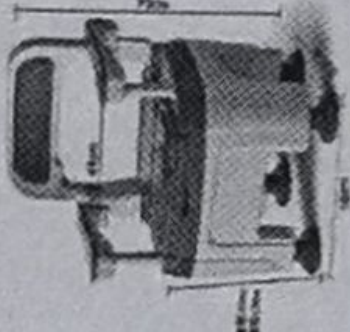
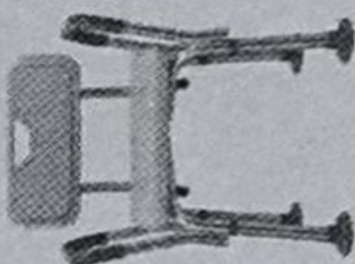
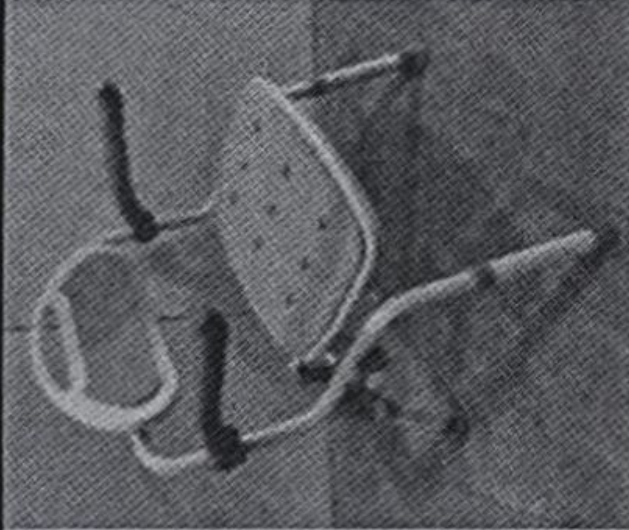
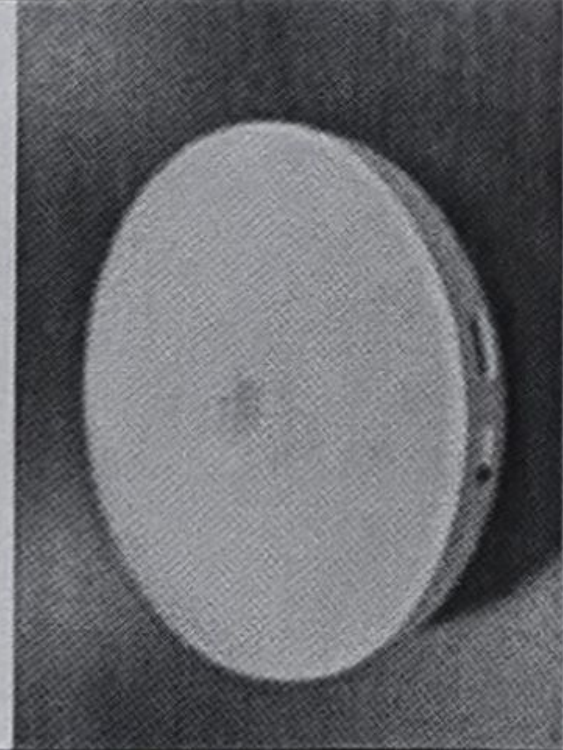
序号	类别	项目名称	项目类型	产品名称	性能指标	产品图片	规格	厂家	单位	单价(元)
1	地面改造	防滑处理	基础	防滑砖	1.老旧破损地砖拆除,垃圾清运,地面处理找平; 2.水泥黄沙底面处理; 3.防滑地砖铺设; 4.含地漏,防水微处理; 5.如非原房屋结构原因,与地砖连接的室内外地面标高差≤		600mm*600mm*8.8mm	北流市新瑞福陶瓷有限公司	平方米	¥268
2				防滑地胶	1.采用PVC材质地板,抗菌防霉易清洗,卫生间、厨房等较湿滑地方; 2.采用防滑系数为>R10,地板、其他处防滑系数为>R9,厚度≥2mm。		产品厚度2.0mm	山东恒生防护制品有限公司	平方米	¥130
3				拼接防滑垫	1.材质:环保软性PVC; 2.尺寸:≥300×300mm; 3.防滑性能好,可任意裁剪拼接; 4.拼接安装,便于清洁拆洗。		30*30*0.84cm	山东知年养老产业发展有限公司	块	¥20
4				防滑脚垫	1.尺寸:≥560×880mm; 2.材质:PVC材质; 3.正面小圆点按摩,背面真空吸盘,可轻松吸附于光滑地面,不会偏移。		产品尺寸:568*885mm 产品材质: PVC; 产品颜色:白/灰/粉/蓝/绿/黄;	山东恒生防护制品有限公司	块	¥45
5		高差处理	基础	水泥坡道	1.材质:水泥、砂子; 2.尺寸:根据门厅、过道等处实际高低差(大于50mm)设计施工样式; 3.坡度坡度比≤1:8(根据现场实际情况定); 4.表面作防滑条纹处理。		施工	施工	平方米	¥518
6				橡胶坡道	1.材质:橡胶; 2.尺寸:根据现场情况进行定制; 3.承重≥500kg,防水防滑; 4.表面凹痕防滑设计,缓冲底座抗压性好,柔韧性强。		承重520kg	山东恒生防护制品有限公司	块	¥265

7		门槛拆除	可选	门槛移除	1.适合水泥地面, 不包括木质结构房屋; 2.拆除原有门槛并清理原水泥层, 定制并安装新门槛与地面瓷砖保持水平。	施工	施工	项	¥ 382
8	门改造	房门拓宽	可选	房门拓宽	1.对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽, 改善通行性, 方便轮椅进出; 2.根据现场条件拆除门边墙体, 门边洞口四周粉刷修补平整; 3.若原有墙面铺贴为瓷砖, 拆除后进行瓷砖铺贴并完成修补(尽量与原墙面瓷砖颜色接近); 4.安装平开门或推拉门(门材质为铝合金或木门, 具体以业主沟通认可为准), 包含门套、门扇、轨道、五金件等; 5.拓宽改造后达到交付使用; 6.砖混结构或现场鉴定为危险结构的不符合改造条件。	施工	施工	项	¥ 1,073
9		下压式门把手改造	可选	下压式门把手改造	拆除原有锁具(含垃圾清理、外运), 安装下压式门把手, 带钥匙; 材质: 面板、把手材质为不锈钢, 锁芯为铝铜。		孔距155mm, 安装孔距110mm 锁芯尺寸: 93mm*60mm 锁舌间距: 60mm 材质: 304不锈钢拉丝	个	¥ 326
10		安装床边护栏(抓杆)		床边护栏	1.材质: 铝合金上管, 加厚不锈钢支架, 含金属连接件, 折叠按键; 2.折叠护栏档位数: ≥3档; 3.护栏高度: ≥40cm; 4.适合平板床、内嵌床, 现场经鉴定床体结构老化, 或不符合安装条件的应停止评估此项。		折叠护栏档位数: 4档; 护栏高度: ≥40cm	个	¥ 176
11			基础	床边扶手	1.底座尺寸约为: 500×600mm; 产品重量不低于13.5kg; 2.高度: 多档可调节; 3.底座采用钢板, 表面烤漆, 稳固安全, 橡胶条包边处理; 4.固定底座立柱套管采用优质碳钢, 采用整体螺丝固定的方式, 安全美观;		底座尺寸约为: 500×600mm	个	¥ 520

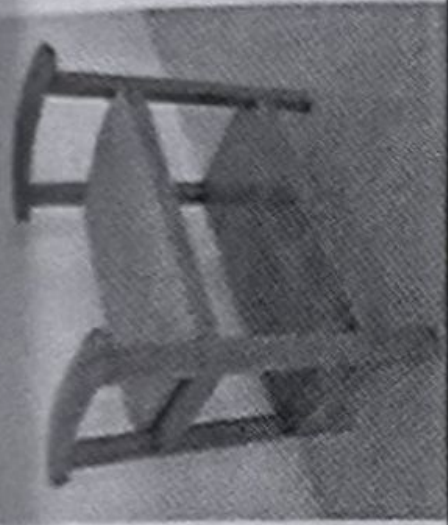
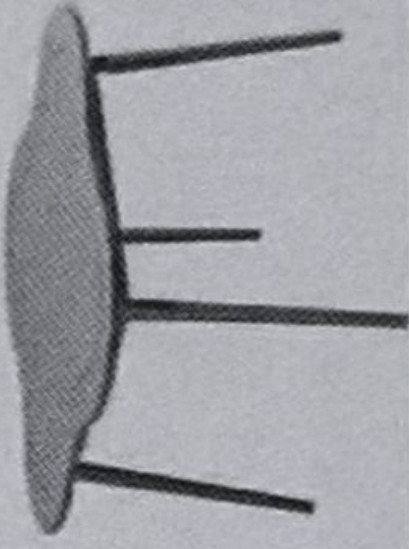
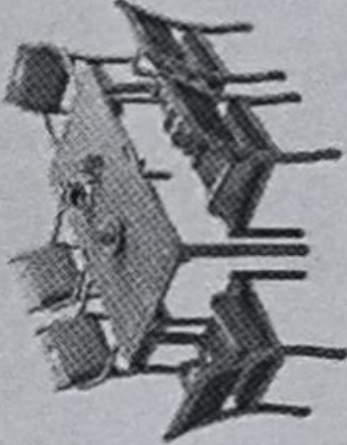
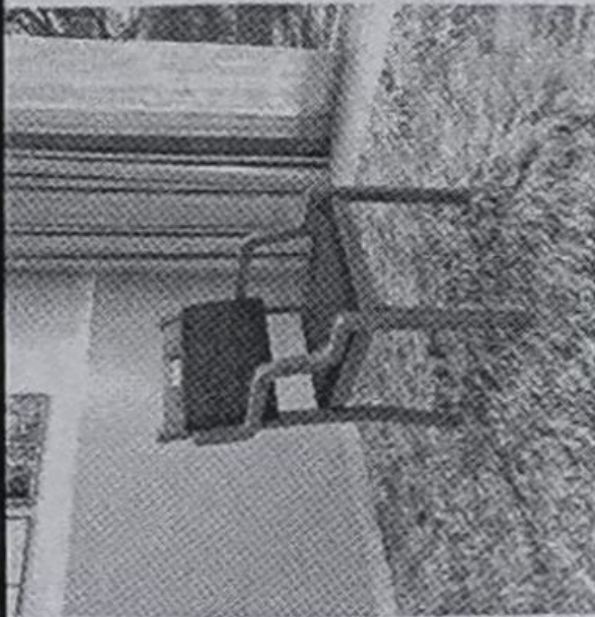
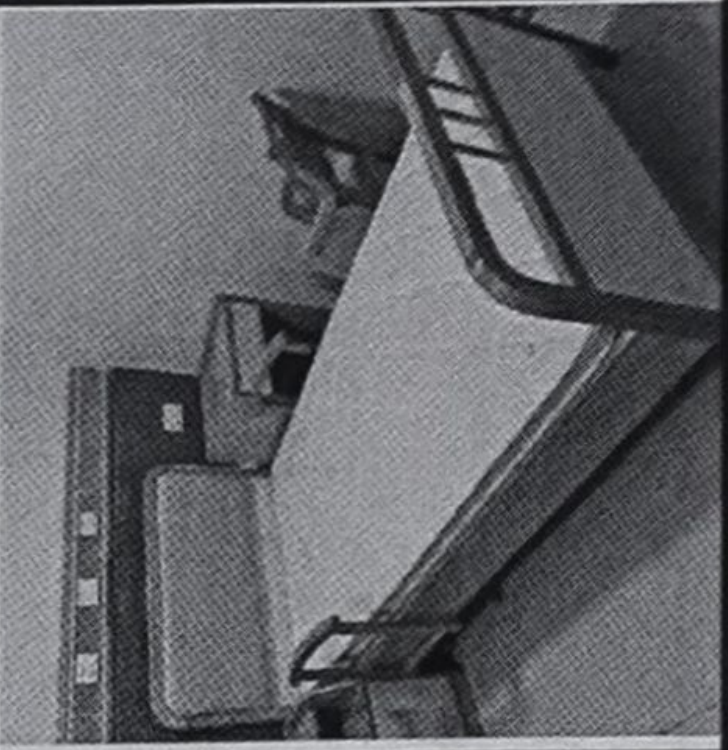
12	配置护理床	手摇护理床	1.尺寸：床内长尺寸不得低于190cm； 2.床头、床尾、护板包围采用木质，床头带软包，护板外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性，耐化学药品性及电气性能优良，材质为颗粒板； 3.床面采用优质无缝碳钢，厚度约1.0mm，便于透气并具有防滑功能，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构； 4.床体骨架采用约40×80×1.0mm的成型方管焊接而成，焊接质量优质，床体坚固，整体承载≥200kg； 5.护栏采用折叠式木纹5档护栏，下管管材为优质碳钢材，连接件采用优质碳钢材，立柱采用优质铝合金管材，坚固耐用，使用方便； 6.配置隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置，不变形，回弹体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用优质钢材加工制作，与丝杠咬合密切，有效地防止磨损，噪音小、寿命长； 7.靠背：0-75°±5°，腿部：0-25°±5°； 8.床垫采用防水布料，美观大方透气性好，厚度≥60mm，棕+棉材质。 9.配置餐桌板，静音轮。		产品尺寸： 2000mm*1020mm*570mm±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸) 内径尺寸 1940mm*900mm*510mm 床架40×80×1.0mm	衡水嘉顿医疗器械有限公司	张	¥1,850
13	配置护理床	电动护理床	1.尺寸：床内长尺寸不得低于190cm； 2.材质：床垫采用优质布料，内部采用40±5mm硬质棕丝，透气性好。20±5mm高密度海绵，回弹力良好，防虫处理，便于拆洗； 3.功能包括起背、抬腿。床面板调节范围：起背0-75°±5°；腿部可升降角度：0-25°±5°； 4.整体载重：≥260kg； 5.四个万向静音轮带刹车功能； 6.配置：颗粒板木质床头床尾+包围+手电双摇+5档木纹护栏+静音轮+床垫+床头软包。 7.可以实现起身、侧翻、处理排泄物等功能。		产品尺寸： 2070mm*960mm*555mm±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸) 内径尺寸 1960mm*900mm*495mm	衡水嘉顿医疗器械有限公司	张	¥3,750

14		起身垫	1.尺寸:床架不小于1900×850mm,床垫(海绵材质)厚度不小于60mm; 2.材质:采用不小于25方管折弯焊接,床面采用交叉式丝网设计,床面具有透气和方孔。不锈钢折叠护栏,搭配木质餐桌; 3.整床承载≥200kg; 4.遥控操作,0~80度自由起背调节; 5.双重抗锈表面处理、磷化处理。		规格外径:约1900*910*80mm	河北厚孚 医疗设备 有限公司	张	¥ 896
15		防压疮坐 垫	1.形状:方形; 2.材质:内胆PVC,外:优质绒;轻巧耐拉伸,承重效果佳; 3.坐垫分布小孔≥9个,与气室交错形成波浪凹凸表层,舒适透气。 4.配备打气筒。		尺寸:不小于420mm*420mm 坐垫分布小孔≥9个	河北新才 医疗器械 有限公司	个	¥ 75
16	配置防压 疮垫	防压疮床 垫	1.尺寸:≥1900×900mm; 2.材质:PVC; 3.条形波动,气条可单独拆卸,方便更换。 4.气道循环充气,床垫表面波动起伏,具有通风换气,预防皮肤组织坏死或细菌滋生。 5.低噪音设计。		规格:床垫尺 寸:2000*900*75mm;气条数量 22条,每根气囊可单独更换	山东恒生 防护制品 有限公司	张	¥ 556
17		防压疮靠 垫	1.型号规格:三角垫R型; 2.内置高密度回弹海绵,久压不变形; 3.选用纯棉面料,舒适透气; 4.R型设计,弧形线条,柔软舒适; 5.拉链式设计,方便拆洗。		产品尺寸500*250*150mm	衡水凤宇 医疗器械 有限公司	个	¥ 89
18		一字形扶 手	1.尺寸:长度≥480mm; 2.外管材质:ABS材质或抗菌尼龙,直径约35mm 3.内管材质:铝合金或不锈钢内管,直径约28mm; 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料,能有效抑制大肠杆菌等细菌,扶手表面采用防滑浮点设计,厚度约为0.5mm。		480mm	山东恒生 防护制品 有限公司	个	¥ 68

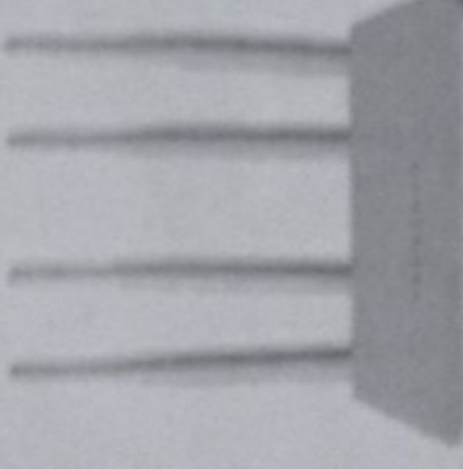
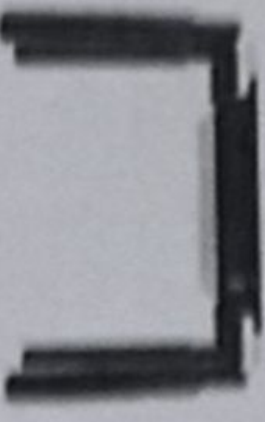
19	安装扶手 基础	U形扶手 1.尺寸: $\geq 600 \times 700\text{mm}$; 2.外管材质: ABS材质或抗菌尼龙, 直径约35mm 3.内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径约28mm; 4.带不锈钢底座, 可上翻; 5.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度约为0.5mm。		产品尺寸600*700mm, 龙骨材质为201不锈钢, 壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, $\phi 35\text{mm}$;	山东恒生防护制品有限公司	个	¥247
20		L形扶手 1.尺寸: $\geq 600 \times 350\text{mm}$; 2.外管材质: ABS材质或抗菌尼龙, 直径约35mm; 3.内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径约28mm; 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度约为0.5mm。		产品尺寸600*350mm, 龙骨材质为201不锈钢, 壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, $\phi 35\text{mm}$;	山东恒生防护制品有限公司	个	¥129
21		135°扶手 1.尺寸: $\geq 450 \times 350\text{mm}$; 2.外管材质: ABS材质或抗菌尼龙, 直径约35mm; 3.内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径约28mm; 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度约为0.5mm。		产品尺寸600*350mm, 龙骨材质为201不锈钢, 壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, $\phi 35\text{mm}$;	山东恒生防护制品有限公司	个	¥132
22		T形扶手 1.尺寸: $\geq 700 \times 500\text{mm}$; 2.外管材质: ABS材质或抗菌尼龙, 直径约35mm; 3.内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径约28mm; 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度约为0.5mm。		产品尺寸700*500mm, 龙骨材质为201不锈钢, 壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, $\phi 35\text{mm}$;	山东恒生防护制品有限公司	个	¥154
23	如厕洗浴设备改造	坐便助力扶手 产品尺寸: $\geq$ 高度6档调节; 产品材质: PP+钢管组装式支架; 扶手架高强度碳钢管焊接而成, 整体喷塑处理不易生锈; 管内留有排水孔, 防止管内储水生锈; 扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。 产品承重$\geq 100\text{kg}$。		产品尺寸:640*460*565-715mm(高度6档调节)	瑞安市永 久亮无障 碍设施有 限公司	个	¥355

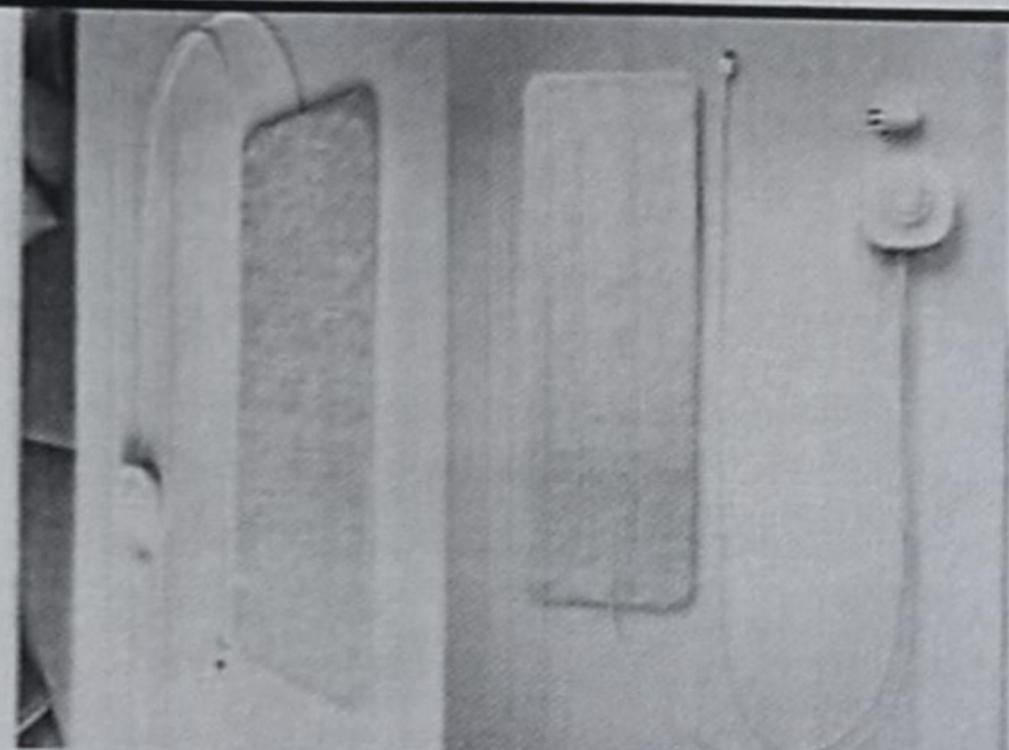
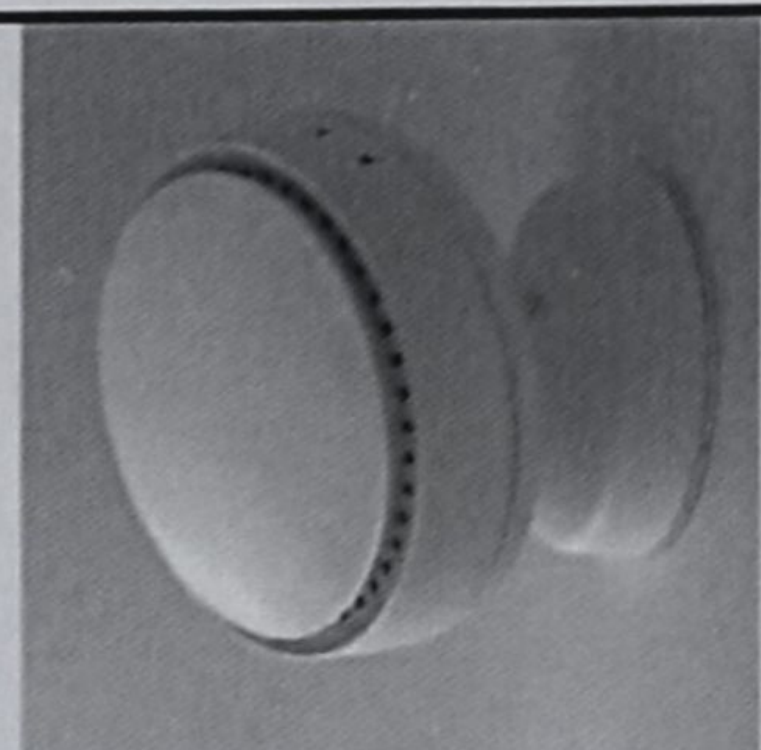
24	马桶增高器	1.材质: 铝合金材质; 2.尺寸: 与马桶相适应; 3.两侧配备PU扶手, 免工具安装。		产品尺寸:550*460*115mm	山东恒生防护制品有限公司	个	¥ 256
25	移动坐便椅	1.材质: 不锈钢材质; 2.安全承重: ≥100kg; 3.可折叠设计; 4.吹塑双盖板, 配有底桶。		产品尺寸:长64-69CM 宽56.8CM	衡水顺和医疗器械有限公司	个	¥ 260
26	移动坐便器	1.材质: 安全PP, 软靠垫、坐垫PU材质; 2.实心内桶可拆卸, 扶手可抬; 3.高度可调节。		产品尺寸:56*53*73cm	山东知年养老产业发展有限公司	个	¥ 350
27	普通淋浴椅	1.承重≥100kg, 漏水、透气; 2.铝合金材质, 高度不低于5档调节; 3.坐板根据人体工程学设计, 脚垫采用凹型吸盘大脚垫, 带扶手靠背, 外置花洒口。		产品尺寸:总高(73~83CM)/总宽(56CM)/坐宽(40CM)	山东恒生防护制品有限公司	张	¥ 328
28	配置淋浴基础 折叠淋浴椅	1.材质: 椅架采用高强度铝合金材质; 2.表面喷塑处理, 座板和靠背材质为高密度PE, 扶手材质为加强尼龙; 3.防霉防滑TPE材质脚垫座板和靠背, 可加装EVA软垫座板; 4.高度≥6档调节; 5.产品承重≥100kg。		产品尺寸:宽58cm,长53cm,总高73-83cm,坐高39-49cm	中山市佳乐康复医疗器械有限公司	张	¥ 356
29	灯源改造基础 自动感应灯	1.尺寸: 直径≥80mm; 2.感应角度: 120度, 感应距离: 3~5m。 3.灯珠: LED灯珠 4.光色: 暖白光。 5.充电方式: USB充电; 6.可手持、可磁吸, 免布线。		额定值:5V--1A 0.7W	宁波锦美珂智能科技有限公司	个	¥ 60

30	电源插座及开关改造	可选	老旧线路改造	1.更换室内老化或裸露的电气线路; 2.明线布线, 整体保证横平竖直; 3.铜芯规格: 空调、热水器、油烟机线4mm², 插座线2.5mm², 灯具线1.5mm²; 4.内芯材质: 高纯度无氧铜; 5.国标纯铜, 节能阻燃, 安全环保; 6.PVC套管保护。	施工	施工	米	¥100
31			插座改造	1.拆除原老旧插座或安装新插座, 根据老人需要调整高度; 2.插座材质PC阻燃、锡磷青铜、钢架。	温州白雕电器科技有限公司	86*86mm	个	¥60
32			开关改造	1.拆除原老旧开关, 根据老人需要调整高度; 2.面板: 窄边框、圆角设计、小角度开合, 带夜间荧光。	温州白雕电器科技有限公司	86*86mm	个	¥60
33			防撞护角	1.尺寸: 约60×60mm; 2.材质: 丁腈橡胶 (NBR), 防水耐油; 3.加厚, 双面胶粘贴, 不伤家具。	山东恒生防护制品有限公司	约60×60mm	个	¥5
34	安装防撞护角/防撞条、提示标识	可选	防撞条	1.长: 约2000mm; 2.材质: 橡胶; 3.墙边包角处理; 4.双面胶粘贴。	山东恒生防护制品有限公司	长度: 2米;	条	¥16
35			警示条	1.尺寸: ≥长1000mm×宽100mm×厚6mm; 2.材质: 橡胶/塑胶, 嵌入式高亮度黄色反光材质; 3.功能: 防火阻燃, 防滑耐磨, 起到有效警示和保护作用。	定制	≥长1000mm×宽100mm×厚6mm	张	¥10

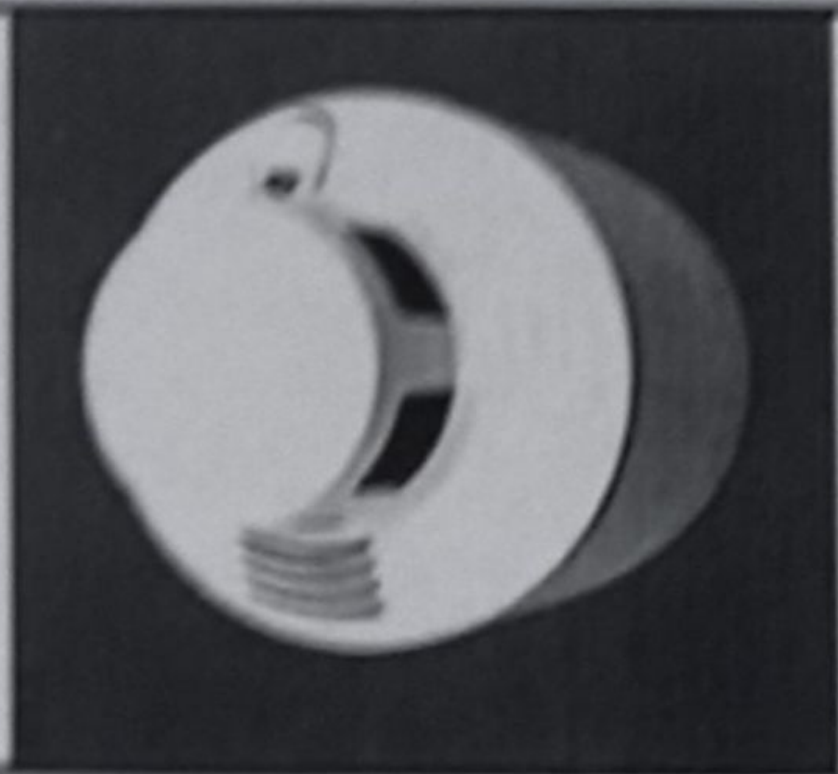
36	适老家具配置	换鞋凳	1.尺寸: $\geq 600 \times 400 \times 600\text{mm}$; 2.材质: 优质橡胶木, 木质细腻, 具有较好的总体强度性能, 良好的抗震力; 3.座面布艺或PU皮软包, 防水、防褥疮, 不易变形, 内部优质海绵结构; 4.座面两侧设有抓手及拐杖凹槽。		产品尺寸: $600 \times 400 \times 600\text{mm}$	山东恒生防护制品有限公司	张	¥408
37	适老家具配置	适老方桌	1.尺寸: $\geq 800 \times 800 \times 750\text{mm}$; 2.实木框架, 采用橡胶木实木; 3.台面: 多层板贴木皮饰面或实木桌面, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺, 含适老四角抓手; 4.国内环保油漆。		产品尺寸: $800 \times 800 \times 750\text{mm}$	德州亿宁通家居有限公司	张	¥793
38		适老长桌	1.尺寸: $\geq 1600 \times 800 \times 750\text{mm}$; 2.实木框架, 采用橡胶木实木; 3.台面: 多层板贴木皮饰面或实木桌面, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺, 含适老抓手。 4.国内环保油漆。		$1600 \times 800 \times 750\text{mm}$	山东恒生防护制品有限公司	张	¥980
39		适老椅	1.尺寸: $\geq 540 \times 550 \times 850\text{mm}$; 2.实木框架: 采用橡胶木实木, 木质细腻, 硬度高, 具有较好的强度性能, 良好的抗震力; 3.扶手: 弯曲半扶手设计, 边角处采用倒圆工艺; 4.靠背: 高密度海绵, 防止褥疮, 耐磨防水; 5.坐垫: 坐面布艺或PU皮软包, 防水、防褥疮, 不易变形, 内部优质海绵结构。		$540 \times 550 \times 850\text{mm}$	山东恒生防护制品有限公司	张	¥408
40		适老化床头柜	1.尺寸: $\geq \text{长}400 \times \text{宽}400 \times \text{高}650\text{mm}$; 2.材质: 多层免漆板。		规格: $430 \times 400 \times 650\text{mm}$	山东恒生防护制品有限公司	个	¥450
41		居家适老床	1.尺寸约: $\geq 2000 \times 1200 \times 450\text{mm}$; 2.材质: 实木床头床尾, 床边附有实木扶手; 3.软包: 采用耐磨超纤皮或优质布艺, 质感需柔和, 抗划、耐脏性能好; 4.工艺: 无尖角, 四角需倒安全圆弧, 倒菱角、圆角、圆形均匀一致, 自装配, 拆装产品零件结合应牢固严密, 家具整体结构牢固, 平衡, 专业化适老设计。 5.不包含床垫。		产品尺寸: $2020 \times 1220 \times 1120 \pm 30\text{mm}$	山东恒生防护制品有限公司	张	¥2,000

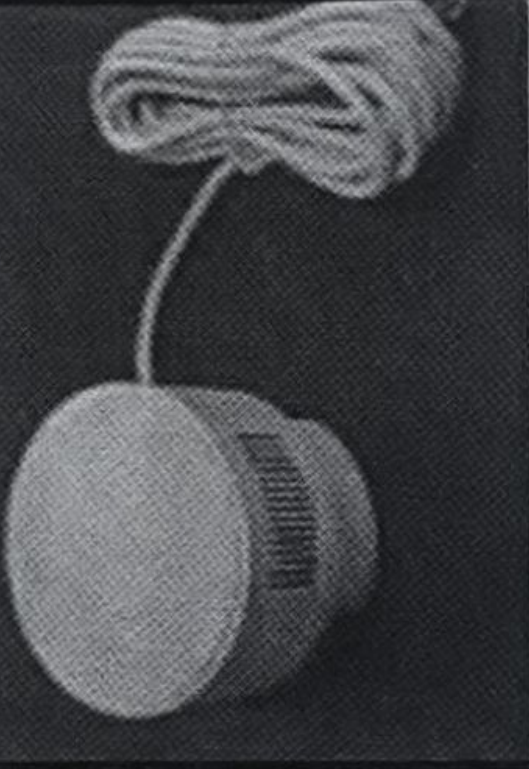
二、智能化改造

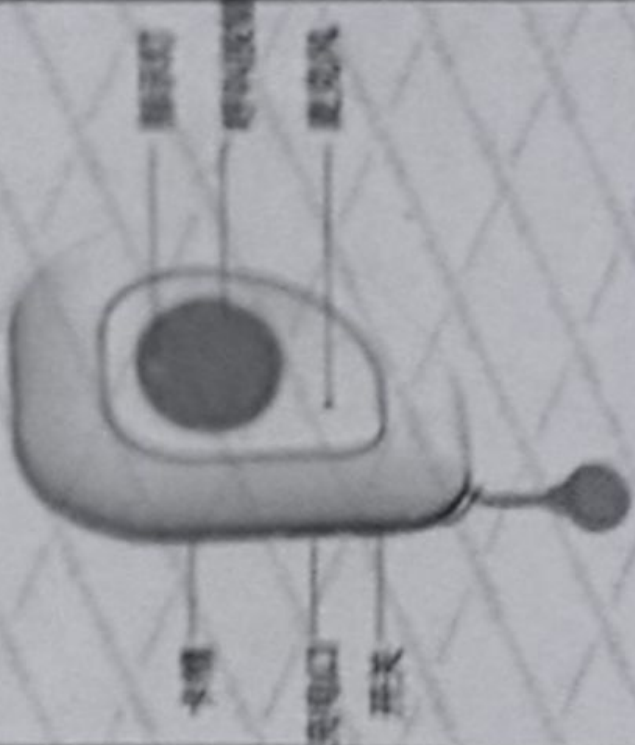
序号	类别	项目名称	项目类型	产品名称	性能指标	产品图片	规格	厂家	单位	单价(元)
1	网络传输设备	WiFi路由器	基础型(任意其一)	4G路由器	1.网口: 4xLAN; 2.供电方式: DC供电; 3.无线速率: 不低于300Mbps; 4.加密方式: 支持WPA/WPA2等, 包含2年流量; 5.支持4G全网通, 保障网络传输		网口: 4xLAN	深圳市拓实科技有限公司	个	¥600
2		无线网卡		无线网卡	1.USB接口, 支持Wi-Fi; 2.无线速率不低于300Mbps, 内置天线; 3.可连接用户≥10个; 4.附2年流量, 满足相关传感设备正常使用需要。		USB接口, 支持Wi-Fi	深圳市摩斯物联科技有限公司	个	¥450
3				床头呼叫器	1.主要服务高龄独居老人, 按紧急呼叫键, 设备自动拨打2个以上预设的求助电话; 2.当前一个电话无法接通时, 设备自动拨打下一个号码; 3.紧急呼叫实时推送至子女手机起到应急响应的作用; 4.设备状态信息需按要求对接到玉林市智慧养老平台。		97mm*97mm*26mm	惠州市博实智能技术有限公司	个	¥250
4	紧急呼叫设备	卫生间呼叫器	基础型	卫生间呼叫器	1.带拉绳, 安装于卫生间, 当老人出现紧急情况时, 可以一键呼叫; 2.通信方式: NB-IOT或4G (全网通) 3.触发方式: 拉绳或者拉绳 4.安装方式: 壁挂; 5.坐便器边或可拉绳面板触控按键, 按钮时可拉动拉绳按键; 6.呼叫信息实时推送至紧急联系人手机, 起到应急响应的作用; 7.设备数据按格式对接到玉林市智慧养老平台。		86x86x30mm	深圳市博实智能技术有限公司	个	¥180

5	生命体征监测设备	智能腕表	1.用于监测失智老人或其他精神障碍老人定位,避免走失; 2.实现紧急情况下求救,轨迹查询、实时定位、佩戴状态监测; 3.若老人外出走失,能够及时定位老人当前位置信息,帮助老人亲属及时找到并救助老人。 4.含2年4G网络通讯费。 5.设备状态信息需按要求对接到玉林市智慧养老平台。		55*42*17mm 55g	深圳市赞为科技有限公司	个	¥456
6	智能腕表等监测设备	睡眠看护带	1.通信方式: WiFi/4G (全网通); 2.传感垫尺寸要求: 长宽≥700mm×50mm; 3.实时监测: 心率、呼吸率、离床警示; 4.传感器构成: 至少1路高灵敏度压电薄膜+至少2路柔性织物压力传感器 (防水等级≥IPX6) 5.被动报警功能: 夜间异常情况系统自动触发报警; 6.实现健康评估及睡眠质量评估; 7.每日可生成自然语言健康分析报告,疾病初筛功能: 可监测呼吸暂停综合征指数; 8.断线续传: 当通讯中断时可在本地存储不少于300分钟的数据; 9.预警数据实时推送给老人紧急联系人。 10.设备状态信息需按要求对接到玉林市智慧养老平台。		传感垫尺寸 750mm(长)*240mm (宽)*2mm(厚)	博博科技(苏州)有限公司	张	¥850
7		毫米波生命体征检测设备	1.可识别用户在床姿态与状态: 包括坐姿、躺姿、坠床;可实时识别用户清醒、睡眠状态。 2.呼吸率测量范围: 0~30bpm, 呼吸率在10~30bpm范围内, 最大误差±2bpm; 3.心率测量范围: 40~155bpm, 心率在60~120bpm范围内, 最大误差±5bpm; 4.设备需具备睡眠分析功能: 可记录用户上床时间、入睡时间、醒来时间、起床时间, 误差≤10分钟; 可记录用户睡眠过程中的起夜次数、呼吸暂停次数、低通气次数及对应时间; 需具备呼吸心率异常、呼吸暂停告警功能, 告警阈值用户可自行设置。 5.设备状态信息需按要求对接到玉林市智慧养老平台。		81mm×27mm	长沙苗米科技有限公司	个	¥840

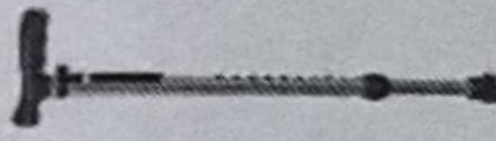
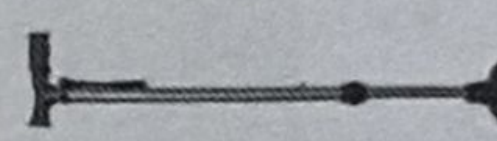
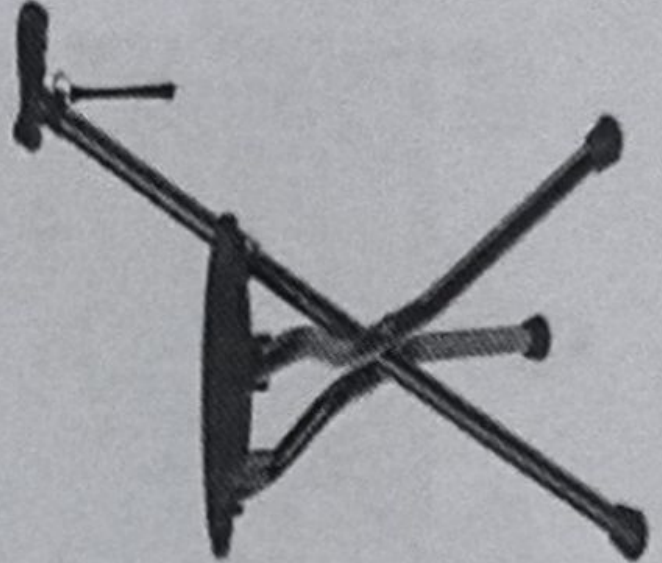
15.5
14.5

8	可安装在吊顶、墙壁及地面。监测火灾造成空气中的烟雾浓度以及光照、一氧化碳浓度、设备温度。	1. 通信方式: NB-IOT或4G (全网通); 2. 供电方式: 锂电池; 太阳能; 有线供电; 3. 探测原理: 内置MCT红外光电探测电路; 4. 探测原理: 红外探测; 5. 探测原理: 红外探测; 6. 探测原理: 红外探测; 7. 探测原理: 红外探测; 8. 探测原理: 红外探测; 9. 探测原理: 红外探测; 10. 探测原理: 红外探测;		外形尺寸: 90mm x 65mm	深圳特威 消防设备有限公司	个	个	个
9	本产品采用先进的红外探测技术，能够快速准确地探测火灾产生的烟雾。本产品具有体积小、安装方便、使用寿命长等特点。本产品适用于家庭、办公室、商场、酒店等场所的火灾探测。	1. 通信方式: NB-IOT或4G (全网通); 2. 供电方式: 锂电池; 太阳能; 有线供电; 3. 探测原理: 内置MCT红外光电探测电路; 4. 探测原理: 红外探测; 5. 探测原理: 红外探测; 6. 探测原理: 红外探测; 7. 探测原理: 红外探测; 8. 探测原理: 红外探测; 9. 探测原理: 红外探测; 10. 探测原理: 红外探测;		外形尺寸: 90mm x 65mm	深圳特威 消防设备有限公司	个	个	个
10	本产品采用先进的红外探测技术，能够快速准确地探测火灾产生的烟雾。本产品具有体积小、安装方便、使用寿命长等特点。本产品适用于家庭、办公室、商场、酒店等场所的火灾探测。	1. 通信方式: NB-IOT或4G (全网通); 2. 供电方式: 锂电池; 太阳能; 有线供电; 3. 探测原理: 内置MCT红外光电探测电路; 4. 探测原理: 红外探测; 5. 探测原理: 红外探测; 6. 探测原理: 红外探测; 7. 探测原理: 红外探测; 8. 探测原理: 红外探测; 9. 探测原理: 红外探测; 10. 探测原理: 红外探测;		外形尺寸: 90mm x 65mm	深圳特威 消防设备有限公司	个	个	个

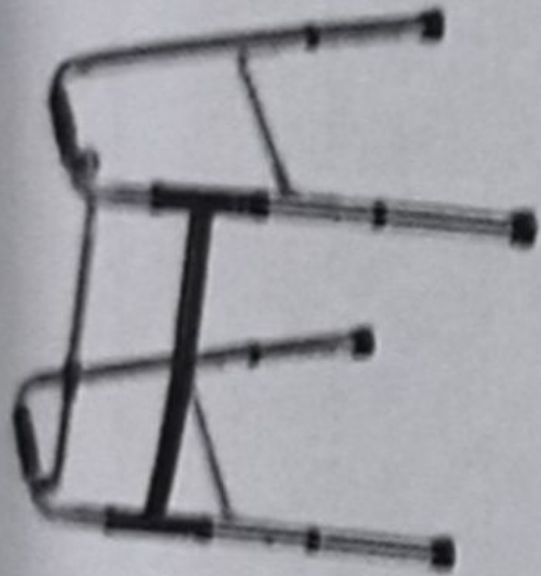
11	毫米波跌倒监测仪	可选	毫米波跌倒监测仪	一、设备技术参数: 1.电磁频段: 60GHz; 2.天线覆盖范围: 120°; 3.最大探测距离: ≥6m; 4.网络传输方式: 支持WIFI或4G; 二、产品功能要求: 1.能准确判断跌倒, 包括: 向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下, 三个方向的判断准确率不低于95%; 检测到室内人员跌倒时, 会自动发出报警信息。 2.增强功能可以准确识别目标站、坐、躺、跌倒四种姿态, 单人情况下, 四种姿态识别综合准确率不低于95%, 两人情况下, 四种姿态识别综合准确率不低于90% 3.同一监测区域内, 最大支持不少于3个目标的姿态判定。 4.设备可以根据运营要求可提供久坐提醒、夜间离床告警功能。 5.单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。 6.具备大数据处理能力, 可根据老人身高和形体状态, 可快速设置科学判断跌倒的参数等。 7.支持在淋浴房 (玻璃材质) 监测, 监测设备需防水。设备需可以排除淋浴过程中花洒的影响, 可以准确报警。 8.设备状态信息需按要求对接到玉林市智慧养老平台。		产品尺寸: 81mm×27mm	南京苗米科技有限公司	个	¥860
12	智能监控摄像头		智能监控摄像头	1.像素: ≥300万 2.最大红外监控距离≥10米 3.支持图像翻转, 适用不同监控环境; 4.支持H.265、H.264, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境; 5.内置麦克风和扬声器, 支持SD卡; 6.支持跌倒检测。 7.支持语音求助检测, APP可接收到推送的消息。 8.支持语音提醒(自定义用药提醒、休息时间提醒等)。		产品尺寸 90mm×90mm×107.4mm (长×宽×高) 包装尺寸 110mm×110mm×150mm (长×宽×高)	杭州华橙网络科技有限公司	个	¥599

13	智能水表设备	智能水表设备	智能水表设备	工作电源：电池供电； 2.定位模式：GPS+基站双模式； 3.电池容量：≥1000mAh； 4.功能：手持便携模式，可实现一键双向实时语音通话（发射和接收），支持语音聊天功能，定时提醒、实时定位、事件提醒功能； 5.支持北斗定位； 6.支持电池电量和信号强度数据上传，实现低电量和信号报警； 7.支持物联网流量卡打电话； 8.设备状态信息需按需求对接到玉林市智慧养老平台。 （注：以上提到的物联网流量卡并非普通手机卡，而是物联网卡，无通话时长）		电池容量：1000mAh；	江苏亨通信息科技有限公司	个	¥454
14	门磁感应设备	门磁感应设备	门磁感应设备	安装于进出主门，起到防盗（防恶意闯入）以及记录老人活动轨迹的作用； 1.通信方式：NB-IoT或4G（全网通） 2.供电方式：电池供电支持周期上报，间隔小于24小时支持低电压/故障数据上报 3.支持电池低电量告警 4.预警数据实时推送给老人紧急联系人。 5.设备状态信息需按需求对接到玉林市智慧养老平台。		通信方式：NB-IoT或4G（全网通） 输入5V 0.1A	深圳市通直智能科技有限公司	个	¥162
15	红外探测设备	红外探测设备	红外探测设备	安装于室内必经通道，起到防盗（防恶意闯入）以及记录老人活动轨迹的作用； 1.感应距离：8-12M； 2.通信方式：NB-IOT或4G（全网通）； 3.电池容量：≥800mAh； 4.低电量报警：支持； 5.支持电池电量和信号强度数据上传； 6.支持低电量和信号弱报警； 7.预警数据实时推送给老人紧急联系人； 8.设备状态信息需按需求对接到玉林市智慧养老平台。		113X55X38mm	深圳市通直智能科技有限公司	个	¥203

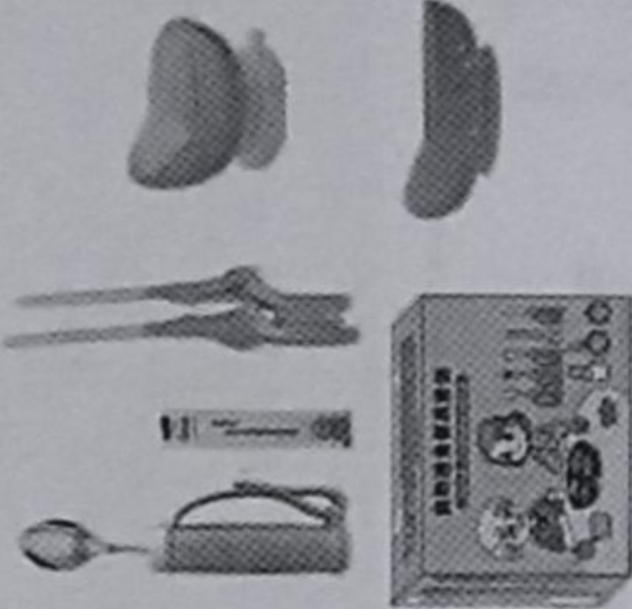
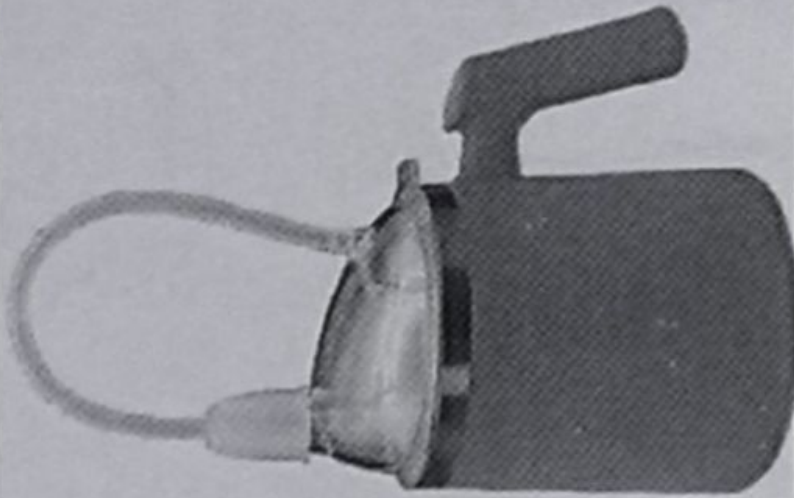
三、老年用品

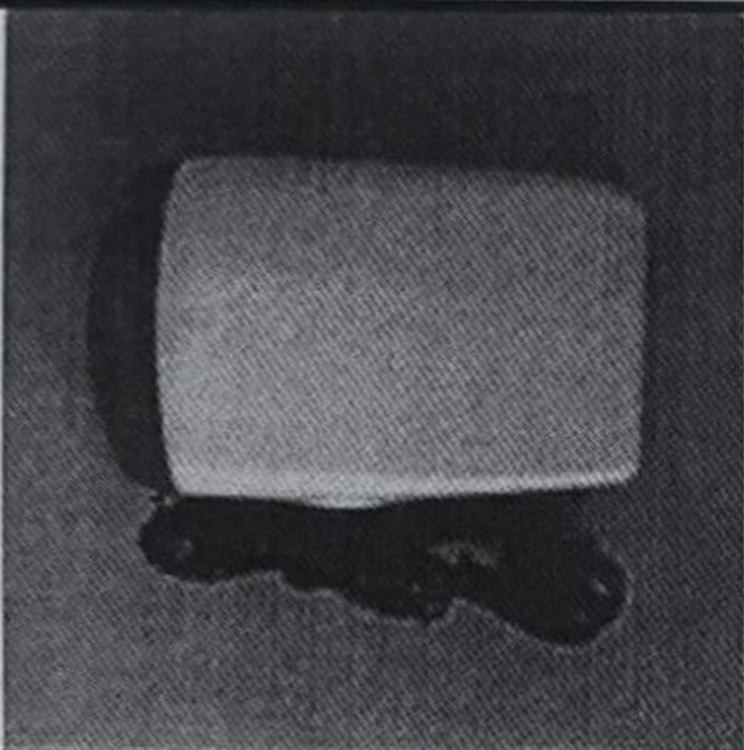
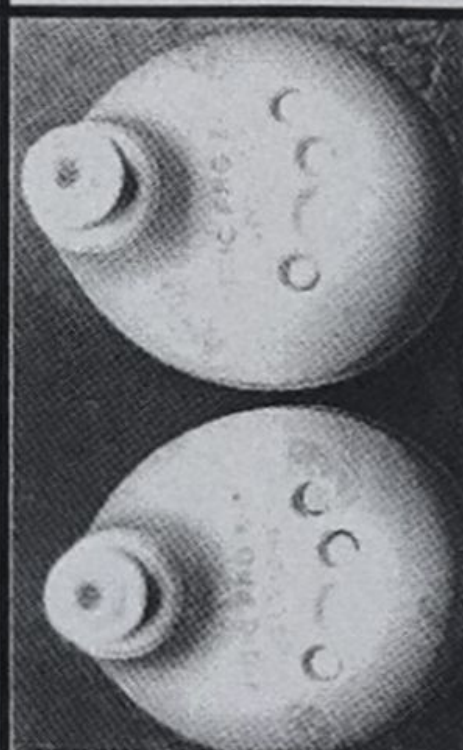
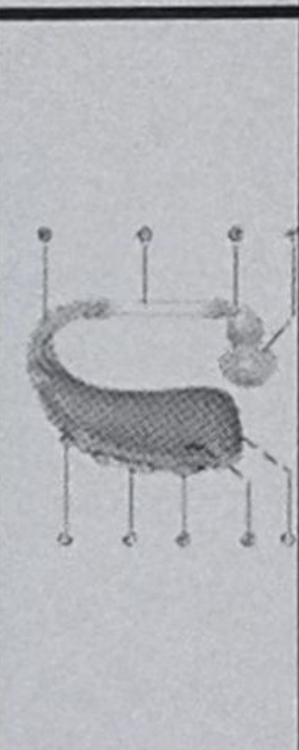
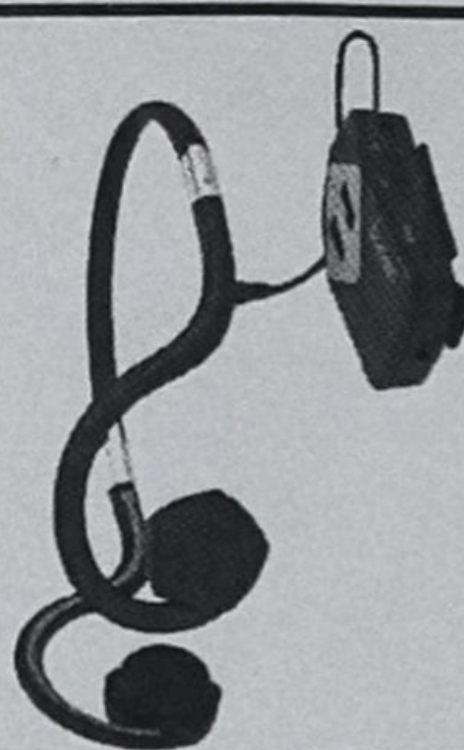
序号	类别	项目名称	项目类型	产品名称	性能指标	产品图片	规格	厂家	单位	单价(元)
1				单脚手杖	1.高强度铝合金管材, 表面阳极氧化处理, 大圆单头拐杖脚; 2.高度10档可调节, 适合不同身高的人使用。		10档可调节	山东恒生防护制品有限公司	根	¥69
2				三脚手杖	1.高强度铝合金管材, 表面阳极氧化处理; 2.高度10档可调节, 适合不同身高的人使用。		10档可调节	山东恒生防护制品有限公司	根	¥96
3		手杖		四脚手杖	1.材质: 铝合金; 2.尺寸: 10孔调节; 3.管壁采用加厚优质铝合金材质, 承重力强, ABS防滑带灯把手。		10档可调节	山东恒生防护制品有限公司	根	¥122
4				凳拐	1.材质: 座板采用ABS材料或PVC座板, 座板加大加宽, 座面有六位按摩凹凸点。橡胶防滑脚垫; 2.≥5档高度可调; 3.折叠设计, 携带方便;		≥5档高度可调	山东恒生防护制品有限公司	根	¥153

5	手动轮椅	1.产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准; 2.车架:铝合金车架,采用固定式扶手,固定式脚踏,锁紧装置可靠,安全性能好; 3.前轮:360度万向8寸加厚实心前轮,配一体冲压成型金属拐臂,强度高不变形,配置优质碗轴承。 4.后轮:24寸铝合金轮毂、PU实心胎,配置金属手轮圈。 5.刹车:前后都有刹车,驻车采用钢制肘节式刹车装置,刹车装置制动后低于座位面,方便使用者上下车 6.座靠垫:采用牛津布加厚海绵坐垫,双翻设计,透气舒适,缝边牢固整齐; 7.护板:选用金属护板。 8.脚踏板:配置金属脚踏板,脚踏板高度可调,脚踏板可开合。 9.安全带:座位配有扣安全带。 10.配有护腿带,防止小腿后移,更加安全。		主要尺寸及参数 外形尺寸 --总长, 1000mm - 1200mm; --总宽, 550mm - 680mm; --总高, ≥ 1400mm; --折叠宽度, ≤ 300mm。 质量, ≤ 22kg。前轮规格, 6寸-8寸。 后轮规格, 16×1.75 - 24×13/8。	衡水金尚 医疗器械 有限公司	辆	¥ 698
6	电动轮椅	1.车架:采用优质钢管焊接组成,表面烤漆处理,美观耐用防生锈,整体可折叠;配备可调节安全带; 2.前轮:直径≥10寸环保型无污染、加宽、加厚高弹性聚氨酯实心轮胎,配置为高强度工程塑料轮毂; 3.后轮:直径≥16寸钢充气减震轮胎,前后轮结构牢固可靠,保证轮椅的抗颠簸性能,以适合不同路面的使用要求。 4.坐垫及靠背:采用优质防水帆布及透气网布材料制成,可拆卸清洗方便,缝边牢固整齐,无褶皱; 5.可上翻式扶手,可拆卸式挂脚,方便使用者从侧面上下轮椅,并配备防后仰安全支架,锁紧装置可靠,安全性能好; 6.脚踏板:优质尼龙塑料注塑而成,坚固耐用,上下折叠方便,多档可调;配备安全护腿; 7.智能操控:智能控制,即停即走,手自一体模式; 8.离合轻松切换基本参数:电机250W×2,速度0-6km/h,1次性充满电行程≥15km,铅酸电瓶。		尺寸:展开106*62*96cm±1cm; 折叠76*39*74cm±0.5cm	浙江金匠 健康科技 有限公司	辆	¥ 2,800

7	轮椅/助行器	框式助行器	1.材质: 铝合金, 把手采用高密度PVC材质, 防滑不断裂; 2.腿部高度≥5档可调, 适合不同身高; 3.双把手设计, 适用不同环境使用; 4.支持折叠。		腿部高度≥5档可调	山东恒生医疗器械有限公司	个	¥250
8		轮式助行器	1.简易式助行器, 大架铝合金材质; 2.可折叠, 腿部高度≥5档可调节, 带约5寸前小轮; 3.双把手设计, 适用不同环境使用; 4.支持折叠。		可折叠, 腿部高度≥5档可调节	山东恒生医疗器械有限公司	个	¥300
9	老年用品	助行推车	1.尺寸: ≥长60×宽75cm, 高度可调; 2.材质: 主架铝合金管, 厚度≥1.25mm; 3.全新折叠设计 4.加轮加坐板配合使用。		75CM*66CM高度可调	山东恒生医疗器械有限公司	辆	¥390
10		老年购物助行车	1.车架采用加厚钢管材质。 2.配有手闸, 固定扶手, 可坐、可推行。 3.配有可拆卸购物兜, 可折叠设计。 4.车把高低可调。		铝合金骨架, 宽度: 620mm; 总长690mm; 座宽460mm; 座深250mm;	山东恒生医疗器械有限公司	辆	¥450

5项
任选三

11	放大装置	放大镜	1.光学放大倍数≥10倍; 2.带LED灯; 3.镜片直径≥125mm。		放大倍数: 主镜10X/辅镜20X、 镜片直径: 主镜125mm/辅镜 25mm、	义乌市魔 方镜光学 仪器有限公司	个	¥ 40
12		放大镜指 甲钳	1.材质: 碳钢+ABS; 2.功能: 带有放大镜。		尺寸: 107*15mm; 材质: 碳 钢镀铬ABS;	山东知年 养老产业 发展有限 公司	个	¥ 40
13	自助进食 器具	自助进食 器具	助餐碗: 碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座, 碗口高护档设 计, 防止食物洒出; 助餐盘: 碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座, 盘口高护档设 计, 防止食物洒出; 助食筷: 尺寸≥20cm (长), 筷体/筷头材质: ABS/食品级 PC。 助餐勺: 尺寸≥20cm (长), 勺柄/勺头材质: ABS/304不 锈钢。		助食勺: 250*32mm勺头≈ 40mm 助食筷: 220*76mm, 食品级 PP+天然竹子 助食碗: 130*100 食品级PP+食品级硅胶 助食盘食品级PP塑料; 规格尺 寸: 19CM(直径)、400毫升水	山东知年 养老产业 发展有限 公司	套	¥ 231
14		饮水杯 (壶)	1.内胆材质: SUS304; 2.容量: ≥400ml; 3.吸嘴: 硅胶材质; 4.其他: 含重力球吸管。		容量: ≥400ml;	山东知年 养老产业 发展有限 公司	个	¥ 100

15	盒式助听器	1.助听器外形端正、色泽应均匀,表面应无毛刺飞边、凹陷、划痕等缺陷。 2.助听器的文字与符号应清晰、准确、牢固;音量调节变化方向应以文字或数量直观表示,电池极性应有相应的标记。 3.助听器各零部件应装配齐全、固定可靠,各调节钮、开关应灵活、有效。 4.耳机、插座与导线接插有效。 5.电声性能: (1) 输入声压级为90dB时的输出声压级(OSPL90)。检测值之差应不大于±3dB范围。 (2) 最大饱和声压级OSPL90应符合产品技术要求。 (3) 高频平均值5SPL90应符合产品技术要求。 (4) 满档增益(高频平均值)应符合产品技术要求;检测值之差应不大于±4dB范围。 (6) 总谐波失真应≤7%+3%;测试值应不大于12%。 (7) 助听器基本频响曲线应不窄于400Hz~3500Hz。		6.8x4.4x1.9cm	中山市小榄镇森蓝电子厂	个	¥ 356
16	耳内助听器	1.饱和声输出: 111dB SPL; 2.峰值增益: 40±5dB; 3.高频平均增益: 35±5dB; 4.等效输入噪声: ≤23.4dB; 5.谐波失真: ≤3%;模拟机; 6.频响范围: 200Hz~7200Hz;		MCIC PRO 801	厦门新声科技有限公司	个	¥ 500
17	耳背助听器	1.全数字信号处理,专业噪音过滤系统; 2.4通道、8频段数字处理技术,音质更自然、更清晰;内置高保真反馈抑制系统,有效防止啸叫,使用更舒适; 3.4个调节程序,满足不同听力补偿需求。		42X37X10mm	中山市小榄镇森蓝电子厂	个	¥ 595
18	骨传导助听器	1.有线骨导式助听器,智能降噪,不堵耳朵。 2.双耳独立调节音量,实体按键,适老性更佳。 3.内置充电电池,可通过3.5mm音频连接线连接手机、电脑等设备。 4.产品有二类医疗器械资质和检验报告。 5.最大OFL90:120dB,实测值应不大于标称值+3dB 6.等效输入噪声级: 26dB,实测值应不大于标称值+3dB 7.频率响应范围: 不小于500Hz~4500Hz		头带部分13x15.5x5.5cm;控制盒部分4x6.5x2.5cm	河北博音医疗科技有限公司	个	¥ 1,663

注:中央财政补助资金对符合条件的服务对象予以补助支持的项目分为基础项目和可选项目,基础项目是必须配置的项目,可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。适老化改造配置项目的可选项目7项选2项(不可重复选);智能化改造配置项目的可选项目4项选1项;老年用品配置项目的可选项目5项选3项(不可重复选)。