

合 同 书

项目名称：职业病检测设备及耗材采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-990103-YZLZ

合同编号：12N4988685192025806

目 录

- 1、 合同书
- 2、 采购需求
- 3、 竞标声明
- 4、 竞标报价表
- 5、 商务要求偏离表
- 6、 售后服务承诺
- 7、 技术要求偏离表
- 8、 最后报价
- 9、 成交通知书

《职业病检测设备及耗材采购项目合同》

合同编号：12N4988685192025806

采购人（甲方）：崇左市疾病预防控制中心

供应商（乙方）：广西正知医疗科技有限公司

采购计划号：崇左采备[2025]905 号

项目名称：职业病检测设备及耗材采购项目 项目编号：CZZC2025-J1-990103-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的详见本合同“竞标报价表”

合同金额：陆拾玖万元整（¥690,000.00）

第二条 标的质量

- 乙方所提供标的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

- 履行时间：自签订合同之日起 30 日（日历日）内，通过验收并交付使用。
- 履行地点：广西崇左市江州区石景林东路 11 号，甲方指定地点。
- 履行方式
 - 乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。
 - 交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他： 。

第四条 包装方式

- 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸

等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：甲方指定时间；安装地点：甲方指定地点。

2. 安装要求：满足本次采购安装要求。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 付款进度安排：

2.1 资金来源为财政资金，支付方式为财政国库集中支付，财政部门支付账款期间不计入合同支付期限。

2.2 本项目预付款为合同货款的 30%，签订合同后，甲方收到乙方开具有效且足额的发票后 10 个工作日内支付。

2.3 乙方交货完成经甲方验收合格后，甲方收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 70%。

3. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构

组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书的结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式四份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质保期：质量保证期限为货物验收合格后 24 个月，终身维修。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：0 %。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。

3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 技术参数不符合的

如成交的产品经甲方对仪器设备进行全面性能评估，对产品做性能验证，经评估产品的真实性能与采购响应文件的技术参数不相符的，甲方可认定乙方违约，甲方可要求：

(1) 要求甲方提供符合合同要求的新批次产品或更换甲方指定的符合合同技术参数要求的品牌（按原成交产品的成交单价采购），并承担由此产生的额外费用

(2) 根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求乙方支付相应的经济补偿，以弥

补因产品不合格给甲方造成的直接经济损失和其他合理支出。

(3) 若乙方无法提供合格产品或拒绝履行整改义务, 甲方有权单方面终止合同, 并保留追究法律责任的权利。

2. 退换货处理

(1) 包装破损或标识不清: 外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清。

(2) 出现以上问题之一甲方有权退换货, 并产生的退换货费用由乙方承担。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 按下列____(2)____方式解决:

(1) 向__崇左__仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 中标(成交)通知书;
3. 投标(响应)文件;
4. 采购文件及更正公告(澄清或补充通知);
5. 标准、规范及有关技术文件;
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件及采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需求后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式 5 份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 2 份，乙方执 1 份，云之龙咨询集团有限公司执 1 份，政府采购监督管理部门执 1 份，具有同等法律效力。

6. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 崇左市疾病预防控制中心 2025 年 6 月 30 日	乙方（章） 广西正知医疗科技有限公司 2025 年 6 月 30 日
单位地址：崇左市江州区石景林东路 11 号	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 37 号南宁华润佳成五象中心二区办公楼二十七层 2729 号办公
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：0771-7930379	电话：15977575850
电子邮箱：	电子邮箱：2375795538@qq.com
开户名称：	开户名称：广西正知医疗科技有限公司
纳税人识别号：	纳税人识别号：91450105MA5P34BC49
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市民族支行
账号：	账号：2102109009300182530/102611010906
邮政编码：	邮政编码：530000

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 技术要求评审中未标注“▲”号的内容允许负偏离的条款数为2项，负偏离的条款数达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

4. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目所属行业为：工业。

7. 本项目采购预算：69.25 万元。

8. 本项目的核心产品为下表的第1项产品（空气采样器）。

9. 本项目是专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业名及划分见本章附件2。

10. 本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

11. 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或采购预算单价的响应文件按无效处理。

一、采购需求:				
序号	标的名称	数量	技术参数要求	采购预算单价(元)
1	空气采样器	16 台	1. 采样流量: 3-30L/min; 分辨率: 0.01L/min; 2. 准确度: 优于±5%; 3. 整机续航时长: ≥6 小时; 4. 充电时间: ≤4 小时; 5. 温度显示: (-20~60) °C 6. 大气压显示: (70~110) kPa; 7. 具有标况体积自动换算功能; 8. 历史查询功能; 9. 数字恒压恒流: 无刷真空泵机, 采用闭环控制技术, 流量随负载变化而自动调节以达到流量采样, 不受电压波动和阻力变化影响流量等。 10. 自动校准: 开放的校正权限, 用户可对采样流量进行自主校正; 11. 多重防护: 整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所下防爆功能; 12. 采样模式: 定时、定容、循环采样、编程采样; 13. 负载能力: ≥20kPa, 仪器噪声: ≤60dB (A) 14. 可编程采样: 可以设置编程 10 组采样方式, 开机时点击快捷键, 可以选择之前编辑好的采样数据, 以便快速采样, 提高效率, 减轻劳动强度; 15. 授权操作功能, 操作员可锁定操作界面, 避免无关人员错误操作导致采样无效。 ▲16. 防爆标志: 本质安全防爆: 不低于 ExIa IIB T4 Ga、矿用本安防爆: 不低于 Exia I Ma。 17. 防护等级: 不低于 IP64。	14000
2	空气采样器	16 台	1. 流量范围 300-6000ml/min;	14000

			▲2. 恒流：精度流量误差 5%以内，出厂标准 2%以内；分辨率 1ml/min 3. 显示屏：不低于 2.6 寸彩色液晶屏； 4. 数据：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于 10000 组； ▲5. 断电数据保护：防止断电采样数据丢失； 6. 具有开机自检内部传感器和功能模块及气密性检测； 7. 故障检测：支持气泵异常、传感器异常负载压力突变流量异常波动检测； ▲8. 故障重启：当负载突变或流量变化超过 5%，采样暂停，并可恢复采样，如无法恢复则停止采样并报警； 9. 界面显示内容：实时流量/采样模式/设定流量/设定时间（设定体积）/采样时长/采样体积/采样进度/环境温度/环境大气压/负载压力/计前温度等。 10. 运行模式：手动/定时/定容/循环定时/循环定容/预设编程。 11. 流量校准：支持单点校准和线性校准双模式，支持保存历史校准记录。 12. 温度大气压校准：可出具计量校准合格证书。 13. 续航时长：30 小时（500ml/min@4.5kPa）。 14. 充电方式：单座充/多连座充，充电时长：座充 6 小时 ▲15. 防爆等级：本安Ⅱ类不低于 Exia IIC T4 Ga；本安Ⅰ类不低于 Exia I Ma。 16. 防护等级：不低于 IP64。	
3	空气采样器	9 台	1. 流量范围 20-600ml/min； 2. 恒流：精度流量误差 5%以内，出厂标准 2%以内；分辨率 1ml/min。 3. 显示屏：不低于 2.6 寸彩色液晶屏； 4. 数据：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于 10000	14000

			组； 5. 断电数据保护：防止断电采样数据丢失； 6. 具有开机自检内部传感器和功能模块及气密性检测； 7. 故障检测：支持气泵异常、传感器异常负载压力突变流量异常波动检测； ▲8. 故障重启：当负载突变或流量变化超过 5%，采样暂停，并可恢复采样，如无法恢复则停止采样并报警； 9. 界面显示内容：实时流量/采样模式/设定流量/设定时间（设定体积）/采样时长/采样体积/采样进度/环境温度/环境大气压/负载压力/计前温度等。 10. 运行模式：手动/定时/定容/循环定时/循环定容/预设编程。 11. 流量校准：支持单点校准和线性校准双模式，支持保存历史校准记录。 12. 温度大气压校准：可出具计量校准合格证书。 13. 续航时长：30 小时（500ml/min@4.5kPa）。 14. 充电方式：单座充/多连座充，充电时长：座充 6 小时 ▲15. 防爆等级：本安 II 类不低于 Exia IIC T4 Ga；本安 I 类不低于 Exia I Ma。 16. 防护等级：不低于 IP64。	
4	声级计	1 台	1. 传声器：预极化测试电容传声器。 ▲2. 测量范围：30~130 dBA，35~130 dBC，40~130 dBZ（以 2×10^{-5} Pa 为参考，下同）峰值 C 声级测量范围：60~133 dBC，声暴露测量范围：0.1 Pa_{2h} 到 99.9 Pa_{2h} 准确度：-21%~+26%，噪声剂量测量范围：0%到 9999%。 3. 频率范围：20 Hz~12.5 kHz。 4. 频率计权：A、C、Z 计权。 5. 时间计权：F（快），S（慢），I（脉冲）。 6. 主要测量功能：积分测量、统计分析、个人声暴露测量、	8500

			数据记录和录音。 7. 主要测量指标：LFp、LSp、LIp、Leq, t、Lpeak、Leq, T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E 等。 8. 符合标准： GB/T 3785-2010 2 级/IEC 61672:2013 Class 2 GB/T 15952-2010/IEC 61250:2002 9. 显示：128×64 点阵 OLED。 10. 数据存贮：2GB Flash RAM。 11. 存贮组数：最多 8000 组。 12. 其他存贮：32 组组合参数，128 个测点名，128 次校准记录。 13. 积分时间：1 秒到 24 小时。 14. 输出接口：PWM 输出，交流，直流，USB，RS-232 至计算机或微型打印机，输出接口仅限在安全区域使用。 15. 校准：使用 2 级或 2 级以上声级校准器。	
5	声校准器	1 台	1. 符合标准：GB/T 15173-2010。 2. 声压级：114.0dB 和 94.0dB。 ▲3. 声压级误差：±0.25 dB。 4. 频率：1000.0Hz±0.7%。 5. 谐波失真：≤1.0 %。 6. 总失真：≤2.5 %。 7. 电池：2×1.5V 碱性电池参照或相当于 LR6（5 号），最长连续使用时间 7 小时。 8. 稳定时间：小于 15s 9. 使用环境：温度范围：-10℃ ~ +50℃，相对湿度：25%~90%，大气压力：65 kPa~108 kPa。	3300

6	防爆个体噪声剂量计	6 台	1、执行标准：个人声暴露计符合 GB/T 15952-2010；声级计符合 GB/T 3785.1-2023 2 级。 ▲2. 防爆类型：本质安全型，防爆标志为 Exia IIC T4 Ga。 3. 传声器组合：标称灵敏度级-33.0dB ~-33.9dB。 4. 频率范围：20Hz~12.5kHz。 5. 测量范围：A 计权声级 51dB~142 dB，C 计权声级 51 dB~142 dB，Z 计权声级 56 dB~142 dB，C 计权峰值声级 68 dBC~145 dBC；噪声剂量 0% ~ 99999%；声暴露量 0.01 Pa2h ~ 999.99 Pa2h。 6. 主要测量指标：E、Lp、Leq、T、Lmax、Lmin、L10、L50、L90、SEL、Lex、8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak、NLApk>120、NLApk>130、NLApk>140、gravityX、gravityY、gravityZ、Kurt。 7. 显示器：TFT-LCD 显示屏。 8. 数据存储：≥64G 存储。 9. 电源：防爆锂电池，充满电后可连续使用 10h 以上。 10. 应具备录音功能：采样频率及数据长度支持 12 kHz 16 bit、24 kHz 16 bit、48 kHz 32 bit；采样频率及数据长度为 48 kHz 32 bit 时，可保存至少 90 h 录音文件；采样频率及数据长度为 12 kHz 16 bit 时，可保存至少 720 h 录音文件。	10500
7	空盒气压表	1 台	1. 大气压力 300.0~1100.0hPa /内置大气压力； 2. 大气温度 -20~ +60℃ /内置大气温度)； 3. 分辨率：大气压力：0.1hPa；大气温度：0.1℃； ▲4. 准确度等级：大气压力：0.5 级(在 300.0~1100.0hPa 内)；大气温度：±2.0℃。	1500
8	通风干湿表	1 台	▲1. 工作温度：环境温度:测量空气湿度时，能在-10℃~+45℃的环境下正常工作。湿度测量范围：10%~100%RH。 2. 温度表的刻度及测量范围：-36℃~+46℃和 -26℃~+51℃。	1500

			3. 通风速度：通风器开动后温度表球部周围的通风速度在第四分钟末不小于 2.5m/s；在第六分钟末速度不小于 2.2m/s；第六分钟末，每分钟通风速度的变化量不应大于 0.2m/s。 4. 工作时间：通风器的全部作用时间不小于 9min	
9	数显式温湿度计	1 台	1. 测量范围：湿度:10% ~ 95% R. H. 温度:-20℃ ~ +60℃ (-4°F ~ +140°F)； 2. 分辨率：湿度:0.1% R. H.；温度:0.1℃, 0.1°F； ▲3. 准确度：湿度:± 3% R. H. (at 30%~95% R. H.)；温度:± 0.8℃ (±1.5°F)； 4. 存储数据：99 笔； 5. 温度、湿度双显示； 6. 操作及储存温湿度: 0℃ to 50℃ <80%R. H.；-10℃ to 60℃ <70% R. H. 。	700
10	干式流量计	1 台	1. 流量范围覆盖:0.05L/min-30L/min； ▲2. 精度等级:1 级精度； 3. 显示分辨率:小数点后 2 位； 4. 连续工作时长:≥10h； 5. 使用环境:温度(0~50)℃;相对湿度(0~85)%RH，无凝结； 6. 存储环境:温度(0~65)℃;相对湿度(0~95)%RH，无凝结； 7. 瞬时、连续、平均测量模式，自动计算平均值功能； 8. 显示方式:触摸屏或按键； 9. 测量单位 cc/min、ml/min、L/min 可切换； 10. 管路可做密闭性检测，保障测量流量精度； 11. 具有流量槽水平自检功能； 12. 具有自动计算标况流量功能； 13. 多种连接方式：蓝牙、Type-C 等； 14. 数据支持打印； 15. 主机防护等级：IP64；	16000

			16. 符合 JJG633-2024 《气体容积式流量计》标准要求。	
11	铅尺	1 把	1. 长 30cm，宽 2 cm~3cm。 2. 1.0 mm 刻度间距。	2000
12	光栅尺	1 把	1. 测量行程：约 1020mm 2. 固定孔距：约 1110mm 3. 光栅尺总长：约 1126mm 4. 读数头孔距：约 68mm。	1000
13	个体呼尘 采样头	20 个	1. 用于采集个体呼尘 2. B 曲线个体呼尘采样头	1000
14	KN95 口罩	1000 个	七层含活性炭。	1
二、商务要求				
(一)交付使用期 和地点（范围）		1. 交付使用期：自签订合同之日起 30 日（日历日）内，通过验收并交付使用。 2. 交货地点：广西崇左市江州区石景林东路 11 号，采购人指定地点。		
(二)合同签订时 间		自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。		
(三)付款条件 (进度和方式)		1. 资金来源为财政资金，支付方式为财政国库集中支付，财政部门支付账款期间不计入合同支付期限。 2. 本项目预付款为合同货款的 30%，签订合同后，采购人收到成交供应商开具有效且足额的发票后 10 个工作日内支付。 3. 成交供应商交货完成经采购人验收合格后，采购人收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 70%。		
(四)售后服务		1. 负责送货上门，厂家派工程师和技术人员进行负责现场安装、调试和负责培训工作。 2. 质保期：质量保证期限为货物验收合格后不少于 24 个月，终身维修。 3. 响应时间不超过 4 小时，必要时厂家工程师到达现场时间不超过 48 小时，发生重大问题或其他无法迅速解决的问题应在 1 周内解决。 4. 成交供应商须在交货日期 30 天内到采购人提供的现场负责安装、调试设备并验收，直至技术指标与标书符合。		

	5. 培训：①负责提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；②负责提供一次系统培训(按成交供应商安排的指定地点)； 6. 厂家长期提供技术支持，并负责提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
(五) 成交价	1. 货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：物价上涨成本、货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必需的费用也需综合考虑在报价中，在合同协议期间，采购人将不予调整供货单价。 2. 竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要求。
(六) 竞标报价	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 供应商的履约能力要求	
备品备件及耗材等要求：供应商所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具。	
(二) 进口产品说明	
本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。	
(三) 验收标准	
1. 必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准； 2. 成交供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追溯查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。 ▲3. 成交供应商在交付设备时，必须按照响应文件的性能参数进行测试，不能通过技术性能测试或测试结果与响应文件不符（负偏离）的视为虚假应标，采购单位有权拒绝签订合同，取消	

其成交供应商资格，不予退还谈判保证金，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，由此引发的所有损失由该供应商负责。

（四）违约责任

1. 技术参数不符合的

如成交的产品经采购人对仪器设备进行全面性能评估，对产品做性能验证，经评估产品的真实性能与采购响应文件的技术参数不相符的，采购人可认定成交供应商违约，采购人可要求：

（1）要求采购人提供符合合同要求的新批次产品或更换采购人指定的符合合同技术参数要求的品牌（按原成交产品的成交单价采购），并承担由此产生的额外费用

（2）根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求成交供应商支付相应的经济补偿，以弥补因产品不合格给采购人造成的直接经济损失和其他合理支出。

（3）若成交供应商无法提供合格产品或拒绝履行整改义务，采购人有权单方面终止合同，并保留追究法律责任的权利。

2. 退换货处理

（1）包装破损或标识不清：外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清。

（2）出现以上问题之一采购人有权退换货，并产生的退换货费用由成交供应商承担。

3. 竞标声明

竞标声明

致：崇左市疾病预防控制中心：

我方广西正知医疗科技有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 37 号南宁华润佳成五象中心二区办公楼二十七层 2729 号办公。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称：职业病检测设备及耗材采购项目）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

（1）将按照谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对

此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 37 号南宁华润佳成五象中心二区办公楼二十七层 2729 号办公
邮政编号：530000

电话/传真：15977575850 电子邮箱：2375795538@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市民族支行

账号/行号：2102109009300182530/102611010906

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

周天德

供应商（电子签章）：广西正知医疗科技有限公司

2025 年 06 月 25 日



竞 标 报 价 表

项目名称：职业病检测设备及耗材采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-990103-YZLZ 分标（如有）：无

供应商名称：广西正知医疗科技有限公司 单位：元

项 号	标的名 称	数量 及单 位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	采购预 算单价 （元）	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②	备 注
1	空气采 样器	16 台	苏州 兰化	SP30	苏州兰化 仪器有限 公司	中国	14000	13990	223840	无
2	空气采 样器	16 台	苏州 兰化	SP5000	苏州兰化 仪器有限 公司	中国	14000	13990	223840	无
3	空气采 样器	9 台	苏州 兰化	SP500	苏州兰化 仪器有限 公司	中国	14000	13990	125910	无
4	声级计	1 台	杭州 爱华	YSD136	杭州爱华 仪器有限 公司	中国	8500	8500	8500	无
5	声校准 器	1 台	杭州 爱华	AWA6021 A	杭州爱华 仪器有限 公司	中国	3300	3200	3200	无

6	防爆个体噪声剂量计	6 台	杭州爱华	AWA5920	杭州爱华仪器有限公司	中国	10500	10500	63000	无
7	空盒气压表	1 台	宁波鄞州玻璃	DYM3	宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂	中国	1500	1450	1450	无
8	通风干湿表	1 台	上海隆拓	DHM2	上海隆拓仪器设备有限公司	中国	1500	1450	1450	无
9	数显式温湿度计	1 台	泰仕	TES-1360A	泰仕电子工业股份有限公司	中国	700	680	680	无
10	干式流量计	1 台	苏州兰化	SP510	苏州兰化仪器有限公司	中国	16000	16000	16000	无
11	铅尺	1 把	瑞美德	RT8180	深圳市瑞美德科技有限公司	中国	2000	2000	2000	无
12	光栅尺	1 把	广州信诺	KA300	广州信诺光栅数显有限公司	中国	1000	1000	1000	无
13	个体呼尘采样头	20 个	苏州兰化	无	苏州兰化仪器有限公司	中国	1000	1000	20000	无

14	KN95 口罩	1000 个	际华防护	KN95	际华防护 科技有限公司	中国	1	1	1000	无
合计金额大写：人民币 <u>陆拾玖万壹仟捌佰柒拾元整</u> （¥691870.00）										
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0，占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥0，占本竞标报价的比例为 0%。										
注：竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。										

- 注：
- 1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
 - 2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
 - 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
 - 4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）周天德

供应商（电子签章）：广西正知医疗科技有限公司

日期：2025 年 06 月 25 日

5. 商务要求偏离表

商务要求偏离表

所竞分标： 无

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
(一) 交付使用期和地点 (范围)	1. 交付使用期：自签订合同之日起 30 日 (日历日) 内，通过验收并交付使用。	1. 交付使用期：自签订合同之日起 30 日 (日历日) 内，通过验收并交付使用。	无偏离
	2. 交货地点：广西崇左市江州区石景林东路 11 号，采购人指定地点。	2. 交货地点：广西崇左市江州区石景林东路 11 号，采购人指定地点。	无偏离
(二) 合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
(三) 付款条件 (进度和方式)	1. 资金来源为财政资金，支付方式为财政国库集中支付，财政部门支付账款期间不计入合同支付期限。	1. 资金来源为财政资金，支付方式为财政国库集中支付，财政部门支付账款期间不计入合同支付期限。	无偏离
	2. 本项目预付款为合同货款的 30%，签订合同后，采购人收到成交供应商开具有效且足额的发票后 10 个工作日内支付。	2. 本项目预付款为合同货款的 30%，签订合同后，采购人收到我公司开具有效且足额的发票后 10 个工作日内支付。	无偏离
	3. 成交供应商交货完成经采购人验收合格后，其中第 1-12 项产品须经相关部门检定或校准合格后 (检定或校准费用由成交供应商支	3. 我公司交货完成经采购人验收合格后，其中第 1-12 项产品经相关部门检定或校准合格后 (检定或校准费用由我公司支	无偏离

	付), 采购人收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 70%。	付), 采购人收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 70%。	
(四) 售后服务	1. 负责送货上门, 厂家派工程师和技术人员进行负责现场安装、调试和负责培训工作。	1. 负责送货上门, 厂家派工程师和技术人员进行负责现场安装、调试和负责培训工作。	无偏离
	2. 质保期: 质量保证期限为货物验收合格后不少于 24 个月, 终身维修。	2. 质保期: 质量保证期限为货物验收合格后 24 个月, 终身维修。	无偏离
	3. 响应时间不超过 4 小时, 必要时厂家工程师到达现场时间不超过 48 小时, 发生重大问题或其他无法迅速解决的问题应在 1 周内解决。	3. 响应时间 10 分钟内, 必要时厂家工程师到达现场时间不超过 48 小时, 发生重大问题或其他无法迅速解决的问题在 1 周内解决。	无偏离
	4. 成交供应商须在交货日期 30 天内到采购人提供的现场负责安装、调试设备并验收, 直至技术指标与标书符合。	4. 我公司在交货日期 30 天内到采购人提供的现场负责安装、调试设备并验收, 直至技术指标与标书符合。	无偏离
	5. 培训: ①负责提供现场培训, 人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识, 直到用户能正常使用和维护仪器; ②负责提供一次系统培训(按成交供应商安排的指定地点);	5. 培训: ①负责提供现场培训, 人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识, 直到用户能正常使用和维护仪器; ②负责提供一次系统培训(按我公司安排的指定地点);	无偏离
	6. 厂家长期提供技术支持, 并提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。	6. 厂家长期提供技术支持, 并提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。	无偏离

(五) 成交价	1. 货物送达指定地点, 验收合格至正常使用前所有可能发生的费用, 即包含: 物价上涨成本、货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必需的费用也需综合考虑在报价中, 在合同协议期间, 采购人将不予调整供货单价。	1. 货物送达指定地点, 验收合格至正常使用前所有可能发生的费用, 即包含: 物价上涨成本、货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。我认为必需的费用也需综合考虑在报价中, 在合同协议期间, 采购人将不予调整供货单价。	无偏离
	2. 竞标产品必须为全新原装产品, 成交供应商所提供的产品、资料等要求。	2. 竞标产品必须为全新原装产品, 我公司所提供的产品、资料等要求。	无偏离
(六) 竞标报价	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费, 对采购的全部货物进行完整唯一报价。	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费, 对采购的全部货物进行完整唯一报价。	无偏离
(七) 与实现项目目标相关的其他要求	(一) 供应商的履约能力要求	(一) 供应商的履约能力承诺	无偏离
	备品备件及耗材等要求: 供应商所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品; 该项费用	备品备件及耗材等承诺: 我公司所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格	无偏离

	应包含在报价中；供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具。	产品；该项费用包含在报价中；我公司所提供完整的全套设备包括必备的易损耗备件和专用工具。	
	（二）进口产品说明	（二）进口产品说明	无偏离
	本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。	本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。 我公司所投产品为国产产品。	无偏离
	（三）验收标准	（三）验收标准	无偏离
	1. 必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；	1. 符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；	无偏离
	2. 成交供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号，出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追溯查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	2. 我公司提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追溯查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	无偏离
	▲3. 成交供应商在交付设备时，必须按照响应文件的性能参数进行测试，不能通过技术性能测试或测试结果与响应文件不符（负偏离）的视为虚假应标，采购单位有权拒绝签订合同，取消其成交供应商资	▲3. 我公司在交付设备时，必须按照响应文件的性能参数进行测试，不能通过技术性能测试或测试结果与响应文件不符（负偏离）的视为虚假应标，采购单位有权拒绝签订合同，	无偏离

	格，不予退还谈判保证金，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，由此引发的所有损失由该供应商负责。	取消其成交我公司资格，不予退还谈判保证金，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，由此引发的所有损失由该我公司负责。	
	（四）违约责任	（四）违约责任	无偏离
	1. 技术参数不符合的 如成交的产品经采购人对仪器设备进行全面性能评估，对产品做性能验证，经评估产品的真实性能与采购响应文件的技术参数不相符的，采购人可认定成交供应商违约，采购人可要求：	1. 技术参数不符合的 如成交的产品经采购人对仪器设备进行全面性能评估，对产品做性能验证，经评估产品的真实性能与采购响应文件的技术参数不相符的，采购人可认定我公司违约，采购人可要求：	无偏离
	（1）要求采购人提供符合合同要求的新批次产品或更换采购人指定的符合合同技术参数要求的品牌（按原成交产品的成交单价采购），并承担由此产生的额外费用	（1）要求采购人提供符合合同要求的新批次产品或更换采购人指定的符合合同技术参数要求的品牌（按原成交产品的成交单价采购），并承担由此产生的额外费用	无偏离
	（2）根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求成交供应商支付相应的经济补偿，以弥补因产品不合格给采购人造成的直接经济损失和其他合理支出。	（2）根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求我公司支付相应的经济补偿，以弥补因产品不合格给采购人造成的直接经济损失和其他合理支出。	无偏离
	（3）若成交供应商无法提供合格产品或拒绝履行整改义务，采购人有权单方面终止合同，并保留追究	（3）若我公司无法提供合格产品或拒绝履行整改义务，采购人有权单方面终止合同，并保	无偏离

	法律责任的权利。	留追究法律责任的权利。	
	2. 退换货处理	2. 退换货处理	无偏离
	(1) 包装破损或标识不清：外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清。	(1) 包装破损或标识不清：外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清。	无偏离
	(2) 出现以上问题之一采购人有权退换货，并产生的退换货费用由成交供应商承担。	(2) 出现以上问题之一采购人有权退换货，并产生的退换货费用由我公司承担。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

周天德

供应商（电子签章）：广西正知医疗科技有限公司

日期：2025 年 06 月 25 日

6. 售后服务承诺

为确保采购项目顺利实施及后续稳定运行，涵盖交付后各环节服务内容与标准，为采购人提供优质、高效、可靠的服务保障。

一、送货安装调试服务

1. **送货服务**：自签订合同之日起 30 日（日历日）内，我公司将负责将货物安全、完整地送达广西崇左市江州区石景林东路 11 号及采购人指定地点。运输过程中，我公司将选用专业的运输团队和合适的运输工具，采取妥善的防护措施，确保货物不受损坏。
2. **安装调试**：在交货日期 30 天内，我公司将派遣厂家工程师和专业技术人员到采购人提供的现场，负责设备的安装、调试工作。安装调试过程严格按照产品安装规范和技术标准进行操作，确保设备安装牢固、连接正确、运行稳定，直至设备技术指标与标书要求完全符合，并通过验收交付使用。在安装调试期间，我公司技术人员将保持与采购人的密切沟通，及时解答采购人提出的疑问，确保安装调试工作顺利进行。

二、培训服务

1. **现场培训**：我公司负责提供现场培训服务，培训人数不限。培训内容包括仪器的基本原理、操作应用、日常维护保养知识等，确保用户能够熟练掌握仪器的操作方法，正确进行日常维护保养工作，直到用户能正常使用和维护仪器。培训过程中，我公司技术人员将采用理论讲解与实际操作相结合的方式，确保培训效果。同时，我公司将为用户提供详细的培训资料，方便用户后续学习和查阅。
2. **系统培训**：我公司将按照安排，为用户提供一次系统培训，培训地点为我公司指定地点。系统培训将进一步深化用户对仪器的了解和应用能力，培训内容包括仪器的高级功能应用、复杂故障排除等方面的知识和技能。我公司将承担用户在系统培训期间的培训费用，为用户提供良好的培训环境和学习条件。

三、质保与维修服务

1. **质保期限**：质量保证期限为货物验收合格后 24 个月，在质保期内，我公司将对货物提供免费的维修、保养服务（因用户使用不当造成的损坏除外）。若货物在质保

期内出现质量问题，我公司将及时响应并免费更换或维修损坏的零部件，确保货物正常运行。

2. **终身维修：**质保期结束后，我公司仍将为货物提供终身维修服务。对于维修过程中需要更换的零部件，我公司将按照合理的价格收取费用，并保证零部件的质量和兼容性。同时，我公司将定期回访用户，了解货物的使用情况，为用户提供必要的技术支持和维护建议。

四、响应机制

1. **响应时间：**在接到采购人的服务请求后，我公司的响应时间 10 分钟内。我公司设立了专门的售后服务热线 15977575850，安排专业的客服人员 24 小时值班，确保能够及时接听采购人的服务请求，并在第一时间做出响应。
2. **现场到达时间：**对于需要现场解决的问题，在必要时厂家工程师到达现场时间不超过 48 小时。我公司在全国范围内建立了完善的售后服务网络，配备了充足的技术人员和交通工具，确保能够在规定时间内到达现场进行维修服务。
3. **重大问题解决：**如发生重大问题或其他无法迅速解决的问题，我公司将在 1 周内解决。对于重大问题，我公司将成立专门的技术团队，制定详细的解决方案，集中资源进行处理，确保问题得到及时、有效的解决。在问题解决过程中，我公司将及时向采购人通报处理进展情况，直至问题完全解决。

五、技术支持与资料提供

1. **技术支持：**厂家长期为采购人提供技术支持，我公司将安排专业的技术人员定期回访采购人，了解货物的使用情况，及时发现并解决潜在的问题。同时，我公司将为采购人提供远程技术支持服务，通过电话、网络等方式，为采购人解答技术问题，提供技术指导。
2. **资料提供：**我公司负责提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等，帮助采购人更好地了解和和使用货物。我公司将定期更新资料，并及时将最新资料发送给采购人，确保采购人能够获取最新的技术信息和应用案例。

六、备品备件及耗材服务

我公司所提供的零部件、配件及安装材料均为符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品，该项费用已包含在报价中。我公司将建立完善的备品备件库，确保备品备件的充足供应。在货物出现故障需要更换零部件时，我公司能够及时提供所需的零部件，缩短

维修时间，减少对采购人正常使用的影响。同时，我公司所提供的完整全套设备包括必备的易损耗备件和专用工具，方便采购人进行日常维护和简单维修工作。

供应商（电子签章）：广西正知医疗科技有限公司

日期：2025 年 06 月 25 日



8. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号： CZZC2025-J1-990103-YZLZ

采购项目名称： 职业病检测设备及耗材采购项目

分标号： 无

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	空气采样器	1. 采样流量：3-30L/min；分辨率：0.01L/min；	1. 采样流量：3-30L/min；分辨率：0.01L/min；	无偏离
		2. 准确度：优于±5%；	2. 准确度：优于±5%；	无偏离
		3. 整机续航时长：≥6 小时；	3. 整机续航时长：≥6 小时；	无偏离
		4. 充电时间：≤4 小时；	4. 充电时间：≤4 小时；	无偏离
		5. 温度显示：（-20~60）℃	5. 温度显示：（-20~60）℃	无偏离
		6. 大气压显示：（70~110）kPa；	6. 大气压显示：（70~110）kPa；	无偏离
		7. 具有标况体积自动换算功能；	7. 具有标况体积自动换算功能；	无偏离
		8. 历史查询功能；	8. 历史查询功能；	无偏离
		9. 数字恒压恒流：无刷真空泵，采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等。	9. 数字恒压恒流：无刷真空泵，采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等。	无偏离
		10. 自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正；	10. 自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正；	无偏离

		11. 多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所下防爆功能；	11. 多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所下防爆功能；	无偏离
		12. 采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样；	12. 采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样；	无偏离
		13. 负载能力：≥20kPa，仪器噪声：≤60dB（A）	13. 负载能力：≥20kPa，仪器噪声：≤60dB（A）	无偏离
		14. 可编程采样：可以设置编程 10 组采样方式，开机时点击快捷键，可以选择之前编辑好的采样数据，以便快速采样，提高效率，减轻劳动强度；	14. 可编程采样：可以设置编程 10 组采样方式，开机时点击快捷键，可以选择之前编辑好的采样数据，以便快速采样，提高效率，减轻劳动强度；	无偏离
		15. 授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效。	15. 授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效。	无偏离
		▲16. 防爆标志：本质安全防爆：不低于 ExIa IIB T4 Ga、矿用本安防爆：不低于 Exia I Ma。	▲16. 防爆标志：本质安全防爆：不低于 ExIa IIB T4 Ga、矿用本安防爆：不低于 Exia I Ma。	无偏离
		17. 防护等级：不低于 IP64。	17. 防护等级：不低于 IP64。	无偏离
2	空气采样器	1. 流量范围 300-6000ml/min；	1. 流量范围 300-6000ml/min；	无偏离
		▲2. 恒流：精度流量误差 5% 以内，出厂标准 2% 以内；分辨率 1ml/min	▲2. 恒流：精度流量误差 5% 以内，出厂标准 2% 以内；分辨率 1ml/min	无偏离
		3. 显示屏：不低于 2.6 寸彩色液晶屏；	3. 显示屏：不低于 2.6 寸彩色液晶屏；	无偏离

	4. 数据：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于 10000 组；	4. 数据：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于 10000 组；	无偏离
	▲5. 断电数据保护：防止断电采样数据丢失；	▲5. 断电数据保护：防止断电采样数据丢失；	无偏离
	6. 具有开机自检内部传感器和功能模块及气密性检测；	6. 具有开机自检内部传感器和功能模块及气密性检测；	无偏离
	7. 故障检测：支持气泵异常、传感器异常负载压力突变流量异常波动检测；	7. 故障检测：支持气泵异常、传感器异常负载压力突变流量异常波动检测；	无偏离
	▲8. 故障重启：当负载突变或流量变化超过 5%，采样暂停，并可恢复采样，如无法恢复则停止采样并报警；	▲8. 故障重启：当负载突变或流量变化超过 5%，采样暂停，并可恢复采样，如无法恢复则停止采样并报警；	无偏离
	9. 界面显示内容：实时流量/采样模式/设定流量/设定时间（设定体积）/采样时长/采样体积/采样进度/环境温度/环境大气压/负载压力/计前温度等。	9. 界面显示内容：实时流量/采样模式/设定流量/设定时间（设定体积）/采样时长/采样体积/采样进度/环境温度/环境大气压/负载压力/计前温度等。	无偏离
	10. 运行模式：手动/定时/定容/循环定时/循环定容/预设编程。	10. 运行模式：手动/定时/定容/循环定时/循环定容/预设编程。	无偏离
	11. 流量校准：支持单点校准和线性校准双模式，支持保存历史校准记录。	11. 流量校准：支持单点校准和线性校准双模式，支持保存历史校准记录。	无偏离
	12. 温度大气压校准：可出具计量校准合格证书。	12. 温度大气压校准：可出具计量校准合格证书。	无偏离
	13. 续航时长：30 小时	13. 续航时长：30 小时	无偏离

		(500ml/min@4.5kPa)。	(500ml/min@4.5kPa)。	
		14. 充电方式：单座充/多连座充，充电时长：座充 6 小时	14. 充电方式：单座充/多连座充，充电时长：座充 6 小时	无偏离
		▲15. 防爆等级：本安Ⅱ类不低于 Exia IIC T4 Ga；本安Ⅰ类不低于 Exia I Ma。	▲15. 防爆等级：本安Ⅱ类不低于 Exia IIC T4 Ga；本安Ⅰ类不低于 Exia I Ma。	无偏离
		16. 防护等级：不低于 IP64。	16. 防护等级：不低于 IP64。	无偏离
3	空气采样器	1. 流量范围 20-600ml/min；	1. 流量范围 20-600ml/min；	无偏离
		2. 恒流：精度流量误差 5%以内，出厂标准 2%以内；分辨率 1ml/min。	2. 恒流：精度流量误差 5%以内，出厂标准 2%以内；分辨率 1ml/min。	无偏离
		3. 显示屏：不低于 2.6 寸彩色液晶屏；	3. 显示屏：不低于 2.6 寸彩色液晶屏；	无偏离
		4. 数据：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于 10000 组；	4. 数据：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于 10000 组；	无偏离
		5. 断电数据保护：防止断电采样数据丢失；	5. 断电数据保护：防止断电采样数据丢失；	无偏离
		6. 具有开机自检内部传感器和功能模块及气密性检测；	6. 具有开机自检内部传感器和功能模块及气密性检测；	无偏离
		7. 故障检测：支持气泵异常、传感器异常负载压力突变流量异常波动检测；	7. 故障检测：支持气泵异常、传感器异常负载压力突变流量异常波动检测；	无偏离
		▲8. 故障重启：当负载突变或流量变化超过 5%，采样暂停，并可恢复采样，如无法恢复则停止采样并报警；	▲8. 故障重启：当负载突变或流量变化超过 5%，采样暂停，并可恢复采样，如无法恢复则停止采样并报警；	无偏离

		9. 界面显示内容：实时流量/采样模式/设定流量/设定时间（设定体积）/采样时长/采样体积/采样进度/环境温度/环境大气压/负载压力/计前温度等。	9. 界面显示内容：实时流量/采样模式/设定流量/设定时间（设定体积）/采样时长/采样体积/采样进度/环境温度/环境大气压/负载压力/计前温度等。	无偏离
		10. 运行模式：手动/定时/定容/循环定时/循环定容/预设编程。	10. 运行模式：手动/定时/定容/循环定时/循环定容/预设编程。	无偏离
		11. 流量校准：支持单点校准和线性校准双模式，支持保存历史校准记录。	11. 流量校准：支持单点校准和线性校准双模式，支持保存历史校准记录。	无偏离
		12. 温度大气压校准：可出具计量校准合格证书。	12. 温度大气压校准：可出具计量校准合格证书。	无偏离
		13. 续航时长：30 小时（500ml/min@4.5kPa）。	13. 续航时长：30 小时（500ml/min@4.5kPa）。	无偏离
		14. 充电方式：单座充/多连座充，充电时长：座充 6 小时	14. 充电方式：单座充/多连座充，充电时长：座充 6 小时	无偏离
		▲15. 防爆等级：本安Ⅱ类不高于 Exia IIC T4 Ga；本安Ⅰ类不低于 Exia I Ma。	▲15. 防爆等级：本安Ⅱ类不高于 Exia IIC T4 Ga；本安Ⅰ类不低于 Exia I Ma。	无偏离
		16. 防护等级：不低于 IP64。	16. 防护等级：不低于 IP64。	无偏离
4	声级计	1. 传声器：预极化测试电容传声器。	1. 传声器：预极化测试电容传声器。	无偏离
		▲2. 测量范围：30~130 dBA，35~130 dBC，40~130 dBZ（以 2×10^{-5} Pa 为参考，下同）峰值 C 声级测量范围：60~133	▲2. 测量范围：30~130 dBA，35~130 dBC，40~130 dBZ（以 2×10^{-5} Pa 为参考，下同）峰值 C 声级测量范围：60~133 dBC，声	无偏离

		dBC, 声暴露测量范围: 0.1 Pa2h 到 99.9 Pa2h 准确度: -21%~+26%, 噪声剂量测量范围: 0%到 9999%。	暴露测量范围: 0.1 Pa2h 到 99.9 Pa2h 准确度: -21%~+26%, 噪声剂量测量范围: 0%到 9999%。	
		3. 频率范围: 20 Hz~12.5 kHz。	3. 频率范围: 20 Hz~12.5 kHz。	无偏离
		4. 频率计权: A、C、Z 计权。	4. 频率计权: A、C、Z 计权。	无偏离
		5. 时间计权: F(快), S(慢), I(脉冲)。	5. 时间计权: F(快), S(慢), I(脉冲)。	无偏离
		6. 主要测量功能: 积分测量、统计分析、个人声暴露测量、数据记录和录音。	6. 主要测量功能: 积分测量、统计分析、个人声暴露测量、数据记录和录音。	无偏离
		7. 主要测量指标: LFp、LSp、LIp、Leq, t、Lpeak、Leq, T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E 等。	7. 主要测量指标: LFp、LSp、LIp、Leq, t、Lpeak、Leq, T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E 等。	无偏离
		8. 符合标准: GB/T 3785-2010 2 级/IEC 61672:2013 Class 2 GB/T 15952-2010/IEC 61250:2002	8. 符合标准: GB/T 3785-2010 2 级/IEC 61672:2013 Class 2 GB/T 15952-2010/IEC 61250:2002	无偏离
		9. 显示: 128×64 点阵 OLED。	9. 显示: 128×64 点阵 OLED。	无偏离
		10. 数据存贮: 2GB Flash RAM。	10. 数据存贮: 2GB Flash RAM。	无偏离
		11. 存贮组数: 最多 8000 组。	11. 存贮组数: 最多 8000 组。	无偏离

		12. 其他存贮：32 组组合参数，128 个测点名，128 次校准记录。	12. 其他存贮：32 组组合参数，128 个测点名，128 次校准记录。	无偏离
		13. 积分时间：1 秒到 24 小时。	13. 积分时间：1 秒到 24 小时。	无偏离
		14. 输出接口：PWM 输出，交流，直流，USB，RS-232 至计算机或微型打印机，输出接口仅限在安全区域使用。	14. 输出接口：PWM 输出，交流，直流，USB，RS-232 至计算机或微型打印机，输出接口仅限在安全区域使用。	无偏离
		15. 校准：使用 2 级或 2 级以上声级校准器。	15. 校准：使用 2 级或 2 级以上声级校准器。	无偏离
5	声校准器	1. 符合标准：GB/T 15173-2010。	1. 符合标准：GB/T 15173-2010。	无偏离
		2. 声压级：114.0dB 和 94.0dB。	2. 声压级：114.0dB 和 94.0dB。	无偏离
		▲3. 声压级误差：±0.25 dB。	▲3. 声压级误差：±0.25 dB。	无偏离
		4. 频率：1000.0Hz±0.7%。	4. 频率：1000.0Hz±0.7%。	无偏离
		5. 谐波失真：≤1.0 %。	5. 谐波失真：≤1.0 %。	无偏离
		6. 总失真：≤2.5 %。	6. 总失真：≤2.5 %。	无偏离
		7. 电池：2×1.5V 碱性电池参照或相当于 LR6（5 号），最长连续使用时间 7 小时。	7. 电池：2×1.5V 碱性电池参照或相当于 LR6（5 号），最长连续使用时间 7 小时。	无偏离
		8. 稳定时间：小于 15s	8. 稳定时间：小于 15s	无偏离
		9. 使用环境：温度范围：-10℃~+50℃，相对湿度：25%~90%，大气压力：65 kPa~108 kPa。	9. 使用环境：温度范围：-10℃~+50℃，相对湿度：25%~90%，大气压力：65 kPa~108 kPa。	无偏离

6	防爆个体噪声剂量计	1、执行标准：个人声暴露计符合 GB/T 15952-2010；声级计符合 GB/T 3785.1-2023 2 级。	1、执行标准：个人声暴露计符合 GB/T 15952-2010；声级计符合 GB/T 3785.1-2023 2 级。	无偏离
		▲2. 防爆类型：本质安全型，防爆标志为 Exia IIC T4 Ga。	▲2. 防爆类型：本质安全型，防爆标志为 Exia IIC T4 Ga。	无偏离
		3. 传声器组合：标称灵敏度级-33.0dB ~-33.9dB。	3. 传声器组合：标称灵敏度级-33.0dB ~-33.9dB。	无偏离
		4. 频率范围：20Hz~12.5kHz。	4. 频率范围：20Hz~12.5kHz。	无偏离
		5. 测量范围：A 计权声级 51dB~142 dB，C 计权声级 51 dB~142 dB，Z 计权声级 56 dB~142 dB，C 计权峰值声级 68 dBC~145 dBC；噪声剂量 0% ~ 99999%；声暴露量 0.01 Pa2h ~ 999.99 Pa2h。	5. 测量范围：A 计权声级 51dB~142 dB，C 计权声级 51 dB~142 dB，Z 计权声级 56 dB~142 dB，C 计权峰值声级 68 dBC~145 dBC；噪声剂量 0% ~ 99999%；声暴露量 0.01 Pa2h ~ 999.99 Pa2h。	无偏离
		6. 主要测量指标：E、Lp、Leq、T、Lmax、Lmin、L10、L50、L90、SEL、Lex、8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak、NLApk>120、NLApk>130、NLApk>140、gravityX、gravityY、gravityZ、Kurt。	6. 主要测量指标：E、Lp、Leq、T、Lmax、Lmin、L10、L50、L90、SEL、Lex、8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak、NLApk>120、NLApk>130、NLApk>140、gravityX、gravityY、gravityZ、Kurt。	无偏离
		7. 显示器：TFT-LCD 显示屏。	7. 显示器：TFT-LCD 显示屏。	无偏离
		8. 数据存储：≥64G 存储。	8. 数据存储：≥64G 存储。	无偏离
		9. 电源：防爆锂电池，充满	9. 电源：防爆锂电池，充满电后	无偏离

		电后可连续使用 10h 以上。	可连续使用 10h 以上。	
		10. 应具备录音功能：采样频率及数据长度支持 12 kHz 16 bit、24 kHz 16 bit、48 kHz 32 bit；采样频率及数据长度为 48 kHz 32 bit 时，可保存至少 90 h 录音文件；采样频率及数据长度为 12 kHz 16 bit 时，可保存至少 720 h 录音文件。	10. 应具备录音功能：采样频率及数据长度支持 12 kHz 16 bit、24 kHz 16 bit、48 kHz 32 bit；采样频率及数据长度为 48 kHz 32 bit 时，可保存至少 90 h 录音文件；采样频率及数据长度为 12 kHz 16 bit 时，可保存至少 720 h 录音文件。	无偏离
7	空盒气压表	1. 大气压力 300.0~1100.0hPa /内置大气压力；	1. 大气压力 300.0~1100.0hPa /内置大气压力；	无偏离
		2. 大气温度 -20~ +60℃ / 内置大气温度）；	2. 大气温度 -20~ +60℃ / 内置大气温度）；	无偏离
		3. 分辨率：大气压力：0.1hPa；大气温度：0.1℃；	3. 分辨率：大气压力：0.1hPa；大气温度：0.1℃；	无偏离
		▲4. 准确度等级：大气压力：0.5 级（在 300.0~1100.0hPa 内）；大气温度：±2.0℃。	▲4. 准确度等级：大气压力：0.5 级（在 300.0~1100.0hPa 内）；大气温度：±2.0℃。	无偏离
8	通风干湿表	▲1. 工作温度：环境温度：测量空气湿度时，能在-10℃~+45℃的环境下正常工作。湿度测量范围：10%~100%RH。	▲1. 工作温度：环境温度：测量空气湿度时，能在-10℃~+45℃的环境下正常工作。湿度测量范围：10%~100%RH。	无偏离
		2. 温度表的刻度及测量范围：-36℃~+46℃和 -26℃~+51℃。	2. 温度表的刻度及测量范围：-36℃~+46℃和 -26℃~+51℃。	无偏离
		3. 通风速度：通风器开动后温度表球部周围的通风速度	3. 通风速度：通风器开动后温度表球部周围的通风速度在第四	无偏离

		在第四分钟末不小于 2.5m/s; 在第六分钟末速度不小于 2.2m/s; 第六分钟末, 每分钟通风速度的变化量不应大于 0.2m/s。	分钟末不小于 2.5m/s; 在第六分钟末速度不小于 2.2m/s; 第六分钟末, 每分钟通风速度的变化量不应大于 0.2m/s。	
		4. 工作时间: 通风器的全部作用时间不小于 9min	4. 工作时间: 通风器的全部作用时间不小于 9min	无偏离
9	数显式 温湿度计	1. 测量范围: 湿度:10% ~ 95% R.H. 温度:-20℃ ~ +60℃ (-4°F ~ +140°F);	1. 测量范围: 湿度:10% ~ 95% R.H. 温度:-20℃ ~ +60℃ (-4°F ~ +140°F);	无偏离
		2. 分辨率: 湿度:0.1% R.H.; 温度:0.1℃, 0.1°F;	2. 分辨率: 湿度:0.1% R.H.; 温度:0.1℃, 0.1°F;	无偏离
		▲3. 准确度: 湿度:± 3% R.H. (at 30%~95% R.H.); 温度:± 0.8℃ (±1.5°F);	▲3. 准确度: 湿度:± 3% R.H. (at 30%~95% R.H.); 温度:± 0.8℃ (±1.5°F);	无偏离
		4. 存储数据: 99 笔;	4. 存储数据: 99 笔;	无偏离
		5. 温度、湿度双显示;	5. 温度、湿度双显示;	无偏离
		6. 操作及储存温湿度: 0℃ to 50℃ < 80% R.H.; -10℃ to 60℃ < 70% R.H.。	6. 操作及储存温湿度: 0℃ to 50℃ < 80% R.H.; -10℃ to 60℃ < 70% R.H.。	无偏离
10	干式流量计	1. 流量范围覆盖: 0.05L/min-30L/min;	1. 流量范围覆盖: 0.05L/min-30L/min;	无偏离
		▲2. 精度等级: 1 级精度;	▲2. 精度等级: 1 级精度;	无偏离
		3. 显示分辨率: 小数点后 2 位;	3. 显示分辨率: 小数点后 2 位;	无偏离
		4. 连续工作时长: ≥10h;	4. 连续工作时长: ≥10h;	无偏离
		5. 使用环境: 温度 (0~50)℃; 相对湿度 (0~85)%RH, 无凝	5. 使用环境: 温度 (0~50)℃; 相对湿度 (0~85)%RH, 无凝结;	无偏离

		结;		
		6. 存储环境:温度(0~65)℃;相对湿度(0~95)%RH, 无凝结;	6. 存储环境:温度(0~65)℃;相对湿度(0~95)%RH, 无凝结;	无偏离
		7. 瞬时、连续、平均测量模式, 自动计算平均值功能;	7. 瞬时、连续、平均测量模式, 自动计算平均值功能;	无偏离
		8. 显示方式:触摸屏或按键;	8. 显示方式:触摸屏或按键;	无偏离
		9. 测量单位 cc/min、ml/min、L/min 可切换;	9. 测量单位 cc/min、ml/min、L/min 可切换;	无偏离
		10. 管路可做密闭性检测, 保障测量流量精度;	10. 管路可做密闭性检测, 保障测量流量精度;	无偏离
		11. 具有流量槽水平自检功能;	11. 具有流量槽水平自检功能;	无偏离
		12. 具有自动计算标况流量功能;	12. 具有自动计算标况流量功能;	无偏离
		13. 多种连接方式: 蓝牙、Type-C 等;	13. 多种连接方式: 蓝牙、Type-C 等;	无偏离
		14. 数据支持打印;	14. 数据支持打印;	无偏离
		15. 主机防护等级: IP64;	15. 主机防护等级: IP64;	无偏离
		16. 符合 JJG633-2024《气体容积式流量计》标准要求。	16. 符合 JJG633-2024《气体容积式流量计》标准要求。	无偏离
11	铅尺	1. 长 30cm, 宽 2 cm~3cm。	1. 长 30cm, 宽 2 cm~3cm。	无偏离
		2. 1.0 mm 刻度间距。	2. 1.0 mm 刻度间距。	无偏离
12	光栅尺	1. 测量行程: 约 1020mm	1. 测量行程: 约 1020mm	无偏离
		2. 固定孔距: 约 1110mm	2. 固定孔距: 约 1110mm	无偏离
		3. 光栅尺总长: 约 1126mm	3. 光栅尺总长: 约 1126mm	无偏离

		4. 读数头孔距：约 68mm。	4. 读数头孔距：约 68mm。	无偏离
13	个体呼 尘采样 头	1. 用于采集个体呼尘	1. 用于采集个体呼尘	无偏离
		2. B 曲线个体呼尘采样头	2. B 曲线个体呼尘采样头	无偏离
14	KN95 口 罩	七层含活性炭。	七层含活性炭。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

周天德

供应商（电子签章）：广西正知医疗科技有限公司

日期：2025 年 06 月 25 日

投 标 报 价 明 细 表



投标人全称（公章）：广西正知医疗科技有限公司

项目编号及分标： 职业病检测设备及耗材采购项目（CZZC2025-J1-990103-YZLZ）

供应商名称	报价(总价，元)	交付使用期
广西正知医疗科技有限公司	690000	自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用



竞 标 报 价 表

项目名称：职业病检测设备及耗材采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-990103-YZLZ

分标（如有）：无

供应商名称：广西正知医疗科技有限公司

单位：元

项 号	标的名 称	数量 及单 位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	采购预 算单价 (元)	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②	备 注
1	空气采 样器	16 台	苏州 兰化	SP30	苏州兰化 仪器有限 公司	中国	14000	13990	223840	无
2	空气采 样器	16 台	苏州 兰化	SP5000	苏州兰化 仪器有限 公司	中国	14000	13990	223840	无
3	空气采 样器	9 台	苏州 兰化	SP500	苏州兰化 仪器有限 公司	中国	14000	13990	125910	无
4	声级计	1 台	杭州 爱华	YSD136	杭州爱华 仪器有限 公司	中国	8500	8500	8500	无
5	声校准 器	1 台	杭州 爱华	AWA6021 A	杭州爱华 仪器有限 公司	中国	3300	3200	3200	无

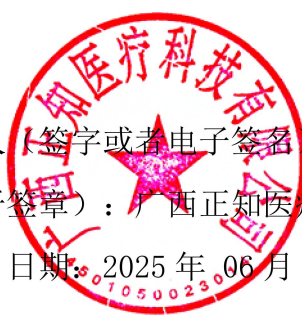
6	防爆个体噪声剂量计	6 台	杭州爱华	AWA5920	杭州爱华仪器有限公司	中国	10500	10300	61800	无
7	空盒气压表	1 台	宁波鄞州玻璃	DYM3	宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂	中国	1500	1450	1450	无
8	通风干湿表	1 台	上海隆拓	DHM2	上海隆拓仪器设备有限公司	中国	1500	1450	1450	无
9	数显式温湿度计	1 台	泰仕	TES-1360A	泰仕电子工业股份有限公司	中国	700	680	680	无
10	干式流量计	1 台	苏州兰化	SP510	苏州兰化仪器有限公司	中国	16000	15330	15330	无
11	铅尺	1 把	瑞美德	RT8180	深圳市瑞美德科技有限公司	中国	2000	2000	2000	无
12	光栅尺	1 把	广州信诺	KA300	广州信诺光栅数显有限公司	中国	1000	1000	1000	无
13	个体呼尘采样头	20 个	苏州兰化	无	苏州兰化仪器有限公司	中国	1000	1000	20000	无

14	KN95 口罩	1000 个	际华防护	KN95	际华防护 科技有限公司	中国	1	1	1000	无
合计金额大写：人民币 <u>陆拾玖万元整</u> （¥ <u>690000.00</u> ）										
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0，占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥0，占本竞标报价的比例为 0%。										
注：竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。										

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）： 广西正知医疗科技有限公司

日期：2025 年 06 月 25 日

成交通知书

广西正知医疗科技有限公司:

经评定, 编号为CZZC2025-J1-990103-YZLZ采购文件中的职业病检测设备及耗材采购项目, 确定你公司成交, 成交价格为: 陆拾玖万元整(¥690,000.00)。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 黄春玲

电话: 0771-7930379

代理机构联系人: 梁立宇

电话: 0771-7833699

