

合 同 书



项目名称：崇左市人民医院供应室耗材采购

项目编号：CZZC2025-J1-990035-YZLZ

合同编号：12N4989581002025604

目 录

- 1、 合同书
- 2、 采购需求
- 3、 竞标声明
- 4、 竞标报价表
- 5、 商务条款偏离表
- 6、 售后服务承诺
- 7、 技术偏离表
- 8、 最后报价
- 10、 成交通知书

崇左市人民医院供应室耗材采购 2 分标合同书

合同编号：12N4989581002025604

采购人（甲方）：崇左市人民医院

供应商（乙方）：崇左市益全达医疗器械销售有限公司

采购计划号：崇左采备[2025]91 号-001、崇左采备[2025]91 号-002

项目名称：崇左市人民医院供应室耗材采购 项目编号：CZZC2025-J1-990035-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	医用包装无纺布 (约 60cm×60cm)	桂械	60cmX60cm	桂械医疗科技有限公司	15000	张	0.80	12000
2	医用包装无纺布 (约 70cm×70cm)	桂械	70cm×70cm	桂械医疗科技有限公司	11233	张	1.10	12356.3
3	医用包装无纺布 (约 100cm×100cm)	桂械	100cm×100cm	桂械医疗科技有限公司	4000	张	2.3	9200
4	医用包装无纺布 (约 120cm×120cm)	桂械	120cm×120cm	桂械医疗科技有限公司	4000	张	3.1	12400
5	医用包装无纺布 (约 150cm×150cm)	桂械	150cm×150cm	桂械医疗科技有限公司	8000	张	5	40000
6	医用吸水纸 (约 25cm×50cm)	天维	25cm×50cm	山东天维医疗科技有限公司	15000	张	0.41	6150
7	医用吸水纸 (约 25cm×25cm)	天维	25cm×25cm	山东天维医疗科技有限公司	16000	张	0.25	4000
8	B-D 预警测试包	天维	120mm×120mm ×15mm (40 包/箱)	山东天维医疗科技有限公司	1100	包	22	24200
9	压力蒸汽灭菌化学指示卡	天维	ST132 (200 片/盒)	山东天维医疗科技有限公司	100000	片	0.1	10000
10	压力蒸汽灭菌化学指示标签	天维	61mm×34mm (900 片/卷)	山东天维医疗科技有限公司	90000	片	0.17	15300

11	低温灭菌包装材料 (宽度约 100mm)	天维	100mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	150	米	3.5	525
12	低温灭菌包装材料 (宽度约 150mm)	天维	150mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	150	米	5.5	825
13	低温灭菌包装材料 (宽度约 200mm)	天维	200mm*100m	山东天维医疗科技 有限公司	600	米	7.2	4320
14	低温灭菌包装材料 (宽度约 300mm)	天维	300mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	300	米	10.5	3150
15	高温灭菌包装材料 (宽度约 55mm)	天维	55mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	300	米	0.54	162
16	高温灭菌包装材料 (宽度约 75mm)	天维	75mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	2000	米	0.72	1440
17	高温灭菌包装材料 (宽度约 100mm)	天维	100mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	2000	米	0.85	1700
18	高温灭菌包装材料 (宽度约 150mm)	天维	150mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	1500	米	1.4	2100
19	高温灭菌包装材料 (宽度约 200mm)	天维	200mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	500	米	1.7	850
20	高温灭菌包装材料 (宽度约 300mm)	天维	300mm×100m	山东天维医疗科技 有限公司	200	米	2.4	480
合计金额(人民币): 壹拾陆万壹仟壹佰伍拾捌元叁角整 (¥161,158.30)								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标(响应)文件及有关承诺相一致,且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到投标(响应)文件的承诺。

第三条 履行时间(期限)、地点和方式

1. 履行时间(期限): 所有产品在合同签订后 3 天内开始供货,服务期 1 年。

2. 履行地点: 广西崇左市内,甲方指定地点。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输,货物的运输方式: 满足本次采购供货要求。

(2) 交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他: 。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标(响应)文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：甲方指定时间；安装地点：甲方指定地点。

2. 安装要求：满足本次采购安装要求。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：壹拾陆万壹仟壹佰伍拾捌元叁角整（¥161,158.30）。

3. 合同价款包括成交货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

4. 付款进度安排：本项目无预付款，乙方交货完成经甲方验收合格后，按季度付款，在合同服务期内收到发票后 10 个工作日内支付。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的

履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式四份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质保期：有效期不少于 18 个月。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：0 %。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函(包含电子保函)等非现金方式。

3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

(3) 从迟交第九周起, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 1.5%。在计算迟延交付违约金时, 迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款(报酬)的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务, 但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的, 相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的, 应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下:

(1) 从迟付的第一周到第四周, 每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%;

(2) 从迟付的第五周到第八周, 每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%;

(3) 从迟付第九周起, 每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时, 迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和投标(响应)文件承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同价款(报酬)的 5%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的, 该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 按下列 (2) 方式解决:

(1) 向 崇左 仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 中标（成交）通知书；
3. 投标（响应）文件；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。


3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式 5 份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 2 份，乙方执 1 份，云之龙咨询集团有限公司执 1 份，政府采购监督管理部门执 1 份，具同等法律效力。

6. 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 崇左市人民医院  2025 年 4 月 9 日	乙方（章） 崇左市益全达医疗器械销售有限公司  2025 年 4 月 9 日
单位地址：崇左市江州区龙峡山东路 6 号	单位地址：广西壮族自治区崇左市江州区花山路中段西侧（崇左市富国财富广场项目）综合楼 222 号 4 层
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：0771-7823460	电话：15877136910
电子邮箱：czyycgb@163.com	电子邮箱：1065955855@qq.com
开户名称：崇左市人民医院	开户名称：崇左市益全达医疗器械销售有限公司
纳税人识别号：124514004989581008	纳税人识别号：91451402MAA7HCFB25
开户银行：广西崇左农村商业银行营业部	开户银行：中国工商银行崇左支行
账号：1457012040000530	账号：2112123109100089154
邮政编码：532200	邮政编码：532200

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），**否则响应文件按无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 技术要求评审中未标注“▲”号的内容允许负偏离的条款数为2项，负偏离的条款数达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

4. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目所属行业为：工业。

7. 本项目是专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业名及划分见本章附件2。

8. 本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

分标 2：

1.本项目采购预算：28.6 万元

2.本项目的核心产品为下表的第 5 项产品【医用包装无纺布(约 150cm×150cm)】。

一、采购需求：				
序号	设备名称	数量	单位	技术参数要求
1	医用包装无纺布 (约 60cm×60cm)	15000	张	1. 约60g 医用包装无纺布。 2. 可根据需求定制化。 3. 符合GB/T 16886. 7-2015, YY/T 0698. 2-2022相关要求，同时满足《消毒技术规范》2022版。 4. 医用包装无纺布颜色要求有大于4种以上可供选择 5. 能同时适用于高低温灭菌。 6. 适用于压力蒸。
2	医用包装无纺布 (约 70cm×70cm)	11233	张	1. 约60g 医用包装无纺布。 2可根据需求定制化。 3. 符合GB/T 16886. 7-2015, YY/T 0698. 2-2022相关要求，同时满足《消毒技术规范》2022 版。 4. 医用包装无纺布颜色要求有大于4种以上可供选择 5. 能同时适用于高低温灭菌。 6. 适用于汽灭菌及低温。
3	医用包装无纺布 (约 100cm×100cm)	4000	张	1. 约60g 医用包装无纺布。 2. 可根据需求定制化。 3. 符合GB/T 16886. 7-2015, YY/T 0698. 2-2022相关要求，同时满足《消毒技术规范》2022 版。 4. 医用包装无纺布颜色要求有大于4种以上可供选择 5. 能同时适用于高低温灭菌。 6. 适用于等离子灭菌。

4	医用包装 无纺布 (约 120cm ×120cm)	4000	张	1. 约60g 医用包装无纺布。 2. 可根据需求定制化。 3. 符合GB/T 16886. 7-2015, YY/T 0698. 2-2022相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。 4. 医用包装无纺布颜色要求有大于4种以上可供选择 5. 能同时适用于高低温灭菌。
5	医用包装 无纺布 (约 150cm ×150cm)	8000	张	1. 约60g 医用包装无纺布。 2. 可根据需求定制化。 3. 符合GB/T 16886. 7-2015, YY/T 0698. 2-2022相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。 4. 医用包装无纺布颜色要求有大于4种以上可供选择 5. 能同时适用于高低温灭菌。
6	医用吸水 纸(约 25cm× 50cm)	15000	张	1. 采用 100%全木浆制作, 无荧光增白剂等有害成分, 可自然降解。 2. 可在器械包内吸收多余冷凝水, 避免湿包。 3. 表面有纹理增加摩擦系数, 防止器械滑动, 保护物品。 4. 适合多种灭菌方式: 高温蒸汽, 环氧乙烷, γ 射线等。 5. 感官均匀, 无杂质, 无显著疵点, 切面整齐。单位面积质量偏差 5%, 厚度 0.27 ± 0.08, 密度 $155 \text{ g/dm}^3 \pm 5\%$。 6. 吸收率$\geq 400\%$, 断裂强力: 纵向$\geq 30\text{N}$, 横向$\geq 30\text{N}$ 断裂伸长率: 纵向$\geq 5\%$, 横向$\geq 7\%$。 7. 质保期不低于5年。 8. 适用于压力蒸汽灭菌及低温等离子灭菌。
7	医用吸水 纸(约 25cm× 25cm)	16000	张	1. 采用 100%全木浆制作, 无荧光增白剂等有害成分, 可自然降解。 2. 可在器械包内吸收多余冷凝水, 避免湿包。

				3. 表面有纹理增加摩擦系数，防止器械滑动，保护物品。 4. 适合多种灭菌方式：高温蒸汽，环氧乙烷，γ射线等。 5. 感官均匀，无杂质，无显著疵点，切面整齐。单位面积质量偏差 5%，厚度 0.27 ± 0.08，密度 $155 \text{ g/dm}^3 \pm 5\%$。 6. 吸收率$\geq 400\%$，断裂强力：纵向$\geq 30\text{N}$，横向$\geq 30\text{N}$ 断裂伸长率：纵向$\geq 5\%$，横向$\geq 7\%$。 7. 质保期不低于5年。 8. 适用于压力蒸汽灭菌及低温等离子灭菌。
8	B-D 预警测试包	1100	包	1. 符合GB18282. 4-2009（或ISO11140）对用于代替性BD类蒸汽渗透测试的二类指示物的要求； 2. 化学指示物不含铅、铜等重金属，符合人眼的视觉特性，易判读； 3. B-D试验预警测试纸敏感度更高，在B-D试验失败前，预警灭菌器的维护。
9	压力蒸汽灭菌化学指示卡	10000 0	片	1. 符合GB18282. 1-2015（或ISO11140）对四类化学指示物的要求。 2. 化学指示物不含铅、铜等重金属。
10	压力蒸汽灭菌化学指示标签	90000	片	1. 符合一类化学指示物的要求； 2. 规格版面可根据科室的需求进行定做。
11	低温灭菌包装材料（宽度约100mm）	150	米	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282. 1-2015及 GB/T 32309-2015的检验要求，检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定； 2. 产品使用专用纸，柔韧、耐穿刺、透气。 3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。
12	低温灭菌包装材料（宽度约	150	米	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282. 1-2015及 GB/T 32309-2015的检验要求，检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等

	150mm)			同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定； 2. 产品使用专用纸，柔韧、耐穿刺、透气。 3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。
13	低温灭菌包装材料 (宽度约200mm)	600	米	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282. 1-2015及 GB/T 32309-2015的检验要求，检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定； 2. 产品使用专用纸，柔韧、耐穿刺、透气。 3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。
14	低温灭菌包装材料 (宽度约300mm)	300	米	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282. 1-2015及 GB/T 32309-2015的检验要求，检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定； 2. 产品使用专用纸，柔韧、耐穿刺、透气。 3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。
15	高温灭菌包装材料 (宽度约55mm)	300	米	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，符合《消毒技术规范》、GB 18282. 1-2015及GB/T 33418-2016的检验要求，检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验； 2. 产品使用专业医用透析纸，平均克重不低于70(±5%)g/m²，柔韧、透气，有防爆边设计。
16	高温灭菌包装材料 (宽度约75mm)	2000	米	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，符合《消毒技术规范》、GB 18282. 1-2015及GB/T 33418-2016的检验要求，检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验； 2. 产品使用专业医用透析纸，平均克重不低于70(±5%)g/m²，柔韧、透气，有防爆边设计。

17	高温灭菌包装材料 (宽度约100mm)	2000	米	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物,符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015及GB/T 33418-2016的检验要求,检验报告中含有等同于灭菌后,无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验; 2. 产品使用专业医用透析纸,平均克重不低于70(±5%)g/m²,柔韧、透气,有防爆边设计。
18	高温灭菌包装材料 (宽度约150mm)	1500	米	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物,符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015及GB/T 33418-2016的检验要求,检验报告中含有等同于灭菌后,无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验; 2. 产品使用专业医用透析纸,平均克重不低于70(±5%)g/m²,柔韧、透气,有防爆边设计。
19	高温灭菌包装材料 (宽度约200mm)	500	米	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物,符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015及GB/T 33418-2016的检验要求,检验报告中含有等同于灭菌后,无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验; 2. 产品使用专业医用透析纸,平均克重不低于70(±5%)g/m²,柔韧、透气,有防爆边设计。
20	高温灭菌包装材料 (宽度约300mm)	200	米	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物,符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015及GB/T 33418-2016的检验要求,检验报告中含有等同于灭菌后,无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验; 2. 产品使用专业医用透析纸,平均克重不低于70(±5%)g/m²,柔韧、透气,有防爆边设计。

二、商务服务及:

- 售后服务要求: (1)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”; (2)送货上门安装、调试,提供完善的设备使用、操作培训。
- 质保期: 有效期不少于18个月。

3. 交货期：所有产品在合同签订后3天内开始供货，服务期1年。

4. 交货地点：崇左市人民医院。

5. 货物质量要求：

（1）成交人所供应的产品必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交人提供的货物必须原装、未拆封的新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。

（2）货物送达时，其剩余有效期不得少于产品有效期的70%，3个月内因质量问题须包换，如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，成交人应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由成交人承担。

6. 竞标报价含货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：物价上涨成本、货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必须的费用也需综合考虑在报价中，在合同协议期间，采购人将不予调整供货单价。

7. 竞标产品必须为原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。

8. 配送及交货要求：

（1）送货上门。货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程的冷链条件，安排货物必须在工作日到达采购人，否则造成的货物质量问题，成交人必须在接到通知后 3 日内无条件进行更换。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，交货时须随附货物清单。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。

9. 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如须相关部门检测的，应由成交人负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。

10. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。

11. 付款方式：本项目无预付款，成交人交货完成经采购人验收合格后，在合同服务期内收到正规足额发票后按季度付款。

12. 合同签订时间：自成交通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

三、竞标声明

竞标声明

致：崇左市人民医院：

我方崇左市益全达医疗器械销售有限公司系中华人民共和国合法供应商， 经营地址广西壮族自治区崇左市江州区花山路中段西侧（崇左市富国财富广场项目）综合楼222号4层。

我方愿意参加贵方组织的崇左市人民医院供应室耗材采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- 
- （1）将按谈判文件的约定履行~~合同~~责任和~~义务~~；
 - （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
 - （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
 - （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全

部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：广西壮族自治区崇左市江州区花山路中段西侧（崇左市富国财富广场项目）综合楼222号4层 邮政编号：532200

电话/传真：15877136910 电子邮箱：1065955855@qq.com

开户银行：中国工商银行崇左支行 账号/行号：2112123109100089154

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：崇左市益全达医疗器械销售有限公司

2025年3月14日



竞标报价表

项目名称：崇左市人民医院供应室耗材采购 项目编号：CZZC2025-J1-990035-YZLZ

分标（如有）：分标2

供应商名称：崇左市益全达医疗器械销售有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
1	医用包装无纺布	15000张	桂械	60cm×60cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	1.30	19500.00	
2	医用包装无纺布	11233张	桂械	70cm×70cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	1.80	20219.40	
3	医用包装无纺布	4000张	桂械	100cm×100cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	4.00	16000.00	
4	医用包装无纺布	4000张	桂械	120cm×120cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	6.20	24800.00	
5	医用包装无纺布	8000张	桂械	150cm×150cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	8.80	70400.00	
6	一次性医用擦手/吸水纸	15000张	天维	25cm×50cm（1000张/箱）	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.80	12000.00	
7	一次性医用擦手/吸水纸	16000张	天维	25cm×25cm（1000张/箱）	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.50	8000.00	
8	B-D试验包（预警）	1100包	天维	120mm×120mm×15mm（40包/箱）	山东天维医疗科技有限公司	山东	33.50	36850.00	
9	132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	100000片	天维	ST132（200片/盒）	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.17	17000.00	
10	压力蒸汽灭菌化学指示标签	90000片	天维	61mm×34mm（900片/卷）	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.28	25200.00	

11	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	150米	天 维	100mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	8.50	1275.00	
12	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	150米	天 维	150mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	10.50	1575.00	
13	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	600米	天 维	200mm*100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	14.20	8520.00	
14	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	300米	天 维	300mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	22.70	6810.00	
15	医用灭菌 包装袋	300米	天 维	55mm×100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	1.60	480.00	
16	医用灭菌 包装袋	2000米	天 维	75mm×100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	1.50	3000.00	
17	医用灭菌 包装袋	2000米	天 维	100mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	2.30	4600.00	
18	医用灭菌 包装袋	1500米	天 维	150mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	3.80	5700.00	
19	医用灭菌 包装袋	500米	天 维	200mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	4.70	2350.00	
20	医用灭菌 包装袋	200米	天 维	300mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	5.90	1180.00	

合计金额大写：人民币贰拾捌万伍仟肆佰伍拾玖元肆角（¥285459.40）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟）

占本竞标报价的比例为0.00%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0.00%。

注：竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

赵念东

供应商（电子签章）：崇左市益全达医疗器械销售有限公司

2025年3月14日

四、商务要求偏离表

商务要求偏离表

所竞分标：分标2

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）	交货期：所有产品在合同签订后 3 天内开始供货，服务期 1 年； 交货地点：崇左市人民医院。	交货期：所有产品在合同签订后 3 天内开始供货，服务期 1 年； 交货地点：崇左市人民医院。	无偏离
1. 售后服务要求	(1)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；	(1)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；	无偏离
	(2)送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训。	(2)送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训。	无偏离
2. 质保期	有效期不少于 18 个月。	有效期不少于 18 个月。	无偏离
3. 交货期	所有产品在合同签订后 3 天内开始供货，服务期 1 年。	所有产品在合同签订后 3 天内开始供货，服务期 1 年。	无偏离
4. 交货地点	崇左市人民医院。	崇左市人民医院。	无偏离
5. 货物质量要求	(1) 成交人所供应的产品必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交人提供的货物必须原装、未拆封的新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	(1) 成交人所供应的产品必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交人提供的货物必须原装、未拆封的新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	无偏离
	(2) 货物送达时，其剩余有效期不得少于产品有效期的 70%，3 个月内因质量问题须包换，如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，成交人应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由成交人承担。	(2) 货物送达时，其剩余有效期不得少于产品有效期的 70%，3 个月内因质量问题须包换，如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，成交人应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由成交人承担。	无偏离

6. 竞标报价含货物送达指定地点	验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：物价上涨成本、货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必须的费用也需综合考虑在报价中，在合同协议期间，采购人将不予调整供货单价。	验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：物价上涨成本、货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必须的费用也需综合考虑在报价中，在合同协议期间，采购人将不予调整供货单价。	无偏离
7. 竞标产品必须为原装产品	竞标产品必须为原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。	竞标产品必须为原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。	无偏离
8. 配送及交货要求	（1）送货上门。货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程的冷链条件，安排货物必须在工作日到达采购人，否则造成的货物质量问题，成交人必须在接到通知后3日内无条件进行更换。	（1）送货上门。货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程的冷链条件，安排货物必须在工作日到达采购人，否则造成的货物质量问题，成交人必须在接到通知后3日内无条件进行更换。	无偏离
	（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，交货时须随附货物清单。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。	（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，交货时须随附货物清单。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。	无偏离
9. 验收	验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如须相关部门检测的，应由成交人负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。	验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如须相关部门检测的，应由成交人负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。	无偏离
10. 测试及检验	检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。	检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。	无偏离
11. 付款方式	本项目无预付款，成交人交货完成经采购人验收合格后，在合同服务期内收到正规足额发票后按季度付款。	本项目无预付款，成交人交货完成经采购人验收合格后，在合同服务期内收到正规足额发票后按季度付款。	无偏离

12. 合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
------------	--	--	-----

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：崇左市益全达医疗器械销售有限公司

日期： 2025 年 3 月 14 日



五、售后服务承诺

售后服务承诺

1、质保期

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品有效期不少于 18 个月，吸水纸产品不少于 5 年，我们针对此次项目提供的免费维护期，在这段时间里，我公司将为采购方提供如下免费服务：

★严格执行国家“三包”标准服务

★严格按国家的“三包”标准执行货物的退、换服务

2、产品质量、技术保证

为确保医用耗材的质量，保证医用耗材的安全、有效，依照《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规，我方严格遵守各项法律法规，确保产品经销操作规程的有效性，并对所销售的医疗器械质量向采购方作出如下承诺：

(1) 我公司所供应的产品完全符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；提供的货物是原装、未拆封的新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。

(2) 货物送达时，其剩余有效期不得少于产品有效期的 70%，3 个月内因质量问题须包换，如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，我公司在收到有关通知后 7 天内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由我公司承担。

(3) 竞标产品为原装产品，我公司所提供的产品、资料等均满足中华人民共和国的相应标准

(4) 我公司所提供的医疗产品均提供规范的售后服务。

(5) 我公司一旦发现产品质量问题，将及时通知采购方并采取相应的召回等处理措施，以确保用户的利益和安全。

3、产品配送服务保证

(1) 送货上门。货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程的冷链条件，安排货物必须在工作日到达采购人，否则造成的货物质量问题，我公司必须在接到通知后

3 日内无条件进行更换。

(2) 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，交货时须随附货物清单。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。

4、时间承诺及保障措施

1) 我公司在广西壮族自治区南宁市设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于 12 小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

2) 我公司保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达指定地点。若有延误，我方愿意承担与此有关的一切责任。

3) 针对本项目，我公司将成立专为本项目服务的项目领导工作小组，集中公司人力、资源、物资、财力优势，势必按时完成采购方的供货需求。我公司拥有一定数量的交通设施，确保了合同货物的按时供应。

4) 我公司将为本次采购项目配备业务熟练的工作人员，完成采购任务。

5、产品配送服务承诺

(1) 我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达指定地点。产品到达用户指定地点后，由用户组织对医用耗材进行验收。货物运输过程中产品的费用均由我方承担。

(2) 产品的验收严格按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行、按照企业产品说明书进行验收。

(3) 按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证、使用手册等全套技术资料。

(4) 我公司将成立项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。

(5) 若不按时完成任务，我公司愿意承担由此给采购方造成的一切损失和费用。

6、服务保障

(1) 电话支持、远程支持服务保障

热线支持服务包括电话热线和传真支持。设立项目维护技术小组，为用户提供电话热线的技术支持。对用户提出的问题进行解答和问题的登记。技术人员确定解决问

题的负责人。由技术人员负责制定问题的解决方案，或寻求产品制造商的技术支持。并在最短的时间内给用户予以反馈有关问题的解决信息。

任何时间和紧急事态下，用户都可以通过公司提供的项目经理热线 15877136910 获得快捷的支持。

(2) 现场技术支持服务保障

公司提供 7*24 小时全天候技术服务热线支持。按照用户方要求，我公司在根据用户方要求及时指派工程师提供现场支持服务。工程师在服务完成得到用户方确认后方可离开现场，并在 5 日内提供现场服务文档。

(3) 巡检与预防工作服务保障

a 巡检

为了更好地了解系统运行的可靠性，发现可能存在的问题，切实做到主动防护，每季度巡检及用户方规定的重要保障期前巡检，巡检服务后应记录服务内容以及相关问題。并为用户方提供必要的日常监控手段并提供巡检维护服务要求。

通过预防性检查对系统硬件进行检测和诊断，对系统中潜在的硬件故障采取预防措施。如果某些部件出现无法恢复的故障，系统工程师将尽快予以修理更换。维护期内提供定期巡检服务。系统工程师定期巡检的目的在于通过巡检及时发现和纠正可能出现的硬件和系统问题，从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供保证。

b 应急预防

在服务开始阶段，我公司的服务团队将对用户的设备型号、功能模块、运行情况、网络环境、应用环境、业务流程等具体情况进行调研，并根据这些情况制订出符合用户实际环境的应急预案。

应急预案将与用户的实际环境和业务需求高度契合，涉及服务人员、备用设备、预置环境、服务流程等诸多方面，在上述服务响应体系的基础上，最大程度保障用户系统的运行。即使在恶性的紧急突发情况下，用户系统的业务停顿也将近乎于零。


7、售后服务流程

电话服务工作流程

- 客户通过我公司提供的服务电话提出服务请求；
- 客户服务工程师了解客户服务请求内容，填写系统问题单；
- 客户服务工程师初步分析判断故障原因；

- 如果客户服务工程师通过电话服务方式解决了客户问题，就直接在系统问题单上记录问题处理结果，存入系统档案库，存档备案；
- 如果客户服务工程师不能通过电话服务方式解决客户问题，就立即通知现场服务工程师故障情况；
- 现场服务工程师迅速赶赴现场解决问题；
- 填写系统维修单，记录故障处理过程，请求客户签字确认；
- 系统维修单存入系统档案库，存档备案；
- 为了保证系统问题能够得到及时解决，客户服务工程师对于现场服务工程师的问题处理全过程进行跟踪管理；
- 以上是基本的服务流程，在实际处理時会有一些的灵活性，目的是在最短的时间内解决系统故障，保障系统的正常运行。

【流程服务图】

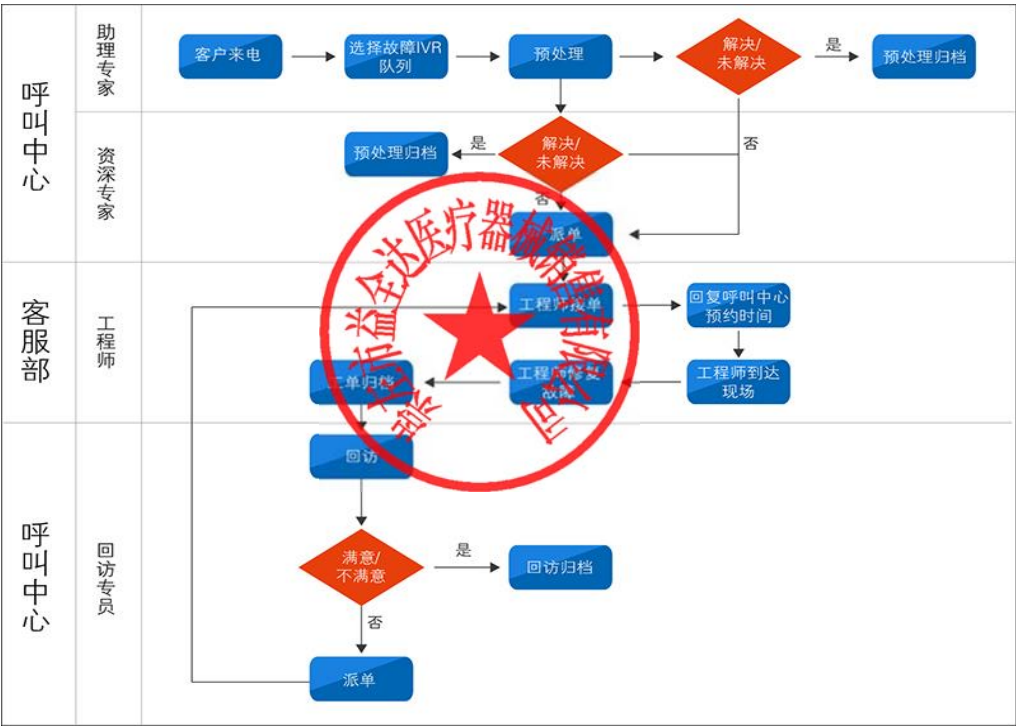

8、产品供货承诺

我公司所投标的产品，均与厂家或其代理商有密切联系，得到厂家方面大力支持，保证产品进货的正常渠道，我公司承诺将以合同要求按时按量按质为用户提供满意的产品。如用户方面有特殊情况要求提前供货的，我公司将配合厂商尽最大努力满足用户要求。所有产品免费送货上门，免费安装调试。

9、产品质量承诺

我公司承诺所提供的设备均为原厂正品，并经测试合格且通过正规的渠道进货，所有产品均为含税产品，享受原厂正规的售后服务，保障用户的利益。提供全新的未经使用的产品，包装独立完整，附装箱清单有明显的中文标示，并附完整的技术资料，包括技术说明书、使用手册、保修证书等。

10、免费的培训

用我们的诚心和行动，不断满足客户期望，帮助客户更好地应用相关设备，提高工作质量。我公司将根据用户的具体需求免费提供设备操作使用及相关技术的培训，使得用户可以熟练和满意使用产品。

培训计划如下：

(1) 授课人员：各产品厂家及我公司均指派经验丰富的工程师进行培训。

(2) 培训时间、地点：授课人员负责培训课程的资料准备，由用户确定培训时间(全天 24 小时响应,不分节假日)、地点。

(3) 组织机构：由本项目的项目经理负责与用户的培训负责人制定培训工作安排，形成培训实施小组和管理培训工作，并随时处理培训过程中出现的各种问题。

11、服务保障


我公司设有投诉电话，直接将用户的服务意见送达监管部门负责人，确保服务执行到位和客户及时满意。对于系统出现故障以及产品的技术或质量问题，用户可以拨打厂家的服务热线或我公司售后服务电话获得技术支持以及维修服务。公司将坚持以热情、周到、迅速、专业完善的服务理念，竭诚的为用户提供满意的服务。就用户对我公司提供的产品和服务有任何意见和不满，我公司在接到来电确认后，将在半小时内作出响应，当天内提供调查结果和处理方案。我公司同时设立电话回访制度，三天内进行电话回访跟踪，以确保用户满意度。

12、服务宗旨

我们倡导“诚信、敬业、创新、超越”的企业精神，以质量求生存，以服务求发展。我们以“热情、周到、诚信、及时”为技术支持和售后服务的宗旨，“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”是我们服务的原则。

我们服务质量的优劣、服务效率的及时性，关系到公司在客户心中的良好形象，关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增强

客户对公司的认可度，提高公司在客户心中的知名度和美誉度。

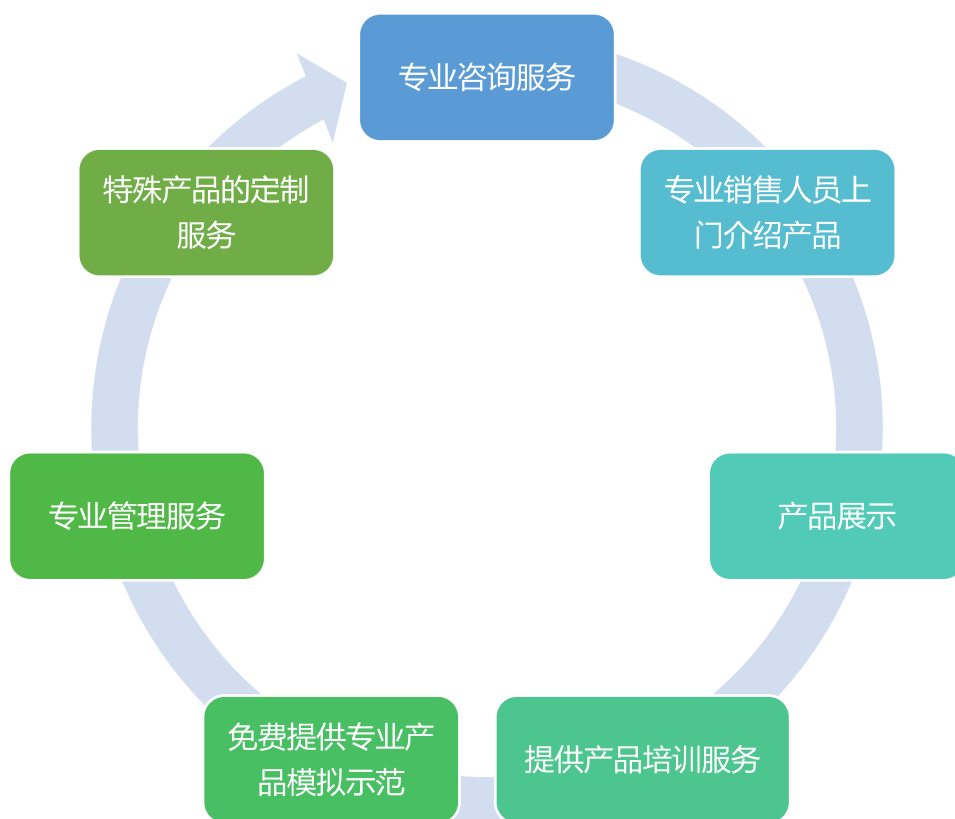

“想客户之所想，急客户之所急”，是公司对于客户服务质量的要求。在加强管理及销售的同时，公司注重投入大量的人力、物力和财力，用于对客户的支持和服务，始终把客户的利益作为关注的焦点，依靠本地化快捷方便的服务优势，力求给客户提供最周到、最满意的服务。

供应商（电子签章）：崇在~~市~~益全达医疗器械销售有限公司

日期：2025年3月14日



八、技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号：CZZC2025-J1-990035-YZLZ

采购项目名称：崇左市人民医院供应室耗材采购

分标号：分标 2

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	医用包装无纺布 (约 60cm×60cm)	1. 约 60g 医用包装无纺布。	1. 60g 医用包装无纺布。	无偏离
		2. 可根据需求定制化。	2. 可根据需求定制化。	无偏离
		3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	无偏离
		4. 医用包装无纺布颜色要求有大于 4 种以上可供选择	4. 医用包装无纺布颜色有蓝色, 粉色, 紫色, 绿色, 白色 5 种可供选择	无偏离
		5. 能同时适用于高低温灭菌。	5. 能同时适用于高低温灭菌。	无偏离
		6. 适用于压力蒸。	6. 适用于压力蒸。	无偏离
2	医用包装无纺布 (约 70cm×70cm)	1. 约 60g 医用包装无纺布。	1. 60g 医用包装无纺布。	无偏离
		2. 可根据需求定制化。	2. 可根据需求定制化。	无偏离
		3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	无偏离
		4. 医用包装无纺布颜色要求有大于 4 种以上可供选择	4. 医用包装无纺布颜色有蓝色, 粉色, 紫色, 绿色, 白色 5 种可供选择	无偏离
		5. 能同时适用于高低温灭菌。	5. 能同时适用于高低温灭菌。	无偏离
		6. 适用于汽灭菌及低温。	6. 适用于汽灭菌及低温。	无偏离
3	医用包装无纺布 (约 100cm×100cm)	1. 约 60g 医用包装无纺布。	1. 60g 医用包装无纺布。	无偏离
		2. 可根据需求定制化。	2. 可根据需求定制化。	无偏离
		3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	无偏离
		4. 医用包装无纺布颜色要求有大于 4 种以上可供选择	4. 医用包装无纺布颜色有蓝色, 粉色, 紫色, 绿色, 白色 5 种可供选择	无偏离
		5. 能同时适用于高低温灭菌。	5. 能同时适用于高低温灭菌。	无偏离
		6. 适用于等离子灭菌。	6. 适用于等离子灭菌。	无偏离
4	医用包装无纺布	1. 约 60g 医用包装无纺布。	1. 60g 医用包装无纺布。	无偏离
		2. 可根据需求定制化。	2. 可根据需求定制化。	无偏离

	(约 120cm× 120cm)	3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	无偏离
		4. 医用包装无纺布颜色要求有大于 4 种以上可供选择	4. 医用包装无纺布颜色有蓝色, 粉色, 紫色, 绿色, 白色 5 种可供选择	无偏离
		5. 能同时适用于高低温灭菌。	5. 能同时适用于高低温灭菌。	无偏离
5	医用包装 无纺布 (约 150cm× 150cm)	1. 约 60g 医用包装无纺布。	1. 60g 医用包装无纺布。	无偏离
		2. 可根据需求定制化。	2. 可根据需求定制化。	无偏离
		3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	3. 符合 GB/T 16886.7-2015, YY/T 0698.2-2022 相关要求, 同时满足《消毒技术规范》2022 版。	无偏离
		4. 医用包装无纺布颜色要求有大于 4 种以上可供选择	4. 医用包装无纺布颜色有蓝色, 粉色, 紫色, 绿色, 白色 5 种可供选择	无偏离
		5. 能同时适用于高低温灭菌。	5. 能同时适用于高低温灭菌。	无偏离
6	医用吸水 纸 (约 25cm× 50cm)	1. 采用 100%全木浆制作, 无荧光增白剂等有害成分, 可自然降解。	1. 采用 100%全木浆制作, 无荧光增白剂等有害成分, 可自然降解。	无偏离
		2. 可在器械包内吸收多余冷凝水, 避免湿包。	2. 可在器械包内吸收多余冷凝水, 避免湿包。	无偏离
		3. 表面有纹理增加摩擦系数, 防止器械滑动, 保护物品。	3. 表面有纹理增加摩擦系数, 防止器械滑动, 保护物品。	无偏离
		4. 适合多种灭菌方式: 高温蒸汽, 环氧乙烷, γ 射线等。	4. 适合多种灭菌方式: 高温蒸汽, 环氧乙烷, γ 射线等。	无偏离
		5. 感官均匀, 无杂质, 无显著斑点, 切面整齐。单位面积质量偏差 5%, 厚度 0.27±0.08, 密度 155 g/dm ³ ±5%。	5. 感官均匀, 无杂质, 无显著斑点, 切面整齐。单位面积质量偏差 5%, 厚度 0.27±0.08, 密度 155 g/dm ³ ±5%。	无偏离
		6. 吸收率≥400%, 断裂强力: 纵向≥30N, 横向≥30N 断裂伸长率: 纵向≥5%, 横向≥7%。	6. 吸收率≥400%, 断裂强力: 纵向≥30N, 横向≥30N 断裂伸长率: 纵向≥5%, 横向≥7%。	无偏离
		7. 质保期不低于 5 年。	7. 质保期不低于 5 年。	无偏离
		8. 适用于压力蒸汽灭菌及低温等离子灭菌。	8. 适用于压力蒸汽灭菌及低温等离子灭菌。	无偏离
7	医用吸水 纸 (约 25cm× 25cm)	1. 采用 100%全木浆制作, 无荧光增白剂等有害成分, 可自然降解。	1. 采用 100%全木浆制作, 无荧光增白剂等有害成分, 可自然降解。	无偏离
		2. 可在器械包内吸收多余冷凝水, 避免湿包。	2. 可在器械包内吸收多余冷凝水, 避免湿包。	无偏离
		3. 表面有纹理增加摩擦系数, 防止器械滑动, 保护物品。	3. 表面有纹理增加摩擦系数, 防止器械滑动, 保护物品。	无偏离
		4. 适合多种灭菌方式: 高温蒸汽, 环氧乙烷, γ 射线等。	4. 适合多种灭菌方式: 高温蒸汽, 环氧乙烷, γ 射线等。	无偏离

		5. 感官均匀, 无杂质, 无显著斑点, 切面整齐。单位面积质量偏差 5%, 厚度 0.27 ± 0.08 , 密度 $155 \text{ g/dm}^3 \pm 5\%$ 。	5. 感官均匀, 无杂质, 无显著斑点, 切面整齐。单位面积质量偏差 5%, 厚度 0.27 ± 0.08 , 密度 $155 \text{ g/dm}^3 \pm 5\%$ 。	无偏离
		6. 吸收率 $\geq 400\%$, 断裂强力: 纵向 $\geq 30\text{N}$, 横向 $\geq 30\text{N}$ 断裂伸长率: 纵向 $\geq 5\%$, 横向 $\geq 7\%$ 。	6. 吸收率 $\geq 400\%$, 断裂强力: 纵向 $\geq 30\text{N}$, 横向 $\geq 30\text{N}$ 断裂伸长率: 纵向 $\geq 5\%$, 横向 $\geq 7\%$ 。	无偏离
		7. 质保期不低于 5 年。	7. 质保期不低于 5 年。	无偏离
		8. 适用于压力蒸汽灭菌及低温等离子灭菌。	8. 适用于压力蒸汽灭菌及低温等离子灭菌。	无偏离
8	B-D 预警测试包	1. 符合 GB18282.4-2009 (或 ISO11140) 对用于代替性 BD 类蒸汽渗透测试的二类指示物的要求;	1. 符合 GB18282.4-2009 (或 ISO11140) 对用于代替性 BD 类蒸汽渗透测试的二类指示物的要求;	无偏离
		2. 化学指示物不含铅、铜等重金属, 符合人眼的视觉特性, 易判读;	2. 化学指示物不含铅、铜等重金属, 符合人眼的视觉特性, 易判读;	无偏离
		3. B-D 试验预警测试纸敏感度更高, 在 B-D 试验失败前, 预警灭菌器的维护。	3. B-D 试验预警测试纸敏感度更高, 在 B-D 试验失败前, 预警灭菌器的维护。	无偏离
9	压力蒸汽灭菌化学指示卡	1. 符合 GB18282.1-2015 (或 ISO11140) 对四类化学指示物的要求。	1. 符合 GB18282.1-2015 (或 ISO11140) 对四类化学指示物的要求。	无偏离
		2. 化学指示物不含铅、铜等重金属。	2. 化学指示物不含铅、铜等重金属。	无偏离
10	压力蒸汽灭菌化学指示标签	1. 符合一类化学指示物的要求;	1. 符合一类化学指示物的要求;	无偏离
		2. 规格版面可根据科室的需求进行定做。	2. 规格版面可根据科室的需求进行定做。	无偏离
11	低温灭菌包装材料 (宽度约 100mm)	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	无偏离
		2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	无偏离
		3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	无偏离

12	低温灭菌包装材料 (宽度约150mm)	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	无偏离
		2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	无偏离
		3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	无偏离
13	低温灭菌包装材料 (宽度约200mm)	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	无偏离
		2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	无偏离
		3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	无偏离
14	低温灭菌包装材料 (宽度约300mm)	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	1. 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 32309-2015 的检验要求, 检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定; 含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测; 含有透气性微生物屏障试验; 含有灭菌因子残留量的测定;	无偏离
		2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	2. 产品使用专用纸, 柔韧、耐穿刺、透气。	无偏离
		3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	3. 适用于过氧乙酸、过氧化氢等低温等离子灭菌。	无偏离
15	高温灭菌包装材料 (宽度约55mm)	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	无偏离

		2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	无偏离
16	高温灭菌包装材料 (宽度约 75mm)	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	无偏离
		2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	无偏离
17	高温灭菌包装材料 (宽度约 100mm)	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	无偏离
		2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	无偏离
18	高温灭菌包装材料 (宽度约 150mm)	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	无偏离
		2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	无偏离
19	高温灭菌包装材料 (宽度约 200mm)	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	无偏离
		2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	无偏离

20	高温灭菌包装材料 (宽度约300mm)	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	1. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物, 符合《消毒技术规范》、GB 18282.1-2015 及 GB/T 33418-2016 的检验要求, 检验报告中含有等同于灭菌后, 无菌有效期持续 180 天的检测以及透气性微生物屏障试验;	无偏离
		2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	2. 产品使用专业医用透析纸, 平均克重不低于 70(±5%)g/m ² , 柔韧、透气, 有防爆边设计。	无偏离

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
 供应商（电子签章）：崇左市益全达医疗器械销售有限公司
 日期： 2025 年 3 月 14 日



投标报价明细表

投标人全称（公章）： 崇左市益全达医疗器械销售有限公司

项目编号及分标： 崇左市人民医院住院室耗材采购（CZZC2025-H-99003-YZLZ）-分标2



供应商名称	报价(总价，元)	交货期
崇左市益全达医疗器械销售有限公司	161158.3	所有产品在合同签订后3 天内开始供货，服务期1 年

竞标报价表

项目名称：崇左市人民医院供应室耗材采购 项目编号：CZZC2025-J1-990035-YZLZ

分标（如有）：分标2

供应商名称：崇左市益全达医疗器械销售有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价 ③=①×②	备注
1	医用包装无纺布	15000张	桂械	60cm×60cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	0.80	12000.00	
2	医用包装无纺布	11233张	桂械	70cm×70cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	1.10	12356.30	
3	医用包装无纺布	4000张	桂械	100cm×100cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	2.30	9200.00	
4	医用包装无纺布	4000张	桂械	120cm×120cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	3.10	12400.00	
5	医用包装无纺布	8000张	桂械	150cm×150cm	桂械医疗科技有限公司	南宁	5.00	40000.00	
6	一次性医用擦手/吸水纸	15000张	天维	25cm×50cm (1000张/箱)	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.41	6150.00	
7	一次性医用擦手/吸水纸	16000张	天维	25cm×25cm (1000张/箱)	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.25	4000.00	
8	B-D试验包(预警)	1100包	天维	120mm×120mm×15mm (40包/箱)	山东天维医疗科技有限公司	山东	22.00	24200.00	
9	132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	100000片	天维	ST132 (200片/盒)	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.10	10000.00	
10	压力蒸汽灭菌化学指示标签	90000片	天维	61mm×34mm (900片/卷)	山东天维医疗科技有限公司	山东	0.17	15300.00	

11	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	150米	天 维	100mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	3.50	525.00	
12	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	150米	天 维	150mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	5.50	825.00	
13	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	600米	天 维	200mm×100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	7.20	4320.00	
14	过氧化氢 等离子体 灭菌指示 包装袋	300米	天 维	300mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	10.50	3150.00	
15	医用灭菌 包装袋	300米	天 维	55mm×100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	0.54	162.00	
16	医用灭菌 包装袋	2000米	天 维	75mm×100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	0.72	1440.00	
17	医用灭菌 包装袋	2000米	天 维	100mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	0.85	1700.00	
18	医用灭菌 包装袋	1500米	天 维	150mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	1.40	2100.00	
19	医用灭菌 包装袋	500米	天 维	200mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	1.70	850.00	
20	医用灭菌 包装袋	200米	天 维	300mm× 100m	山东天维 医疗科技 有限公司	山东	2.40	480.00	

合计金额大写：人民币壹拾陆万壹仟壹佰伍拾捌元叁角（¥161158.30）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟）

占本竞标报价的比例为0.00%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0.00%。

注：竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）赵念东

供应商（电子签章）：崇左市益全达医疗器械销售有限公司

2025年3月20日

成交通知书

崇左市益全达医疗器械销售有限公司:

经评定, 编号为CZZC2025-J1-990035-YZLZ采购文件中的崇左市人民医院供应室耗材采购-分标2, 确定你公司成交, 成交价格为: 壹拾陆万壹仟壹佰伍拾捌元叁角整(¥161,158.30)。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 郑娟

电话: 15977665532

代理机构联系人: 梁立宇

电话: 0771-7833699

