

合同编号：12N49950890220257

政府采购合同书

合同名称：靖西市人民医院新院一批设备采购项目分标8（
半自动轮转式切片机、通风柜、标本存放柜、
取材台）

合同编号：12N49950890220257

甲方：靖西市人民医院



乙方：广西北部湾医疗科技股份有限公司

签订合同地点：靖西市人民医院

签订合同时间：2025年3月11日

目 录

- 1、合同书
- 2、采购需求
- 3、投标函
- 4、投标报价表
- 5、售后服务方案
- 6、中标通知书

1、合同书

(甲方) 采购单位: 靖西市人民医院

(乙方) 中标单位: 广西北部湾医疗科技股份有限公司

项目名称: 靖西市人民医院新院一批设备采购项目

项目编号: BSZC2025-G1-250003-GXBS

采购计划编号: JXZC2024-G1-01564-008

签订地点: 靖西市人民医院

签订时间: 2025年3月11日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定, 按照招标文件及响应文件规定条款和中标供应商承诺, 甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	型号规格	注册人/备案人	数量	单位	单价(元)	金额(元)	注册证编号/备案编号	产品注册证名称/实物名称
1	半自动轮转式切片机	达科为	MT1	达科为(深圳)医疗设备有限公司	1	台	74000.00	74000.00	粤深械备20220150	轮转式切片机
2	通风柜	俊杰	JTFG-1500	武汉俊杰电子有限公司	5	台	15500.00	77500.00	不作为医疗器械管理	通风柜
3	标本冷藏柜	俊杰	JLCG-1260	武汉俊杰电子有限公司	1	台	14500.00	14500.00	不作为医疗器械管理	标本冷藏柜
4	病理取材台	俊杰	JQCT-1800	武汉俊杰电子有限公司	1	台	49500.00	49500.00	不作为医疗器械管理	病理取材台
人民币合计金额: 贰拾壹万伍仟伍佰元整 (¥ 215500.00元)										

2. 合同合计金额报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务(包括技术资料的提供)、质保期保障、设备检测、培训及与医院信息系统对接的接口费等所发生的一切费用。如招标文件及投标文件对其另有约定的, 从其约定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 合同提供设备的生产日期不得超过半年，乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方对合同标的享有合法、完整的所有权，合同标的不存在租赁、担保或保留所有权等权利瑕疵的情形，乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与本合同无关的任何其他人，即使向履行本合同有关的人员提供，也应该注意保密并限于履行合同的必需范围。

。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件及响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输：由乙方负责。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1. 交货期：合同生效后 25 日历日天内交货完毕。地点：采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件及响应文件和合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格（但属于隐蔽性瑕疵的除外）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位盖章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条 培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间由甲方指定培训时间、地点：由甲方指定培训地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按成交人响应文件承诺（自项目验收合格之日起 **3 年**）。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他约定事项应与招标文件规定一致（见合同附件）。

4. 若甲方因工作需要调整工作地点，成交供应商免费将设备搬迁至新的工作地点并安装调试完毕。

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：单位自筹资金。

3. 付款方式：交货安装验收合格，乙方必须开具合法全额发票，甲方正常使用满 3 个月后付合同价款的95%，剩余总货款的5%在质保期结束后30个工作日内一次性付清（不计利息）。

第九条 质保金：无

第十条 履约保证金：无

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

第十二条 质量保证

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。未满足要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内到甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚（或按第十二条第一款处理）；因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的5%，超过10天对方有权解除合

同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量因造成的问题，由乙方负责更换或甲方退货，由此造成的损失从合同剩余总货款的5%中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签字书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同已经签订。甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的招标文件及投标（响应）文件；
3. 谈判应答承诺书（如有）；
4. 中标通知书。

第二十条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方持三份，乙方持一份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购代理机构应当将合同在广西壮族自治区政府采购(<http://www.ccgpguangxi.gov.cn/>) 发布合同公告。

甲方（章）靖西市人民医院 2025年3月11日	乙方（章）广西北部湾医疗科技股份有限公司 2025年3月11日
单位地址：	单位地址：广西壮族自治区南宁市江南区南宁市金凯路8号龙光玖誉城悦城组团62号楼养老用房4楼401、402、403
法定代表人：	法定代表人：程颂
委托代理人：	委托代理人：史艳伟
电 话：0776-6212291	电 话：0771-5824275
电子邮箱：jxsrmmycgb@163.com	电子邮箱：
纳税人识别号：12451081499508902N	纳税人识别号：914501007658268404
开户银行：农行靖西市支行营业室	开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁桃源支行
账 号：20-630101040007472	账 号：78860188000242714
邮政编码：533899	邮政编码：530000

第二章 采购需求

说明：

本项目不专门面向中小企业预留采购。项目属专业性较强的专业设备设施,符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)中符合下列情形的可不专门面向中小企业之(三):按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

1. 为落实政府采购政策需满足的要求:

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)的规定,采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的(详见本章附件1),供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品,供应商必须在响应文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件(加盖供应商电子公章),否则响应文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时,应优先采购,具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者技术要求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

本一览表货物品牌型号、技术参数及其性能配置仅起参考作用,供应商可选用其它品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能配置要求;本一览表中参考品牌规格及技术参数不明确或有误的,或供应商选用其它品牌号替代的,请以详细、正确的品牌型号、技术参数配置同时填写投标报价明细表和技术规格响应表。

▲3. 供应商应根据自身实际情况如实响应招标文件,不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应,还应当提供相关证明材料,否则将按无效响应处理(定制采购不适用本条款)。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料,技术支持资料以招标文件中规定的形式为准,否则将视为无效技术支持资料。

4. 采购预算:

详见招标公告

一、技术要求

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人)。

本项目所属行业:工业。

产地要求:国产。

				材料，激光切割、数控折弯加工而成，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。		
			4	开门方式	手动翻转门或其他	
			5	快速管路设计	排水管路含排水泵，排水时间≤4min 管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关	
			6	液晶显示屏	液晶屏显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、过程、状态、参数等诸多信息；	
			7	功能	煮沸清洗功能	
			8	控制方式	工业级单片机芯片；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。	
			9	加热方式	电加热，功率≥6KW	
			10	清洗温度	30℃~95℃可调	
			11	安全保护	水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声； 超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出； 电机过流保护	
			12	运行时间	≤45Min	
8	半自动轮转式切片机	1台	1. 切片方式：半自动轮转 2. 切片厚度：0.5-100 μm 3. 修块厚度：1-600 μm 4. 水平进样幅度：至少 24mm ★5. 垂直样品行程：至少 70mm 6. 静音样品回缩：5-100 μm，可关闭 7. 粗进速度：300 μm/s，800 μm/s 和 1800 μm/s 8. 两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式 9. 手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳 ★10. 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 11. 最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm 12. 独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作 13. 个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向 14. 带 0 位的样本定位系统，可 X/Y 轴调节，8 度水平定位样本 15. 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 16. 具备储物盘功能，方便放置常用工具 17. 刀架带有护手，确保操作者安全			12.8

			<p>18. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长</p> <p>19. 手轮至少有 2 个独立的安全锁定系统</p> <p>20. 快速转换样本夹，可单手操作</p> <p>21. 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片</p> <p>22. 具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能</p> <p>23. 至少有两种小手轮运行模式：步进和连续</p> <p>24. 可归零的切片以及厚度计数功能</p> <p>25. 可视信号和声音信号提示剩余进样距离</p>	
8	通风柜	5 台	<p>主要特点：</p> <p>1、结构：钢制结构，柜体落地式，支撑整体重量；柜体采用不小于 1.0mm 厚冷轧钢板，表面经：除油、除锈—水洗—中和—水洗—表调—钝化—磷化—钝化—烘干—检验—静电喷涂—高温固化。表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。</p> <p>2、内衬板：顶板、侧板、导流板等采用 5mm 厚耐腐蚀的高分子材料或类似材料，抗倍特板，耐稀酸碱及有机溶剂、易清洗。置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或漩涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出。</p> <p>3、导流板固定座：底座由螺杆、螺帽组成，采用高分子复合材料注塑成型，导流板固定旋钮及蒸馏架安装孔座等，具有良好性能：（1）背板固定座及导流板固定旋钮均可由柜体正面轻易组装及拆解维护清理。（2）不含金属成分，耐腐蚀，耐用且无杂质产生影响实验；（3）承重能力每个至少 10kg。</p> <p>4、窗口玻璃：采用上下滑动式设计，可开启于任意高度，采用 5mm 厚钢化透明安全玻璃；窗框内装有硬质塑胶导轨，两侧设置缓冲垫片，避免玻璃门上下升降撞击，PVC 工程材料，线接触设计，最低程度减少摩擦力。视窗把手：采用特制 PVC 材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。</p> <p>5、★同步驱动齿轮升降系统：采用高强度 ABS 加强白色轮，黑色底座，内置全包围轴承，整体耐酸碱防腐，有效的防止有害气体的腐蚀，坚固耐用。橡胶皮带，采用宽 15mm×厚 3.8mm 高强度橡胶带绿布同步带，聚氨酯内植 8 根钢丝，移门升降过程中平稳有效阻止倾斜、轻便、静音、安全（防跌落）。同步链接杆采用 15×15mm 不锈钢管，整合了皮带传动、链传动和齿轮传动各自优点的新型带传动本装置可使其传动平稳，结构简单，安装方便。耐酸碱、防潮防锈，不断裂，使用寿命长。</p> <p>6、照明：日光灯采用实验室专用全封闭式日光灯，220V*30W，采用隔离式安装，避免和柜内气体接触。</p> <p>7、操作台面：12.7mm 厚实芯理化板，边缘加厚，台面性能满足：（1）耐酸碱腐蚀，化学特性包括：硫酸（98%）、硝酸（70%）、盐酸（55%）、乙酸（99%）、氢氧化钠（40%）、亚硝酸钠、磷酸（85%）等常用试剂，检测表面无明显变化；（2）物理性能良好，抗拉强度≥74mpa、弯曲强度≥110.5mpa、抗冲击检测合格。（3）甲醛释放量检验达到国家环保 E1 级标准，测试方法使</p>	12.5

用气候箱法，甲醛释放量不大于 0.01mg/m³；（4）重金属检测，包括铅、汞、镉、锌、铬、钡、砷等元素，检测结果合格。

8、柜体：（1）门板：1.0mm 厚冷轧钢板，内外双层扣合式，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180 度高温固化，耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长；（2）铰链：自闭式液压合金铰链，柜门开启 105° 内，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；（3）滑轨：优质钢制三节静音滑轨，拉动负重 25 公斤，使用寿命拉动次数大于 100000 次；（4）拉手：拉手或门板拉手一体内凹成一字型拉手。

9、PP 水杯：（1）材质：高密度 PP，耐酸、碱、王水等腐蚀；（2）尺寸：外径约 L200×W100×D180mm（含）以上；（3）配 PP 滤水提笼及塑料水盖，PP 落水头堵臭装置；

★水龙头：1、主体材料：加厚国标 H62 铜管制造，直管管径 Φ26*1.2mm，臂管管径 Φ22*1.2mm，鹅颈管管径 Φ19*1.0mm，可 360° 旋转，固定底座直径 ≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。2、材质要求：加厚纯铜制作，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；开关旋钮 PP 材质，开启为红色，关闭为绿色标识清晰醒目，平稳轻便无卡阻、不易松动稳定性强，开关寿命大于等于 61 万次，静态最大耐压 2.5MPa。

10、尺寸：1500*850*2350mm（可定制）。

通风柜配置清单

序号	项目名称	数量	说明
1	主机	1 台	
2	排气管	1 根	配件
3	单口水龙头	1 个	配件
4	PP 水杯	1 个	配件
5	使用说明书	1 份	随机文件
6	产品保修单	1 份	随机文件
7	产品合格证	1 份	随机文件

8	标本存放柜	1台	<p>外观高档豪华，整体采用不锈钢制作、抗腐蚀、经久耐用、易清洁。</p> <p>2、内腔为铝制压花板。</p> <p>3、内藏板式蒸发器，换热效率高。</p> <p>4、中空玻璃门密封好、开启灵活，关闭严密，能有效防止有害气体溢出；双开门结构，强度高、且便于观察柜内标本。</p> <p>5、采用名牌压缩机，性能稳定，制冷效果好。</p> <p>6、聚氨酯高压发泡，箱体更稳固，保温性能更好。</p> <p>7、精确的微电脑液晶数字温度显示器，柜内温度一目了然。</p> <p>8、冷凝器有可拆式滤网，便于更新和维护。</p> <p>9、内置三层金属喷塑网隔板、高度可调节。承重力强、单层承约重 30kg。可配专用不锈钢或塑料标本存放盒。</p> <p>10、顶部装有排风系统，可将有害气体排放出室外。</p> <p>11、排风量：95m³/h、噪音：≤34Db。</p> <p>12、外形尺寸：≥1200×640×1910mm。</p> <p>13、容量：≥800L。</p> <p>14、温度：2~8℃。</p> <p>15、制冷方式：风冷。</p>	1.5																				
8	取材台	1台	<p>主要特点：</p> <p>1.主体结构、工作台面采用 316 不锈钢材质。</p> <p>2.工作台面</p> <p>2.1左右设置玻璃挡板，避免液体飞溅；</p> <p>2.2两侧配置排水喷淋系统及多喷嘴台面冲洗系统，冲水大小可调整；</p> <p>2.3采用上下两层水气分管道设计，高效排风排气；</p> <p>2.4配置带过滤网引流漏斗，配置刀架、搁架可存放工具；</p> <p>2.5所有吸气排风口设计在工作台面下，双电机超静音，强力排气系统，用管道排出室外，保护工作人员不受有害气体侵害。</p> <p>3.冷热水给排水系统：24小时限量供应热水，冷、热水可自由调节，配置可伸缩金属软管水龙头及热风烘手机。</p> <p>4.配置紫外线杀菌装置、全封闭式 LED 日光照明灯、无影补光灯及取材照明专用射灯。</p> <p>5.抽风系统：低噪音、大功率，风机安装位置与取材台主体相分离。</p> <p>6.具有可调节角度的送清风补风装置。</p> <p>7.配置碎骨机，对碎骨和废弃物进行粉碎排除。</p> <p>8.配置标本摄像系统，可实现拍照保存、摄像及网络联接功能。</p> <p>9.外形尺寸：1.5×1.95×0.75m（长×高×宽）。（可定制）</p> <p style="text-align: center;">取材台配置清单</p> <table border="1" data-bbox="644 1294 1129 1476"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>数量</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>主机</td> <td>1台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>紫外线杀菌装置</td> <td>1套</td> <td>配件</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>全封闭式 LED 日光照明灯</td> <td>1个</td> <td>配件</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>无影补光灯</td> <td>1个</td> <td>配件</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	数量	说明	1	主机	1台		2	紫外线杀菌装置	1套	配件	3	全封闭式 LED 日光照明灯	1个	配件	4	无影补光灯	1个	配件	7
序号	项目名称	数量	说明																					
1	主机	1台																						
2	紫外线杀菌装置	1套	配件																					
3	全封闭式 LED 日光照明灯	1个	配件																					
4	无影补光灯	1个	配件																					

			5	取材照明专用射灯	1个	配件	
			6	带过滤网引流漏斗	1个	配件	
			7	排气管	1根	配件	
			8	冷暖水龙头	1个	配件	
			9	可伸缩金属软管水龙头	1个	配件	
			10	热风烘手机	1个	配件	
			11	碎骨机	1台	配件	
			12	标本摄像系统	1套	配件	
			13	电源线	1根	配件	
			14	使用说明书	1份	随机文件	
			15	产品保修单	1份	随机文件	
			16	产品合格证	1份	随机文件	
9	医用吊桥	38套	<p>一、桥式吊塔要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的变化导致线路脱落的意外发生。 2.桥式吊塔产品符合欧盟或中国认证标准。 3.桥式吊塔产品符合气电分离要求，确保吊塔使用安全性。 4.横梁长度 2200mm-3300mm 可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。 5.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有 Standby（原位待接通状态）功能。插座插头可带气维修，维修费用低廉。 6.吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，美观时尚、更易清洁。 7.气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理。 8.所有气管为医用气体管路，医用气体正压柔性管内部直径$\geq 5\text{mm}$，负压吸引的内部管道直径$\geq 6\text{mm}$，保证负压的良好使用。 9.为保证吊塔使用寿命，吊塔外壳应通过涂膜附着力学测试。 10.为适应医疗使用环境，吊塔外壳通过中性盐雾试验。 <p>二、干区配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.干区承重负载能力$\geq 120\text{Kg}$。 2.气电箱长度$\geq 800\text{MM}$ 3.标准气体插座至少（空气 1 个，负压吸引 1 个，氧气 1 个），含所有插头 4.电源插座≥ 6个 5.网络接口≥ 1个 6.等电位住≥ 1个 7.二层设备托盘，其中一层带抽屉 <p>三、湿区配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.湿区承重负载能力$\geq 120\text{Kg}$ 2.气电箱长度$\geq 800\text{MM}$ 3.标准气体插座至少（空气 1 个，负压吸引 1 个，氧气 				100.7

			<p>检查项目等；支持查看学生视力趋势图。</p> <p>(2)《液晶视力表》技术参数</p> <p>1、支持测试裸眼视力和戴镜视力，数据支持蓝牙传输及WIFI无线传输。</p> <p>2、具有裸眼视力检测模式、戴镜视力检测模式、低视力(≤4.0)检测模式,三种测试模式可自由切换；</p> <p>3、支持移动端应用程序操控检测视力，并在系统中选择学生不同戴镜类型，可相应确定视力表检测项目。</p> <p>4、满足拥挤效应,支持自定义单行视标及单个、多个视标，视标开口方向随机出现，消除因人为记忆所造成的检测误差。</p> <p>5、可根据检测距离，调整视标大小</p> <p>6、液晶屏：电容触摸屏，10点投射式电容触控技术，5毫秒快速反应；</p> <p>7、屏幕尺寸：≥15.6英寸；</p> <p>8、分辨率：≥1920×1080；</p> <p>9、视标类型：E视标、儿童视标；</p> <p>10、数据传输方式：蓝牙,支持蓝牙4.0,同时支持WIFI无线传输，传输距离≥7米。</p> <p>11、设备具有二类医疗器械资质。</p>	
19	3D视觉功能训练系统	1套	<p>1、结构及组成：产品预装于计算机交付，主要由精细刺激训练、视觉技巧训练和双眼视功能训练等三个模块或更多模块组成。</p> <p>2、适用范围：适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。</p> <p>3、产品特点：能够根据患者的视力和视功能状况，因人而异制定个性化的治疗方案,能让患者进行更有效的弱视康复训练、提高视觉功能。</p> <p>4、软件运行环境要求</p> <p>a) CPU: 高通骁龙830同等或更高配置；</p> <p>b) 内存: 不低于4GB；</p> <p>c) 硬盘: 不低于32GB；</p> <p>d) 显示器: 显示器分辨率不低于1920X1080；</p> <p>e) 网络连接: 10M宽带或无线网络。</p> <p>5、接口: 支持HDMI接口，支持DP接口，支持USB扩展/充电等。</p> <p>6、训练项目: 软件训练项目不少于18个内容。</p> <p>7、训练刺激模式至少含三种刺激模式。</p> <p>8.资质: 产品有医疗器械二类产品注册证。</p>	9.8
<p>▲注: 1. 所有设备向采购人提供所有数据通讯、技术接口服务，开放接口的费用由本项目中标人自行承担。</p> <p>2. 所有系统设备要求与医院信息网络数据互联互通，与医院信息系统连接所产生的费用由中标人自行承担。</p>				

<p>3. 备品备件及耗材等要求：设备安装时所需的备品备件及耗材由中标人负责提供。</p> <p>4. 本项目验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。供应商报价时应考虑相关费用。</p> <p>5. 所有提供设备需为供货时近半年内生产的产品。</p>	
<p>以上涉及到设备性能及配置评审的相关参数均需添加到中标人的货物采购合同内，且采购人有权要求针对现场货物的部件的品牌及产地进行各种甄别方式（如第三方商检）。如甄别结果与合同内一致的，甄别的费用由采购人负责，如果甄别的结果与合同不一致的，甄别的费用由中标人负责，且中标人需赔偿采购人由此产生的所有损失，并承担相应的法律责任。</p>	
<p>二、商务要求</p>	
<p>▲交付的时间和地点</p>	<p>合同履行期限：详见招标公告。</p> <p>地点：采购人指定地点。</p> <p>货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由中标人负责，并承担相关责任。</p>
<p>付款条件</p>	<p>按合同条款执行。</p>
<p>▲售后服务</p>	<p>1.质保期：不少于一年。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除质保期特别注明外。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。保修期内，出现维修超过三次，未修好，需要第四次维修的，可要求换新机。</p> <p>2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：</p> <p>（1）负责免费送货上门，安装调试，培训操作人员。</p> <p>（2）不能正常使用的必须提供备用货物。</p> <p>（3）定期回访以及对货物维修。</p> <p>（4）其余按厂家承诺。</p> <p>3.中标人应配置专业安装、维修人员进行服务。</p> <p>4.要求中标人对采购人的服务通知，紧急故障处理：接到客户反馈后必须半小时响应，24小时之内赴现场处理；不需要更换备件的情况下应在12小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障。</p>
<p>▲质量标准</p>	<p>所供货物必须是全新的且按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的货物；零部件、配件及安装材料必须是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。</p>
<p>▲规范标准</p>	<p>执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p>

▲需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等	见本表“技术参数及性能配置要求”。投标人所投标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷。投标人需在投标文件中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，当出现知识产权或者经营权侵权行为时由投标人承担所有责任。
三、验收标准	
<p>验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>1. 中标人代表必须参与现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。如供货时出现有货物停产的情况，中标人必须提供具备与原货物技术参数要求相同或高于原货物技术参数要求的替代产品。</p> <p>2. 中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保投标人所提供产品参数的真实性，中标产品验收时进行现场测试，满足要求后方可进行验收。若中标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关监管部门对其进行处理。</p>	
四、进口产品说明	
本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。	
五、其他要求	
<p>1. 投标人可于投标文件中自行考虑是否提供项目实施方案（可包括但不限于：对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）、设备对接方案、对项目需求分析、针对本项目配备的实施团队、组织管理措施、详细的交货保证措施、安全措施、项目组织安排、建议的安装、调试、验收方法或方案等）；</p> <p>2. 投标人可于投标文件中自行考虑是否提供项目应急处理预案（可包括但不限于：突发情况的人员安排、保障解决问题、解决方案、应急组织机构、提供替代品或配件方案、有具体的解决办法和措施保障，规范及方案、进度及目标、预期达到的效果、管理、组织协调、实施细则等）；</p> <p>3. 投标人投标时投标文件中必须列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能。</p>	

投标函

1、投标函

致：采购人名称：靖西市人民医院

根据贵方项目名称：靖西市人民医院新院一批设备采购项目（项目编号：BSZC2025-G1-250003-GXBS）的招标公告，签字代表史艳佳（姓名）经正式授权并代表投标人广西北部湾医疗科技股份有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

5. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

7. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：广西壮族自治区南宁市江南区南宁市金凯路8号龙光玖誉城悦城组团62号楼养老用房4楼401、402、403 邮编：530000

电话：0771-5807622 传真：0771-5807622

投标人名称：广西北部湾医疗科技股份有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁市桃源支行

银行帐号：7886 0188 0002 42714

法定代表人或者委托代理人（签字/签章）：史艳佳

投标人（盖电子公章）：广西北部湾医疗科技股份有限公司

2025年1月24日

投标报价表

2、开标一览表

项目名称：靖西市人民医院新院一批设备采购项目 项目编号：BSZC2025-G1-250003-GXBS

标项：标项 8

投标人名称：广西北部湾医疗科技股份有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	数量及单位 ①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
8	半自动轮转式切片 机	达科为	1 台	74000.00	74000.00
8	通风柜	俊杰	5 台	15500.00	77500.00
8	标本存放柜	俊杰	1 台	14500.00	14500.00
8	取材台	俊杰	1 台	49500.00	49500.00
合计金额大写：人民币贰拾壹万伍仟伍佰元整（¥215500.00 元）					

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字/盖章）

程颀

投标人（盖电子公章）广西北部湾医疗科技股份有限公司

日期：2025 年 1 月 24 日



售后服务方案

5、售后服务承诺

我司根据本次项目需求，为了更好的服务客户，为贵院专门提供如下售后服务方案：

一、免费保修期限

- 1、质保期：三年。
- 2、我司按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除质保期特别注明外。
- 3、质保期内，如设备出现质量问题，我司提供免费上门服务、维修、更换配件服务，出现维修超过三次，未修好，需要第四次维修的，采购人可要求换新机。如因采购人工作人员操作不当或其它人为因素造成的设备故障或损坏，采购人不能自行解决的，我司免费派人上门协助维修解决，如需更换零配件，将收取零配件费用。
- 4、质保期内提供原厂系统和安全必需的免费软硬件升级

二、故障响应时间

- 1、接到通知响应时间：我司接到采购人故障通知，20分钟内响应，通过远程方式了解故障问题，查找故障原因，能明确找出故障问题并能远程解除故障的，即刻远程处理。
- 2、接到通知到达现场处理故障时间：故障不能通过远程方式解除的，我司自接到故障通知起24小时内安排技术工程师到达现场处理故障问题。
- 3、一般故障承诺解决时间：一般故障问题，在不需要更换备件的条件下，我司将在12小时内解除故障，需要更换备件时，我司24小时内解除故障。
- 4、故障无法排除时的解决方案：遇到重大故障不能24小时内解除故障的，我司根据故障原因提交故障解决方案给到采购人，不能及时修复的，我司根据采购人需求，可提供备用机或备件。

三、本地化售后服务

- 1、本地化服务团队：我们在当地设有专业的售后服务团队，团队成员均经过严格的技术培训和服务意识培训，熟悉本地客户需求和市场情况，能够快速响应客户服务请求。售后服务团队配备充足的技术人员和维修设备，接到采购人使用中遇到的相关问题或故障，能及时响应并安排技术人员到达采购人地点排除故障，确保能够及时为客户提供现场服务。
- 2、本地售后服务地址



序号	服务单位名称	地址	联系电话
1	广西北部湾医疗科技股份有限公司	广西壮族自治区南宁市江南区南宁市金凯路8号龙光玖誉城悦城组团62号楼养老用房4楼401、402、403	0771-5807622

四、回访措施

1、仪器保养：对于需要定期保养的仪器，我们将根据仪器的使用频率和实际情况，合理安排保养时间。如客户有随时保养的需求，我们将在接到通知后的48小时内安排专业技术人员上门进行保养服务。

2、回访方式及内容：回访方式主要采用电话回访和实地回访相结合。电话回访主要了解产品使用过程中是否出现问题、客户对产品性能和服务的满意度等；实地回访为技术人员将上门检查仪器运行状况，进行必要的维护保养，并与客户现场沟通，收集客户对产品和服务的意见和建议。

五、维护措施

1、目标：通过定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，使设备始终处于最佳的运行状态。

2、制定计划

2.1 质保期内维护保障计划如下表：



内容 \ 工作日	第1个月	第2个月	第3个月	第4个月	第5个月	第6个月	第7个月	第8个月	第9个月	第10个月	第11个月	第12个月
	设备定期巡检						✓					
设备定期维护保养培训						✓						✓
质保期设备维修	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
设备除尘清洁												✓

3、质保期内：我司为采购人提供每年2次上门维护保养巡检服务，维护巡检完成后，并出具相关的检测报告及保养合格证交给用户保留，作为再次维护保养的依据。

4、质保期外：我司提供终身维护和保养服务，对设备免费提供软件升级、电话咨询服务及技

术维护的相关资料。

5、实施计划：按照计划实施各项维护保障措施，注意监控实施过程中的情况，及时调整计划以适应实际情况。

6、检查与评估：在实施计划的过程中，需要定期对执行情况进行检查和评估，以确保计划的有效性和实施效果。同时，也需要对计划进行必要的调整和改进。

7、反馈与改进


7.1 采购人、相关技术人员通过添加售后工程师的联系电话、微信、QQ等通讯方式，或建立微信群、QQ群，及时跟进及指导设备使用情况，保证事事有反馈，需要现场支持的，及时赶赴现场。

7.2 在维护保障流程执行完毕后，及时进行反馈和总结，分析优点和不足之处，以便在未来的工作中不断完善和提高。

六、技术服务队伍及售后服务人员

1、技术服务队伍：为保证项目的顺利进行，提高项目实施效率和保证质量，把控项目的风险，我司根据各方在项目中的不同的责任和义务，在项目开始后将分别成立项目运筹领导小组、项目监督小组和项目技术组，采用领导小组下的项目经理负责制，并明确规定所属下级各组的职责及组间协调关系。

1.1 项目实施组织机构图如下：



1.2 项目实施小组职责

序号	项目阶段	项目任务	参加和负责人员
1	供货准备	成立项目小组	项目经理 项目人员
2		签订项目合同	运营管理组
3		与用户单位沟通协调	项目经理
4		项目实施准备	项目经理

5	供货实施	实施方案计划	设备工程组
8		设备安装调试	设备工程组
9		供货产品质量	质量管理组
10	设备验收	系统测试	项目经理、厂家技术组
11		项目验收	项目经理、厂家技术组
12		培训计划	项目经理、厂家技术组、应用培训组
13	设备维护	售后服务	设备工程组/厂家技术组

2、我司售后服务主要人员：

序号	人员	岗位	职责
1	杨国林	工程师	负责项目整体设备安装验收调试、技术培训
2	蒋跃武	工程师	负责项目设备安装验收调试、技术培训
3	邹天明	工程师	负责项目设备日常维护保养、维修等相关工作

七、耗材和备品备件配备

我司设有专业的售后服务机构，且售后服务点有充足的零配件储备和能力相当的技术服务人员，以解决在产品正常运行中出现的各种问题，在收到用户反馈后会及时调度，以确保处理系统在短时间内能够恢复正常运行，为用户提供更加便捷的服务，免去用户的后顾之忧。我司在维修中，提供的零配件均为原厂生产的，所需零配件根据采购人要求以最快的方式迅速发送，保证设备有良好的售后维修保障服务。

八、服务保障体系

为了更好的服务本项目，确保项目的顺利实施，我司组建了完整的技术服务队伍，落实明确的售后服务人员，提供明确的保修期限、故障响应时间、回访措施、维护措施及售后服务流程、紧急情况处理，确保服务质量的稳定性和可靠性。我司还可根据采购人的意见和建议，对服务流程进行不断的调整和优化，以提高服务效率和准确性。


九、售后服务流程

1、采购人发现设备使用中出现异常情况，通知设备维修组，并根据情况关机或切断电源，保

证人员的安全，控制设备的损坏程度。

2、设备维修组在接到医疗设备故障报告后，通过采购人对故障的叙述，快速对设备进行故障的初步分析，了解故障发生的原因、性质、范围、严重程度，将掌握的情况向负责人汇报，做出解决方案。

3、对能远程立即修复的，我司通过远程指导，解决故障问题，不能远程指导修复的，我司派专业售后服务人员到达现场修复使用。

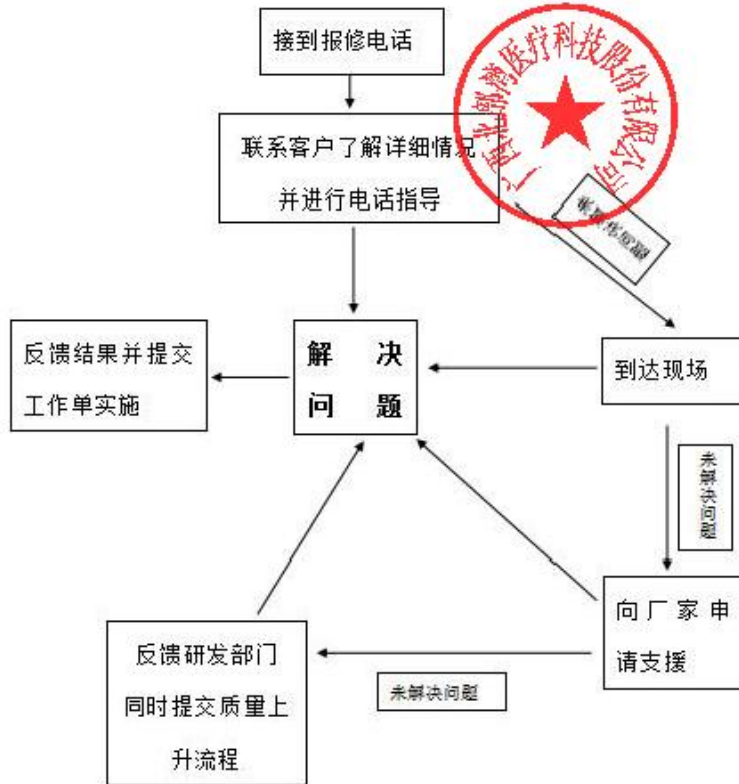

十、产品的售后服务机构

序号	服务单位名称	地址	联系电话
1	广西北部湾医疗科技股份有限公司	广西壮族自治区南宁市江南区南宁市金凯路8号龙光玖誉城悦城组团62号楼养老用房4楼401、402、403	0771-5807622
2	达科为(深圳)医疗设备有限公司	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区卢辉路2号B栋5楼	0755-26642445/ 400-630-4366
3	武汉俊杰电子有限公司	武汉市东湖新技术开发区武大科技园兴业楼北楼二单元1203室	027-87401756

十一、售后紧急情况处理

1、采购人发现设备使用中出现紧急异常情况，应立即通知设备维修组，并根据情况关机或切断电源，保证人员的安全，控制设备的损坏程度。

2、设备维修组在接到紧急医疗设备故障通知后，通过采购人对故障的叙述，快速对设备进行故障的初步分析，了解故障发生的原因、性质、范围、严重程度，立即将掌握的情况向负责人汇报，并快速给出解决方案。

3、12小时内，我司派专业售后服务人员到达现场对故障进行处理
售后服务技术人员

序号	姓名	职位	联系方式
1	蒋跃武	工程师	18775374514
2	邹天明	工程师	18587592218

4、对立即可修复的，设备维修组工程师现场修复使用。

5、对不能立即修复的设备，将故障设备拖离工作区域，调用相应的备用机或其他替代方法；不易搬动的设备，维修人员应挂上“故障暂停使用”的禁用标识。

(1)备用机可首先考虑向最近的科室借用其次可从设备供给科调用；假如无法借用、调用到，应立即上报设备科科长与分管院长，从其他科室借用。

(2)需带回维修组或委外修理的设备，维修人员须填写“仪器设备维修交接单”。

6、故障修复后，维修人员应与时做好记录，报设备科长，并做好故障原因分析总结经验，防止重复出现类似事故。

十二、质量保障方案

- 1、我司提供全部设备是具备厂家合法销售渠道的全新原装合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备满足运行要求。
- 2、按厂家承诺实行“三包”。
- 3、严格执行《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》等法律法规，确保采购的设备符合要求。
- 4、免费安排工程师对采购人的相关技术操作人员进行操作及相关知识进行现场技术培训，确保相关技术操作人员正确使用设备。
- 5、定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。

十三、交付的时间和地点

1、合同履行期限：详见招标公告。自合同签订之日起 25 日历天内供货并安装调试完毕。

地点：采购人指定地点。

2、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由我司负责，并承担相关责任。



十四、付款条件

按合同条款执行。交货安装验收合格，我司开具合法全额发票，采购人正常使用满 3 个月付合同价款的 95%，剩余总货款的 5%在质保期结束后 30 个工作日内一次性付清(不计利息)。

十五、售后服务

- 1、质保期：一年。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除质保期特别注明外。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。保修期内，出现维修超过三次，未修好，需要第四次维修的，可要求换新机。
- 2、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
 - (1) 负责免费送货上门，安装调试，培训操作人员。
 - (2) 不能正常使用的必须提供备用货物。
 - (3) 定期回访以及对货物维修。
 - (4) 其余按厂家承诺。
- 3、我司配置专业安装、维修人员进行服务。
- 4、我司对采购人的服务通知，紧急故障处理：接到客户反馈后 20 分钟内响应，24 小时之内赴现场处理；不需要更换备件的情况下应在 12 小时内解除故障，需要更换备件时应在 24 小时内解除故障。

十六、质量标准

我司所供货物是全新的且按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的货物；零部件、配件及安装材料是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。

十七、规范标准

执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

十八、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等

详见技术偏离表中我司响应的“技术参数及性能配置要求”。我司所投标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷。我司在投标文件中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，当出现知识产权或者经营权侵权行为时由我司承担所有责任。

投标人盖电子公章：西北鄯善医疗科技股份有限公司

日期：2025年1月24日



3、项目实施方案

一、概述

本项目实施方案为详细规划医疗设备项目的实施过程，确保项目顺利进行并达到预期目标。本方案涵盖项目背景、目标、范围、实施计划、技术服务等内容。

二、项目背景

随着医疗技术的不断发展，为提升医疗服务水平，根据项目采购需求，为医院提供先进的诊断设备，提高医疗质量、满足患者需求。

三、项目目标

- 1、引进先进的医疗设备，提升医院的技术水平和竞争力。
- 2、提高医疗服务的效率和质量，减少误诊漏诊情况。
- 3、优化医患体验，增强患者对医院的满意度。
- 4、提高医疗设备的利用率和维护效率，减少设备故障和停机时间。

四、项目范围

- 1、医疗设备选购：根据医院需求，选择适合的医疗设备。
- 2、设备安装与调试：确保设备正确安装，并根据需要进行调试和培训。
- 3、医护人员培训：对使用新设备的医护人员进行培训，确保其熟练掌握使用方法。
- 4、设备运营管理：建立设备维护保养计划，定期进行设备巡检和保养，确保设备正常运行。

五、项目实施步骤

- 1、医院需求分析：明确贵院对设备需求等全面了解。
- 2、市场调研：进行市场调研，了解市场上各种医疗设备的品牌、性能、价格等信息，以便后续的设备选购。
- 3、设备选择：从需求分析和市场调研的结果，我司从设备的质量、性能、售后服务等因素，进行综合评估后对设备进行选择并参与贵院的相关招投标活动。
- 4、中标后合同签订：若我司中标后，根据双方约定进行合同签订，明确设备的型号、数量、价格、交付时间、售后服务等条款，确保双方权益。
- 5、设备采购安装：设备到货后，由专业技术人员进行安装，确保设备安装合理、牢固，符合相关安全标准。
- 6、调试验收：安装完成后，进行设备的各项功能测试，确保设备正常运行，符合预期要求。
- 7、培训：对医疗机构的相关人员进行操作、维护、保养等方面的培训，确保工作人员能够熟练操作设备。

8、后续服务：供应商提供设备的维护保养、故障排除、零配件供应等售后服务，确保设备的长期稳定运行。

六、项目技术力量

1、电话服务技术支持：提供7×24小时售后服务

①对产品的了解咨询。

②在使用产品过程中的故障处理咨询。

③在使用产品过程中的使用技巧咨询。

④有丰富的技术支持人员会尽量即时在电话中帮助用户解决问题，若当时不能马上解决，热线人员会记录用户单位的名称，联系电话及联系人，在得到解决方案后，立刻主动与用户联系。

2、现场技术服务支持：

在我司所提供产品出现故障，并不能通过技术电话支持或远程支持被解决时，我司安排工程师，抵达现场，进行现场技术服务。

七、配件清单

我司所投的产品为：

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地
1	轮转式切片机	1台	达科为	MT1	达科为(深圳)医疗设备有限公司	中国
2	通风柜	5台	俊杰	JTFG-1500	武汉俊杰电子有限公司	中国
3	标本冷藏柜	1台	俊杰	JLCG-1260	武汉俊杰电子有限公司	中国
4	病理取材台	1台	俊杰	JQCT-1800	武汉俊杰电子有限公司	中国

中标通知书

中标通知书

广西北部湾医疗科技股份有限公司：

广西百色公共资源交易有限公司受靖西市人民医院委托，就靖西市人民医院新院一批设备采购项目（项目编号：BSZC2025-G1-250003-GXBS）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，经招标人确认，贵公司为本项目靖西市人民医院新院一批设备采购项目标项8的中标人，中标金额为：人民币贰拾壹万伍仟伍佰元整（¥215500.00元）。

请贵公司自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同，并按招标文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知！

招标人名称：靖西市人民医院

地址：广西百色市靖西县新靖镇南门街45号

联系方式：0776-3050366

采购代理机构：广西百色公共资源交易有限公司

地址：广西百色市右江区迎龙路50号汇丰商业广场15楼

项目联系人：黄海洋

联系方式：0776-2981360

靖西市人民医院

2025年2月12日

广西百色公共资源交易有限公司

2025年2月12日